

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 1196 del 02 LUG. 2021

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO CON DETETTORE DIGITALE DINAMICO DA DESTINARE ALLA U.O.S.D. RADIOLOGIA DEL P.O. VAL VIBRATA DI S. OMERÒ DELLA ASL TERAMO. SIMOG 8019304. - CIG. 8596436367, RDO 2748578.

Data 23/06/2021 Firma [Signature] Data 23.6.2021 Firma [Signature]

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Emiliano Capasso

Il Responsabile del procedimento
Dott. Domenico Lori

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del Dipartimento amm/vo.
(Dott.ssa Rossella Di Marzio)

Data 23.6.2021 Firma [Signature]
Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 30/6/2021



Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo: Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 25/6/2021



Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott. Maurizio Brucchi

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'ambrosio

PREMESSO che con deliberazione n. 305 del 16/02/2021, questa stazione appaltante si determinava nel senso di attivare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016, apposita procedura negoziata tramite Richiesta di offerta sulla piattaforma elettronica Mepa (da qui in avanti RDO), articolata in un unico lotto, finalizzata all'affidamento della fornitura di n° 1 sistema radiologico telecomandato digitale diretto con detettore digitale dinamico;

DATO ATTO che:

- in relazione a quanto sopra, è stata attivata, sulla piattaforma elettronica Mepa, RDO n. 2748578 aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa abilitazione al Bando BENI/Forniture specifiche per la Sanità);
- entro il 06/04/2021 ore 12:00, termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute sulla piattaforma MEPA nr. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

| # | Denominazione concorrente | Forme di partecipazione | Lotti a cui ha partecipato | Data presentazione offerta |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Lotto 1 | 01/04/2021 14:14:45 |
| 2 | GMS MED | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Lotto 1 | 26/03/2021 09:43:56 |
| 3 | ITALRAY | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Lotto 1 | 01/04/2021 15:00:32 |

- a seguito dell'analisi della documentazione amministrativa tutti gli operatori economici risultavano idonei e quindi ammessi alle successive fasi di gara;

- con provvedimento protocollo Nr. 57889 del 08/04, agli atti, è stata nominata, per la valutazione tecnica inerente alla gara in argomento, la seguente Commissione Giudicatrice:

- **Presidente: Dott. Cristian Fidanza** – Dirigente fisico dell'U.O.C. Fisica Sanitaria;
- **Componente: Dott. Francesco D'Alessandro** – Dirigente medico dell'U.O.C. Radiologia del P.O. S. Omero;
- **Componente: Dott. Alessandro Savini** - Dirigente fisico dell'U.O.C. Fisica Sanitaria;
- **Segretario non componente: Dott. Emiliano Capasso** - Collaboratore Professionale Amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice (all. 1), in esito all'esame delle schede tecniche relative alle offerte presentate degli operatori economici partecipanti (seduta riservata del 10/05/2021), con il quale la commissione dichiara tutte le offerte presentate in gara conformi ai criteri minimi riportati nel Capitolato Speciale di Gara e attribuisce alle ditte partecipanti i punteggi tecnici che vengono di seguito sinteticamente riportati:

| DITTE | PUNTEGGIO ELEMENTO QUALITATIVO |
|------------------------|--------------------------------|
| GMS MED | 69,76 |
| General Medical Merate | 70,00 |
| Italray | 52,03 |

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice (all. 2), in esito all'apertura delle buste economiche sulla piattaforma MEPA (sedute pubblica del 19/05/2021), con il quale la commissione dichiara di prendere atto delle offerte economiche delle ditte partecipanti, dei punteggi per l'elemento prezzo ottenuti dalle singole offerte e calcolati in automatico dalla piattaforma e della conseguente graduatoria che di seguito sinteticamente si riporta:

| <i>Operatori economici</i> | <i>Punteggio complessivo elementi di natura qualitativa</i> | <i>Punteggio elemento di natura quantitativa prezzo</i> | <i>Sommatoria punteggi elementi di natura qualitativa e quantitativa prezzo</i> |
|----------------------------|---|---|---|
| GMS MED | 69,764 | 28,196 | 97,96 |
| General Medical Merate | 70,000 | 24,678 | 94,68 |
| Italray | 52,027 | 30,000 | 82,02 |

DATO ATTO che la commissione giudicatrice come da citato verbale del 19/05/2021 rileva che il punteggio conseguito dalla ditta GMS MED Srl è superiore alle soglie stabilite dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e pertanto, rimanda al RUP l'avvio della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta;

DATO ATTO che, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, con nota prot. 77856 del 19.05.2021, la Stazione Appaltante nella persona del RUP ha invitato la suddetta ditta, a rimettere entro il termine perentorio di 15 giorni, una relazione concernente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare le offerte;

DATO ATTO che in data 24.05.2021, a mezzo pec, è pervenuta da parte del suddetto operatore economico la relazione richiesta;

DATO ATTO che il RUP, come da verbale del 25/05/2021 (all.3) dopo ampia ed approfondita valutazione delle giustificazioni fornite dalla ditta GMS MED S.r.l. a sostegno degli elementi costitutivi dell'offerta ed a cui si fa rinvio "per relationem", ritiene le stesse adeguate in relazione all'offerta presentata in sede di gara e pertanto propone, relativamente alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di un sistema radiologico telecomandato digitale diretto con detettore digitale dinamico da destinare alla U.O.S.D. Radiologia del P.O. Val Vibrata di S.Omero della ASL Teramo, l'aggiudicazione in favore della ditta GMS MED S.r.l., ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la nota acquisita al prot. Nr. 80653/21 del 27/05/2021 (all.4) con la quale la ditta General Medical Merate dichiara che per quanto a sua conoscenza l'apparecchiatura telecomandata della ditta GMS Med, prima

classificata, non dispone delle seguenti specifiche tecniche di minima, relativamente a quanto riportato nella scheda tecnica – Allegato 2 e nello specifico la caratteristica di cui al punto 3.1 “Equivalenza tavolo porta paziente radiotrasparente $\geq 1,3$ (mmAl@100KV) assenza di profili metallici” e pertanto chiede, qualora venisse verificata suddetta mancata rispondenza, l'esclusione della ditta GMS Med per non conformità ai requisiti minimi di gara;

DATO ATTO che a seguito della suddetta istanza, il RUP, in data 27/05/2021 con nota prot. Nr. 80912 (all.5), comunicava l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 finalizzato alla verifica dell'esistenza o meno dei presupposti per la revisione del giudizio di conformità tecnica dell'offerta della ditta GMS Med;

VISTA la nota acquisita al prot. Nr. 84174/21 del 07/06/2021 (all.6) con la quale la ditta GMS Med chiarisce che, in riferimento all'istanza prodotta dalla ditta General Medical Merate, il tavolo porta paziente offerto è perfettamente conforme alle specifiche richieste dal capitolato in quanto interamente in carbonio e senza longaroni metallici;

DATO ATTO che, con differenti comunicazioni a mezzo mail, venivano trasmesse, alla commissione giudicatrice preposta, le note di cui sopra al fine di verificare quanto dichiarato dalle ditte General Medical Merate e GMS Med;

DATO ATTO che la commissione, preso atto dell'istanza della ditta General Medical Merate e della nota della ditta GMS Med, e sulla base della documentazione tecnica già a suo tempo esaminata, con nota mail agli atti conferma le risultanze di cui all'allegato verbale del 10/05/2021;

DATO ATTO che per quanto sopra, in data 22/06/2021, con nota prot. 90447 (all.7), il RUP comunicava alle ditte partecipanti la conclusione del suddetto procedimento con il conseguente rigetto dell'istanza prodotta dalla ditta General Medical Merate Spa;

RITENUTO, a seguito delle risultanze della procedura di gara di cui sopra, di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di n° 1 sistema radiologico telecomandato digitale diretto con detettore digitale dinamico, nei termini e alle condizioni di cui alla RDO sul Mepa n. 2748578, alla ditta GMS MED S.r.l. (P. Iva 10795130961) con sede legale in via Gaspare Gozzi 1, 20129, Milano (MI);

DATO ATTO delle verifiche con esito positivo sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO:

- di nominare come Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dott. Giovanni Orlandi, Direttore dell'U.O.C. Fisica Nucleare;
- di confermare il quadro economico già approvato con delibera di indizione nr. 305 del 16/02/2021;
- doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire, con la massima tempestività l'approvvigionamento di cui trattasi;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è **8596436367**;

PROPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. **aggiudicare**, ai sensi dell'artt. 36 comma 2 lett. b) del D.L. 50/2016, alla ditta GMS MED S.r.l. (P. Iva 10795130961) con sede legale in via Gaspare Gozzi 1, 20129, Milano (MI);, Pec: gmsmed@pec.it, la fornitura di n° 1 sistema radiologico telecomandato digitale diretto con detettore digitale dinamico per un costo totale di € 178.000,00 iva esclusa alle condizioni tecnico-economiche di cui alla RDO sul Mepa nr. 2748578;
2. **prenotare** che la spesa di € 217.160,00 IVA inclusa come da prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
3. **nominare** come Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dott. Giovanni Orlandi, Direttore dell'U.O.C. Fisica Nucleare;
4. **confermare** il quadro economico già approvato con delibera di indizione nr. 305 del 16/02/2021;
5. **precisare** che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è **8596436367**;
6. **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione di quanto riportato in narrativa;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Di Giosia

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

Allegato n. 1 - verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice del 10/05/2021 (pagg. 1-3);

Allegato n. 2 - verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice del 19/05/2021 (pagg. 4-5);

Allegato n. 3 - verbale redatto dal RUP del 25/05/2021 (pag. 6);

Allegato n. 4 - nota della ditta GMM Spa acquisita al prot. Nr. 80653/21 del 27/05/2021 (pag. 7-8);


Allegato n. 5 - comunicazione avvio procedimento del 27/05/2021 (pag. 9-11);

Allegato n. 6 - nota della ditta GMS Srl acquisita al prot. Nr. 84174/21 del 07/06/2021 (pag. 12-13);

Allegato n. 7 - - comunicazione avvio procedimento del 22/06/2021 (pag. 14-15);

allegati n. 15





PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO CON DETETTORE DIGITALE DINAMICO DA DESTINARE ALLA U.O.S.D. RADIOLOGIA DEL P.O. VAL VIBRATA DI S. Omero DELLA ASL TERAMO. SIMOG 8019304. - CIG. 8596436367. RDO 2748578

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 10/05/2021

Il giorno 10 del mese di Maggio 2021 alle ore 15:00 presso gli uffici dell'U.O.C. Fisica Sanitaria del P.O. di Teramo si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 57889 del 08/04/2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in oggetto, nelle persone di:

- **Presidente: Dott. Christian Fianza**– Dirigente fisico dell'U.O.C. Fisica Sanitaria;
- **Componente: Dott. Francesco D'Alessandro** – Dirigente medico dell'U.O.C. Radiologia del P.O. S. Omero;
- **Componente: Dott. Alessandro Savini** - Dirigente fisico dell'U.O.C. Fisica Sanitaria;
- **Segretario non componente: Dott. Emiliano Capasso** - Collaboratore Professionale Amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante.

La Commissione riprende la valutazione delle offerte tecniche e dopo un'attenta analisi delle stesse procede a dichiarare tecnicamente conformi tutte le offerte presentate in gara.

Successivamente la commissione passa alla fase di attribuzione dei punteggi tecnici previsti per i criteri di valutazione di cui all'art. 4 del documento di gara denominato "Condizioni particolare di RDO".

Al termine di suddetta valutazione la commissione giunge alle conclusioni analiticamente riportate nell'allegato 1 al presente verbale di cui è parte sostanziale.

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, e fissa alla data del 19/05/2021 ore 12:30 la seduta pubblica di apertura della busta economica.

Il verbale si compone di n. 1 pagina e di n. 1 allegato.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Christian Fianza - Presidente

Dott. Francesco D'Alessandro -Componente

Dott. Alessandro Savini - Componente

Dr. Emiliano Capasso – Segretario

| CRITERI | DITTE | Fidanza | D'alessandr | Savini | Mer | Mpe | Vikj | Wj | Cesj | VALUTAZIONE SINTETICA | |
|--|------------------------|---------|-------------|--------|-----|-----|------|----|------|---|---|
| CRITERIO 1 - Generatore, caratteristiche tecniche e prestazionali | GMS MED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | Per ciò che concerne il criterio 1, le offerte delle ditte GMS e GMM si equivalgono mentre Italray risulta leggermente inferiore dal punto di vista prestazionale. | |
| | General Medical Merate | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 11 | | |
| | Italray | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | 0.8 | | 8.8 | | |
| CRITERIO 2 - Sorgente radiogena e collimatore caratteristiche tecniche e prestazionali | GMS MED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | Per ciò che concerne il criterio 2, le offerte delle ditte GMS e GMM si equivalgono mentre l'apparecchiatura della Italray necessita di barella dedicata per effettuare esami in proiezione latero laterale, inoltre il collimatore non risulta motorizzato. | |
| | General Medical Merate | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 8 | | 8 |
| | Italray | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | 0.3 | | 2.4 | | |
| CRITERIO 3 - Tavolo portapaziente caratteristiche tecniche e meccaniche | GMS MED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | Per ciò che concerne il criterio 3, l'apparecchiatura della ditta GMS soddisfa pienamente i requisiti richiesti. Le apparecchiature GMM e Italray risultano carenti per l'esecuzione dello specifico esame in proiezione AP su paziente barellato. L'apparecchiatura Italray presenta uno spessore di mmAl equivalente a 70kv e non a 100kv come richiesto. | |
| | General Medical Merate | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | 0.8 | | 11.2 | | |
| | Italray | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | 0.3 | | 4.2 | | |
| CRITERIO 4 - Detettore digitale dinamico caratteristiche fisiche e tecniche | GMS MED | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 10 | 8 | Per ciò che concerne il criterio 4, l'apparecchiatura della ditta GMM soddisfa pienamente i requisiti richiesti. L'apparecchiatura GMS presenta valori di acquisizione in grafia e scopia inferiori a GMM. L'apparecchiatura Italray presenta valori in grafia e scopia inferiori a GMS. Dalla documentazione della ditta Italray non è possibile dedurre tipologia e quantità di zoom disponibili. | |
| | General Medical Merate | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 10 | | |
| | Italray | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | 0.6 | | 6 | | |
| CRITERIO 5 - Workstation per acquisizione post processing caratteristiche tecniche | GMS MED | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 5 | 4 | Per ciò che concerne il criterio 5, la workstation della ditta GMM offre le migliori performance hardware. Le workstation delle ditte GMS ed Italray presentano performance inferiori relativamente all'archiviazione del sistema operativo. | |
| | General Medical Merate | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 5 | | 5 |
| | Italray | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | 0.6 | | 3 | | |
| CRITERIO 6 - Software di post elaborazione, algoritmi utilizzati | GMS MED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | | |
| | General Medical Merate | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 8 | | 8 |
| | Italray | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 8 | | 8 |
| CRITERIO 7 - Sistema di Contenimento e Riduzione della dose pazienti-operatori | GMS MED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | | |
| | General Medical Merate | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 5 | | 5 |
| | Italray | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 5 | | 5 |
| CRITERIO 8 - Servizio Assistenza Tecnica e Formazione | GMS MED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | |
| | General Medical Merate | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | 3 |
| | Italray | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | 3 |
| CRITERIO 9 - Accessori in dotazione caratteristiche tecniche | GMS MED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | | |
| | General Medical Merate | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 5 | | 5 |
| | Italray | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 5 | | 5 |
| | GMS MED | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | |







2

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITERIO 5 - Strumentazione di Radloprotezione | General Medical Merate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Italray | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| PUNTEGGI FINALI | | P Max | Coef. | P TEC Max | Punteggio Riparametrato |
|------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------------------------|
| GMS MED | 59.00 | 59.20 | 0.997 | 70 | 69.764 |
| General Medical Merate | 59.20 | | 1.000 | | 70.000 |
| Italray | 44.00 | | 0.743 | | 52.027 |

Dott. Christian Fianza
Dott. Francesco D'Alessandro
Dott. Alessandro Savini

Christian Fianza
Francesco D'Alessandro
Alessandro Savini

Data 10/05/2021



2

3

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO - U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 19.05.2021

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO CON DETETTORE DIGITALE DINAMICO DA DESTINARE ALLA U.O.S.D. RADIOLOGIA DEL P.O. VAL VIBRATA DI S. Omero DELLA ASL TERAMO. SIMOG 8019304. - CIG. 8596436367. RDO 2748578.

Il giorno 19 del mese di maggio 2021 alle ore 12.30 presso gli uffici dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, sito in Teramo, al terzo piano del palazzo ex Inam, Circ.ne Ragusa 1, si riunisce in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice nominata con atto n. 57889 del 08/04/2021, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in oggetto, nelle persone di:

- Presidente: Dott. Christian Fianza– Dirigente fisico dell'U.O.C. Fisica Sanitaria;
- Componente: Dott. Francesco D'Alessandro – Dirigente medico dell'U.O.C. Radiologia del P.O. S. Omero;
- Componente: Dott. Alessandro Savini - Dirigente fisico dell'U.O.C. Fisica Sanitaria;
- Segretario non componente: Dott. Emiliano Capasso - Collaboratore Professionale Amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di segretario non componente con funzione verbalizzante.

Non ci sono presenti, né in qualità di rappresentanti delle ditte, né di uditori, per le motivazioni di cui all'art. 20 del Disciplinare di gara.

La commissione procede alla trasmissione attraverso il portale Mepa alle ditte partecipanti dei verbali riportanti i punteggi attribuiti per i criteri qualitativi di cui all'art. 4 del documento di gara "Condizioni particolari di RDO".

La Commissione procede poi all'apertura delle buste economiche, sulla piattaforma Mepa, delle ditte ammesse a questa fase ed in particolare:

1. Ditta G.M.S. MED S.r.l.
2. Ditta GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.
3. Ditta ITALRAY

Al termine dell'apertura delle suddette buste la piattaforma Mepa, in automatico, procede al calcolo del punteggio conseguito da ciascuna ditta per l'elemento prezzo proponendo al termine del calcolo la seguente graduatoria:

| <i>Operatori economici</i> | <i>Punteggio complessivo elementi di natura qualitativa</i> | <i>Punteggio elemento di natura quantitativa prezzo</i> | <i>Sommatoria punteggi elementi di natura qualitativa e quantitativa prezzo</i> |
|----------------------------|---|---|---|
| GMS MED | 69,764 | 28,196 | 97,96 |
| General Medical Merate | 70,000 | 24,678 | 94,68 |
| Italray | 52,027 | 30,000 | 82,02 |

La commissione, preso atto della suddetta graduatoria, procede alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e rileva che i punteggi ottenuti dalla ditta GMS MED S.r.l., prima classificata in graduatoria, sono entrambi risultati superiori alle rispettive soglie (56 e 24) stabilite dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

DA AB GP E


Per quanto sopra, la commissione trasmette il presente verbale al RUP per il disbrigo delle attività di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016,

Alle ore 13:15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, e trasmette il presente verbale al RUP per il seguito di competenza.


Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto di n. 2 (due) pagine.

Letto, confermato, sottoscritto.


Dott. Christian Fianza - Presidente



Dott. Francesco D'Alessandro - Componente



Dott. Alessandro Savini - Componente



Dott. Emiliano Capasso - segretario non componente



VERBALE SEGGIO DI GARA DEL 25/05/2021

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO CON DETETTORE DIGITALE DINAMICO DA DESTINARE ALLA U.O.S.D. RADIOLOGIA DEL P.O. VAL VIBRATA DI S.OMERO DELLA ASL TERAMO. N. CIG. 8596436367 - Proposta di Aggiudicazione.

Il giorno 25 del mese di Maggio 2021 alle ore 11.00 presso gli uffici dell'Azienda U.S.L. di Teramo, sita in Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1, si riunisce in seduta riservata il Seggio di gara, costituito, quale organo monocratico, dal R.U.P. della presente procedura Dott. Domenico Lori, assistito, per il disbrigo delle attività, dal funzionario Dott. Emiliano Capasso, quest'ultimo con funzione verbalizzante.

Si premette che:

- 1) come da risultanze relative all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori concorrenti sulla piattaforma Mepa, a seguito dell'effettuazione delle operazioni matematiche previste dalla formula di cui all'art. 4 del documento Condizioni Particolari di RDO, è emersa, l'anomalia dell'offerta dell'operatore economico **GMS MED S.r.l.**, collocatasi nella prima posizione della graduatoria, in quanto sia il punteggio conseguito per gli elementi di natura qualitativa (69,764) che il punteggio conseguito per l'elemento di natura quantitativa "prezzo" (28,196), sono entrambi risultati superiori alle rispettive soglie (56 e 24) stabilite dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) per quanto sopra, ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, con nota prot. 77856 del 19.05.2021, la Stazione Appaltante ha invitato la suddetta ditta, a rimettere entro il termine perentorio di 15 giorni, una relazione concernente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare le offerte;
- 3) in data 24.05.2021, a mezzo pec, è pervenuta da parte del suddetto operatore economico la relazione richiesta;

Si procede quindi al loro esame.

Dopo ampia ed approfondita valutazione della documentazione sopra riportata, le giustificazioni fornite dalla ditta **GMS MED S.r.l.** a sostegno degli elementi costitutivi dell'offerta ed a cui si fa rinvio "per relationem", appaiono adeguate in relazione all'offerta presentata in sede di gara.

Preso atto di quanto sopra il RUP propone, relativamente alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di un sistema radiologico telecomandato digitale diretto con detettore digitale dinamico da destinare alla U.O.S.D. Radiologia del P.O. Val Vibrata di S.Omero della ASL Teramo, l'aggiudicazione in favore della ditta **GMS MED S.r.l.**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;


Alle ore 11.30 si chiude la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott. Domenico Lori



Dott. Emiliano Capasso con funzione verbalizzante

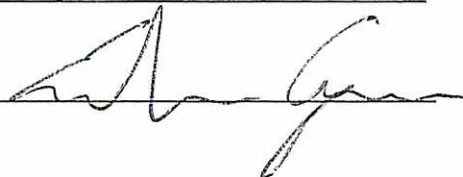



Spett.le

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Circonvallazione Ragusa, 1

64100 T E R A M O

Cortese Attenzione:

Responsabile del Procedimento

Dott. Domenico Lori

Inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

abs@pec.aslteramo.it

domenico.lori@aslteramo.it

Prot. n. 210108/a/GG/am

Seriate (BG), 26.05.2021



Oggetto: *Istanza in autotutela* - Esito Gara a "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di un sistema radiologico telecomandato digitale diretto con detettore digitale dinamico da destinare alla U.O.S.D. RADIOLOGIA DEL P.O. VAL VIBRATA DI S. OMERO DELLA ASL TERAMO. SIMOG 8019304. - CIG. 8596436367. RDO 2748578"

In riferimento alla documentazione pervenutaci circa la graduatoria della gara in oggetto e dopo aver letto i verbali della commissione giudicatrice del 20.04.2021 e del 10.05.2021, con in allegato la scheda punteggi tecnici, riteniamo che la stessa non risulta esaustiva nel descrivere le motivazioni che hanno determinato il punteggio tecnico finale.

Non riscontriamo una analisi specifica di tutte le caratteristiche tecniche "di minima" richiamate dal Capitolato Speciale di Gara all'art. 2 con le indicazione che le stesse "...devono essere necessariamente possedute dall'apparecchiatura e dai dispositivi opzionali offerti in gara, a pena l'esclusione dalla gara".

In particolare, per quanto di nostra conoscenza, ci risulta che l'apparecchiatura Rx telecomandata della GMS Med, prima classificata, non dispone delle seguenti specifiche tecniche di minima, relativamente a quanto riportato nella scheda tecnica – Allegato 2, caratteristiche minime:

- Il punto 3.1 – richiede "Equivalenza tavolo porta paziente radiotrasparente $\geq 1,3$ (mmAl@100 kV) assenza di profili metallici;" per quanto di nostra conoscenza l'apparecchiatura Rx telecomandata

2

7



della concorrente GMS Med dispone di un piano d'esame porta paziente **con longheroni metallici ai due lati dello stesso.**

Inoltre per quanto riguarda il giudizio riportato per il "Criterio 3" - non comprendiamo quanto riportato nella motivazione "Le apparecchiature GMM e Italray risultano carenti per l'esecuzione dello specifico esame in proiezione AP (antero-posteriore) su paziente barellato". L'apparecchiatura da noi proposta denominata "Sistema Opera SWING", così come è descritto nella documentazione tecnica presentata in gara ha tra le sue caratteristiche principali proprio quella di poter gestire il paziente barellato allo stesso modo del paziente posizionato supino sul piano d'esame, garantendo oltre le proiezioni AP anche le proiezioni in latero laterale senza che l'operatore debba intervenire per movimentare la barella.

Pertanto Vi chiediamo la verifica di quanto esposto ed eventualmente, se la verifica sarà positiva l'esclusione dalla gara della ditta GMS MED per non conformità ai requisiti minimi di gara.

Inoltre, in attesa di poter confermare ed eventualmente ampliare le motivazioni sopra riportate, chiediamo ai fini della eventuale difesa in giudizio dei propri interessi, di poter prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione presentata da tutte le società che hanno partecipato alla procedura di gara in oggetto:

- documentazione tecnica;
- documentazione amministrativa;
- verbali redatti dalla Commissione giudicatrice relativi alla formazione del giudizio tecnico e del conseguente punteggio attribuito.

General Medical Merate S.p.A. sin d'ora si dichiara disponibile a coprire le eventuali spese per diritti di segreteria e copie.

Qualora disponibile, Vi chiediamo di trasmettere la documentazione richiesta al nostro indirizzo di posta elettronica PEC: comm_italia@pec.gmmspa.com

In attesa di urgente riscontro, inviamo distinti saluti.

General Medical Merate S.p.A.
Monica Renata Lorenza Sordi
Amministratore Delegato
(Firmato digitalmente)

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO
C.F. e P. Iva 00115590671
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Tel. 0861 42291 – PEC abs@pec.aslteramo.it
Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo



11

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta in Partenza



Prot. n.0080912/21 del 27/05/2021

Spett.le DITTA GMS MED
PEC: gmsmed@pec.it

Spett.le ITALRAY
PEC: italray@pec.italray.it

E pc Spett.le GENERAL MEDICAL MERATE
PEC: comm_italia@pec.gmmspa.com

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di un sistema radiologico telecomandato digitale diretto con detettore digitale dinamico da destinare alla U.O.S.D. Radiologia del P.O. Val Vibrata di S. Omero della ASL Teramo. SIMOG 8019304. - CIG. 8596436367. RDO 2748578.-
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO AI SESI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 241/90.

Si comunica che a seguito della trasmissione dei verbali della commissione giudicatrice avvenuta in data 19/05/2021, la ditta GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. ha trasmesso a quest'ufficio l'allegata nota, acquisita con prot. nr. 80653/21 DEL 27/05/2021, con la quale la stessa chiede, per le motivazioni in essa riportate, una revisione del giudizio di conformità tecnica dell'offerta della ditta GMS MED ai criteri minimi previsti nel Capitolato Speciale di gara al punto 3.1 e la conseguente esclusione di detta offerta.

Per quanto sopra espresso, quest'ufficio con la presente comunica alle destinatarie, in qualità di soggetti direttamente interessati, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, con invito a rendere nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, eventuali note di chiarimento/difensive ed osservazioni.

Si comunica altresì che, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione della presente e che l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi sito al terzo piano dell'edificio ex Inam, Cir.ne Ragusa 1, 64100 Teramo.

Si allega nota della ditta GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo

R.U.P.
(Dott. Domenico Lori)

8

9



Spett.le
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Circonvallazione Ragusa, 1
64100 T E R A M O

Cortese Attenzione:
Responsabile del Procedimento
Dott. Domenico Lori

Inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
abs@pec.aslteramo.it
domenico.lori@aslteramo.it

Prot. n. 210108/a/GG/am
Seriante (BG), 26.05.2021

Oggetto: *Istanza in autotutela* - Esito Gara a "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di un sistema radiologico telecomandato digitale diretto con detettore digitale dinamico da destinare alla U.O.S.D. RADIOLOGIA DEL P.O. VAL VIBRATA DI S. OMERO DELLA ASL TERAMO. SIMOG 8019304. - CIG. 8596436367. RDO 2748578"

In riferimento alla documentazione pervenutaci circa la graduatoria della gara in oggetto e dopo aver letto i verbali della commissione giudicatrice del 20.04.2021 e del 10.05.2021, con in allegato la scheda punteggi tecnici, riteniamo che la stessa non risulta esaustiva nel descrivere le motivazioni che hanno determinato il punteggio tecnico finale.

Non riscontriamo una analisi specifica di tutte le caratteristiche tecniche "di minima" richiamate dal Capitolato Speciale di Gara all'art. 2 con le indicazione che le stesse "...devono essere necessariamente possedute dall'apparecchiatura e dai dispositivi opzionali offerti in gara, a pena l'esclusione dalla gara".

In particolare, per quanto di nostra conoscenza, ci risulta che l'apparecchiatura Rx telecomandata della GMS Med, prima classificata, non dispone delle seguenti specifiche tecniche di minima, relativamente a quanto riportato nella scheda tecnica – Allegato 2, caratteristiche minime:

- Il punto 3.1 – richiede "Equivalenza tavolo porta paziente radiotrasparente $\geq 1,3$ (mmAl@100 kV) assenza di profili metallici;" per quanto di nostra conoscenza l'apparecchiatura Rx telecomandata



della concorrente GMS Med dispone di un piano d'esame porta paziente con longheroni metallici ai due lati dello stesso.

Inoltre per quanto riguarda il giudizio riportato per il "Criterio 3" - non comprendiamo quanto riportato nella motivazione "Le apparecchiature GMM e Italray risultano carenti per l'esecuzione dello specifico esame in proiezione AP (antero-posteriore) su paziente barellato". L'apparecchiatura da noi proposta denominata "Sistema Opera SWING", così come è descritto nella documentazione tecnica presentata in gara ha tra le sue caratteristiche principali proprio quella di poter gestire il paziente barellato allo stesso modo del paziente posizionato supino sul piano d'esame, garantendo oltre le proiezioni AP anche le proiezioni in latero laterale senza che l'operatore debba intervenire per movimentare la barella.

Pertanto Vi chiediamo la verifica di quanto esposto ed eventualmente, se la verifica sarà positiva l'esclusione dalla gara della ditta GMS MED per non conformità ai requisiti minimi di gara.

Inoltre, in attesa di poter confermare ed eventualmente ampliare le motivazioni sopra riportate, chiediamo ai fini della eventuale difesa in giudizio dei propri interessi, di poter prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione presentata da tutte le società che hanno partecipato alla procedura di gara in oggetto:

- documentazione tecnica;
- documentazione amministrativa;
- verbali redatti dalla Commissione giudicatrice relativi alla formazione del giudizio tecnico e del conseguente punteggio attribuito.

General Medical Merate S.p.A. sin d'ora si dichiara disponibile a coprire le eventuali spese per diritti di segreteria e copie.

Qualora disponibile, Vi chiediamo di trasmettere la documentazione richiesta al nostro indirizzo di posta elettronica PEC: comm_italia@pec.gmmspa.com

In attesa di urgente riscontro, inviamo distinti saluti.

General Medical Merate S.p.A.
Monica Renata Lorenza Sordi
Amministratore Delegato
(Firmato digitalmente)

ASL 4 TERAMO
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Circonvallazione Ragusa, 1
64100 - Teramo (TE)
PEC abs@pec.aslteramo.it

e PC:

Spett.le GENERAL MEDICAL MERATE
PEC comm_italia@pec.gmmspa.com

Spett.le ITALRAY
PEC italray@pec.italray.it

Data: 06/06/2021

Oggetto: "PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO CON DETETTORE DIGITALE DINAMICO DA DESTINARE ALLA U.O.S.D. RADIOLOGIA DEL P.O. VAL VIBRATA DI S.OMERO DELLA ASL TERAMO" – SIMOG 8019304 – CIG 8596436367. RDO 2748578

Rif: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART.7 DELLA LEGGE 241/90, Vs. Prot. N.0080912/21 del 27/05/2021.

Gentile Dott. Lori

Nell’istanza di autotutela formulata dalla concorrente GMM ed in particolare in riferimento alle caratteristiche minime possedute, avendo la stessa evidenziato la presunta assenza nella ns. apparecchiatura della specifica minima di cui al punto 3.1, ossia piano d’esame con assenza di profili metallici, poiché - per quanto di Sua conoscenza - il ns. piano porta paziente presenterebbe longheroni metallici ai due lati dello stesso, precisiamo che, effettivamente, il ns. piano standard prevede quanto evidenziato da GMM, ma per il bando in oggetto è stata inclusa la versione più performante e ben più costosa, interamente in carbonio e senza longheroni metallici, perfettamente conforme alle specifiche richieste dal capitolato, come confermato da quanto dichiarato nell' "Allegato2 SchedaTecnica" (questionario tecnico).
Risulta, pertanto, infondata la tesi addotta dalla GMM sulle specifiche minime.

Infine, non è nostro compito entrare nel merito delle altre argomentazioni afferenti ai giudizi espressi dalla commissione; teniamo solo a puntualizzare che la configurazione da Noi offerta risulta ben superiore a quanto richiesto dal capitolato di gara e probabilmente la concorrente GMM eccepisce sui giudizi, riferendosi ad un sistema telecomandato ben più semplice di quello da Noi effettivamente offerto.

GMS MED S.r.l.
Giuseppe Tartaglia
GMS med srl



PROT. 90447/21
del 22/06/21

Spett.le DITTA GMS MED
PEC: gmsmed@pec.it

Spett.le ITALRAY
PEC: italray@pec.italray.it

Spett.le GENERAL MEDICAL MERATE
PEC: comm_italia@pec.gmmspa.com

OK
INVIATO
OK
5 CONCERNI
V

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di un sistema radiologico telecomandato digitale diretto con detettore digitale dinamico da destinare alla U.O.S.D. Radiologia del P.O. Val Vibrata di S. Omero della ASL Teramo. SIMOG 8019304. - CIG. 8596436367. RDO 2748578.-
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.


In riferimento alla nota n. 80912 del 27/05/2021, con la quale questa Azienda comunicava l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 a seguito di richiesta da parte della ditta GMM s.p.a. della revisione del giudizio di conformità tecnica dell'offerta della ditta GMS MED ai criteri minimi previsti dal capitolato di gara e conseguente esclusione dell'offerta, si comunica che la commissione giudicatrice della gara in oggetto, con l'allegata nota mail del 21/06/2021, ha espresso conferma del proprio giudizio di conformità tecnica dell'offerta prodotta dalla ditta GMS MED (cfr verbale del 10/05/2021), sulla base della documentazione tecnica già a suo tempo esaminata nonché dei seguenti chiarimenti forniti all'uopo dalla citata ditta GMS MED, con nota del 7/6/2021:

.....il tavolo porta paziente offerto è perfettamente conforme alle specifiche richieste dal capitolato in quanto interamente in carbonio e senza longheroni metallici"

In relazione a quanto sopra, pertanto, si dichiara concluso il procedimento con il rigetto dell'istanza prodotta dalla ditta GMM s.p.a.

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
R.U.P.
(Dott. Domenico Lori)

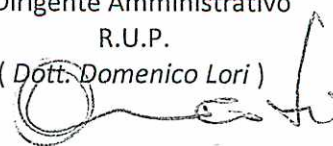

Capasso Emiliano

Da: Fidanza Christian
Inviato: lunedì 21 giugno 2021 13:33
A: Lori Domenico
Cc: Capasso Emiliano; Savini Alessandro; D'Alessandro Francesco
Oggetto: Esito valutazione istanza GMM


Spett.le RUP,

la Commissione, preso atto:

1. della nota della ditta GMM del 26/05/2021 con la quale dichiara che per quanto a sua conoscenza l'apparecchiatura telecomandata della ditta GMS Med, prima classificata, non dispone delle seguenti specifiche tecniche di minima, relativamente a quanto riportato nella scheda tecnica – Allegato 2 e nello specifico la caratteristica di cui al punto 3.1 “Equivalenza tavolo porta paziente radiotrasparente $\geq 1,3$ (mmAl@100KV) assenza di profili metallici” e pertanto chiedeva, qualora venisse verificata suddetta mancata rispondenza, l'esclusione della ditta GMS Med per non conformità ai requisiti minimi di gara;
2. della nota trasmessa in data 07/06/2021 dalla ditta GMS Med con la quale precisa che, in riferimento all'istanza prodotta dalla ditta General Medical Merate, il tavolo porta paziente offerto è perfettamente conforme alle specifiche richieste dal capitolato in quanto interamente in carbonio e senza longheroni metallici;

conferma, sulla base della documentazione tecnica già a suo tempo esaminata e delle note di cui sopra, le risultanze di cui al verbale redatto da questa commissione in data 10/05/2021.

Christian Fidanza
Dirigente Fisico - U.O.C. Fisica Sanitaria
ASL Teramo
Tel. 0861429808
Seg. 0861429819

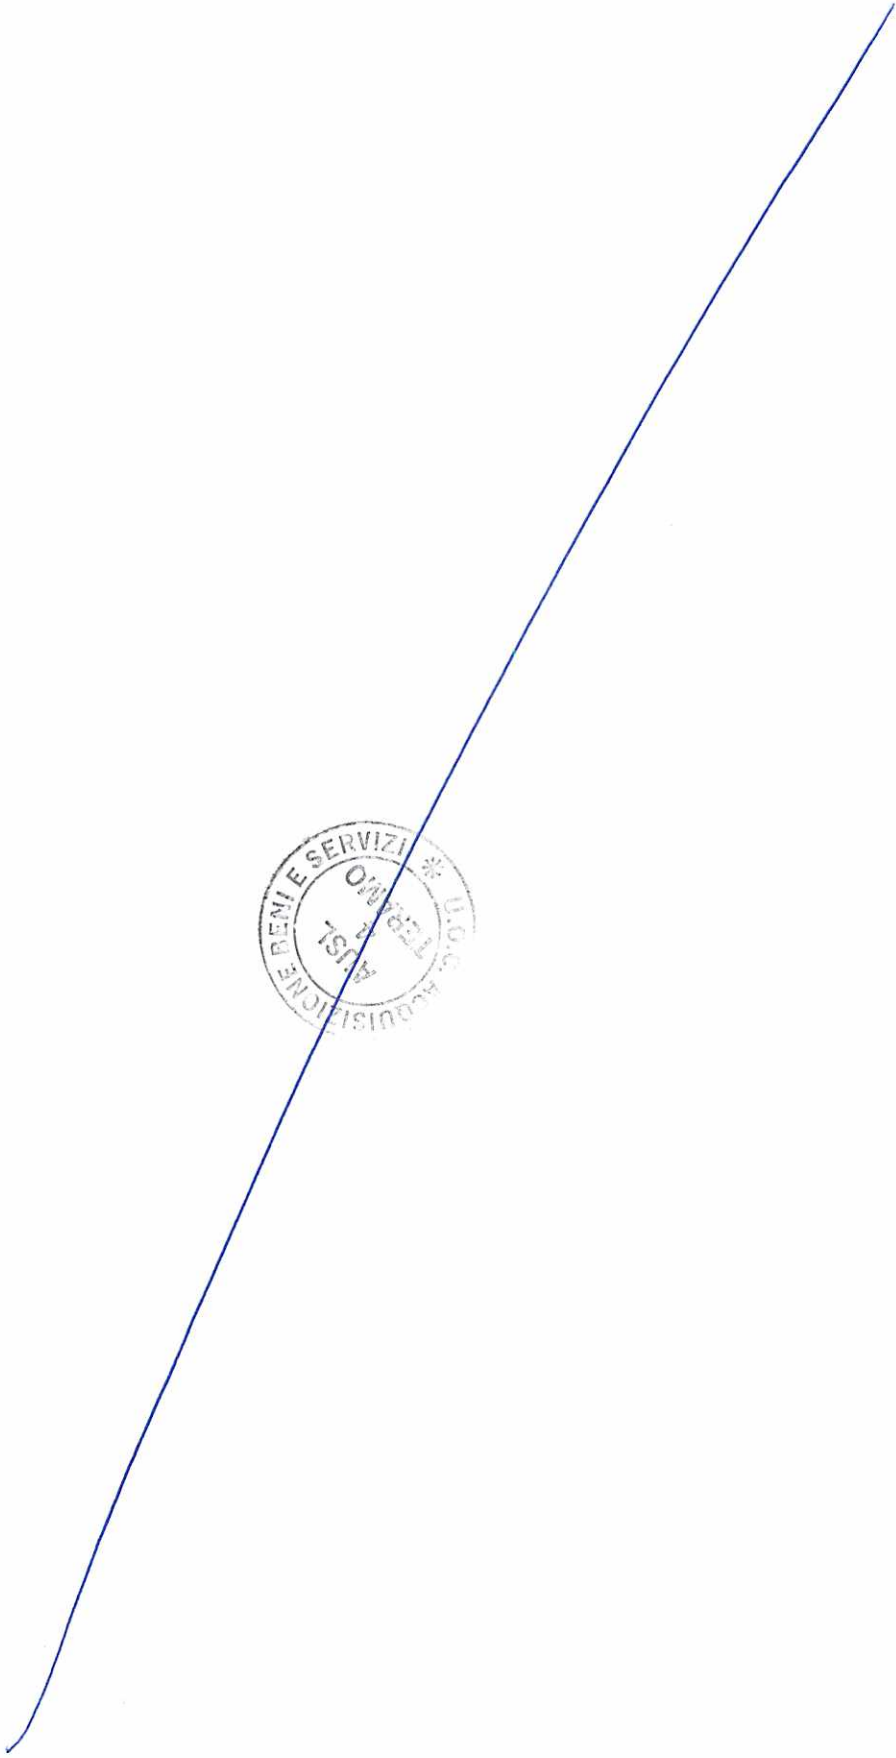

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

U.O.C. Programmazione e Gestione
Attività Economiche e Finanziarie

CIG. 8596436367

GMS MED S.r.l. (P. Iva 10795130961)

Spesa anno 2021 € 217.160,00 Sottoconto 01.01.02.05.0100

Fonte di Finanziamento : FSN


Referente U.O.C. proponente: Dott. Domenico Lori

Utilizzo prenotazione: S

Data: 23.6.2021

Il Dirigente

(Dott. Vittorio D'Ambrosio)

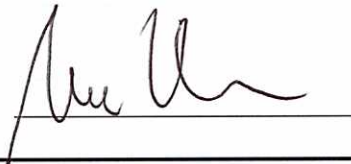

Prenotazione n. 1009/2021

Settore: _____

Data: 24.6.2021

Il Contabile _____
Il Dirigente
ASL 4 TERAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Giovanni DI ANTONIO

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 05 LUG. 2021 con prot. n. 2283/21 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

| Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti | | Unità Operative | | Staff | |
|--|---|--|---|--|--|
| Coordinamento Staff di Direzione | | Segreteria Generale e Affari Legali | | UOC Controllo di gestione | |
| Dipartimento Amministrativo | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Acquisizione Beni e Servizi | <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Tecnico-Logistico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Attività Economiche e finanziarie | <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Assistenza Territoriale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Gestione del Personale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Coordinamento Assistenza Ospedaliera | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa | |
| Dipartimento Emergenza Urgenza | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Patrimonio, Lavori e manutenzioni | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Sistemi Informativi | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Chirurgico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | |
| Dipartimento Salute Mentale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Oncologico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Medico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento dei Servizi | <input type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> C | Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | altre Funzioni di Staff | |
| Dipartimento di Prevenzione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Comitato Unico di Garanzia | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Dipartimento Materno-Infantile | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Area Distrettuale Adriatico | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| Distretto di | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Area Distrettuale Gran Sasso - Laga | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Internal Audit | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Servizio Farmaceutico Territoriale | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Organismo indipendente di valutazione | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Medicina Penitenziaria | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Ufficio Procedimenti Disciplinari | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Servizio Dipendenze Patologiche | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Gestione del Rischio | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Farmacia Ospedaliera di | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | Relazioni Sindacali | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C |
| | <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C | U.O. di Monitoraggio Contratti | <input type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> C | | |