

ORIGINALE

**REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – TERAMO**

**DIPARTIMENTO TECNICO LOGISTICO
U.O.S.D. INGEGNERIA CLINICA**

17 APR. 2023

Il giorno _____, l'Ing. Fabiola Fiore, nella qualità di Direttore dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Ingegneria Clinica, in forza della Deliberazione n. 1555 del 26/08/2022, nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011, modificata ed integrata con Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente:

ORDINANZA N. 0700

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA MEDIANTE SOSTITUZIONE CON EQUIVALENTE RIGENERATO (CD. REPAIR EXCHANGE) PER SONDA TRANSESOFOGEEA MARCA "GE HEALTHCARE", MODELLO "6TC-OR TEE", S/N 95149 INV. 0011666 IN DOTAZIONE PRESSO L'U.O.C. CARDIOLOGIA U.T.I.C. DEL P.O. DI GIULIANOVA. NEGOZIAZIONE MEPA N. 3463959. CIG. Z273A25273.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che presso la U.O.C. Cardiologia U.T.I.C. del P.O. di Giulianova è in dotazione la sonda transesofagea marca "GE Healthcare" modello "6TC-OR TEE", s/n 95149 inventario n. 0011666, acquistata con deliberazione n. 1481 del 02/12/2014 come parte della fornitura di un ecografo color doppler per uso cardiologico;

VISTA la richiesta di intervento per manutenzione correttiva 2023/00255 (*all. doc. 1*) sulla suddetta sonda ecografica, trasmessa il giorno 25/01/2023 dalla citata unità operativa utilizzatrice della stessa;

PRESO ATTO della nota W2301092 del 16/02/2023 (*all. doc. 2*) con cui la ditta Hospital Consulting Spa, aggiudicataria del servizio global per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, stante la non riparabilità tecnica per numerosi difetti sulla guaina esterna (*all. doc. 3*) ed alcuni cavetti interni danneggiati (*all. doc. 4*), ne propone la sostituzione in formula exchange con equivalente al costo totale di € 10.580,00 iva esclusa con garanzia di 3 mesi e sconto totale del prezzo (€ 3.924 iva esclusa) di noleggio del muletto di pari modello già in uso da 55 giorni al Gruppo Operatorio di Cardiocirurgia del P.O. di Teramo;

RICHIAMATI:

- D.Lgs. 46/97 ("Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici");



- D.lgs. 81/08 (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*);
- La Raccomandazione n. 9 settembre 2008 del Ministero della Salute per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali;
- D.lgs. 106/2009 (*"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*);
- Direttiva CEE 2009/104 (*"Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro"*);
- CEI EN 62353 (CEI 62-148:2015) (*"Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali"*);

CONSIDERATO che la vigente normativa di settore sopra richiamata impone l'obbligo di un'adeguata ed efficace manutenzione per le apparecchiature elettromedicali e a titolo esemplificativo ma non esaustivo si rinvia a:

- art 3 del D.Lvo 46/97, in attuazione della direttiva 93/42 CEE, riguardante i dispositivi medici in generale: *"(cit.) i dispositivi possono essere ... messi in servizio unicamente se sono oggetto di un'adeguata manutenzione ..."*;
- par. 5.41 della norma CEI 62-148:2015 "Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali" : *"(cit.) Tutte le attività di manutenzione, ispezione, assistenza e riparazione effettuate secondo le istruzioni del fabbricante mantengono la conformità alla Norma utilizzata per la progettazione dell'apparecchiatura. In caso contrario, la conformità alle prescrizioni applicabili dovrebbe essere valutata e verificata prima di effettuare le prove indicate nella presente Norma"*;
- la Raccomandazione n. 9 settembre 2008 del Ministero della Salute, per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali: *"(cit.) è, quindi, assolutamente imprescindibile che la manutenzione delle apparecchiature sia gestita in modo corretto ed efficace"*;

RICHIAMATI altresì:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cd. *"Codice dei contratti pubblici"* e ss.mm. ii.;
- Le norme del cd. *"regime transitorio"*, ossia: D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 e D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in l. 108 del 29 luglio 2021;

CONSIDERATI in particolare i seguenti lemmi giuridici relativi all'affidamento diretto di servizi e forniture:



- 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- 51 comma 2 del D.lgs. 77/2021, convertito in l. 108 del 29 luglio 2021, che in deroga a quanto stabilito dal predetto art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di procedere per l'acquisizione di servizi e forniture mediante affidamento diretto fino alla soglia di € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando i principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

RICHIAMATI i precetti normativi relativi agli obblighi procedurali di ricorso a convenzioni Consip ed agli altri sistemi digitali di acquisto messi a disposizione sul M.E.P.A.:

- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: *"...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA"*;
- 9 comma 3-bis della Legge n. 89/2014 ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetto aggregatori, ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai comma 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto..."*;
- 1 comma 450 della l. n. 296/2006, così modificato dall'art. 1 comma 130 della l. n. 145/2018, ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo n. 165, per gli*



MP

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

ATTESO che:

- ad oggi non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell’ambito di quelle individuate dall’art. 1 del DPCM dell’11/07/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16/08/2018 per le quali è previsto l’obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, quindi è possibile procedere autonomamente all’attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che il servizio in oggetto è presente nei cataloghi del M.E.P.A. posti a disposizione da Consip alla voce *“Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”*;

DATO ATTO che in data 03/03/2023 sul Portale degli Acquisti in Rete P.A./MEPA è stata avviata un’apposita Trattativa Diretta, n. 3463959 (*all. doc. 5*), con invito rivolto alla ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING (P.I. 03010380487) per il servizio repair exchange della sonda transesofagea marca “GE Healthcare” modello “6TC-OR TEE”, s/n 95149 inventario n. 0011666, chiedendo espressamente la conferma delle condizioni contrattuali già proposte con il preventivo W2301092 del 16/02/2023;

PRESO ATTO che in data il citato Fornitore ha risposto alla trattativa citata (*all. doc. 6*) reiterando l’anzidetta offerta per la sostituzione in formula exchange con equivalente della sonda guasta al costo totale di € 10.580,00 iva esclusa e con garanzia di 3 mesi;

PRECISATO che l’importo in parola:

- è ricompreso nella fascia di valore che, ai sensi delle prescrizioni codicistiche e delle norme aventi carattere derogatorio in narrativa richiamate, consente l’affidamento diretto alle stazioni appaltanti;
- è stato valutato congruo dai tecnici della Unità Operativa disponente il presente provvedimento dirigenziale

RITENUTO opportuno, alla luce del richiamato quadro normativo e delle considerazioni di merito esposte, di doversi:

1. affidare mediante stipula della Trattativa Diretta Mepa n. 3463959 alla ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING (P.I. 03010380487), il servizio repair exchange della sonda transesofagea marca “GE



Healthcare" modello "6TC-OR TEE", s/n 95149 inventario n. 0011666 per un importo complessivo di € 10.580,00 iva esclusa e con garanzia di 3 mesi;

2. dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento e ammontante ad iva inclusa, si farà fronte con l'impegno di spesa di cui al prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
3. precisare che in ragione del valore dell'affidamento in oggetto e delle motivazioni esposte in narrativa, la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
4. nominare Direttore dell'esecuzione del presente contratto l'Ing. Claudio Castagnola Melchiorre, Collaboratore Tecnico Professionale della U.O.S.D. Ingegneria Clinica;
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

VISTI i Decreti legislativi nn. 502/92 e 286/99 e s.m.i. riguardanti la dirigenza pubblica;

DISPONE

1. **AFFIDARE** mediante stipula della Trattativa Diretta Mepa n. 3463959 alla ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING (P.I. 03010380487), il servizio repair exchange della sonda transesofagea marca "GE Healthcare" modello "6TC-OR TEE", s/n 95149 inventario n. 0011666 per un importo complessivo di € 10.580,00 iva esclusa e con garanzia di 3 mesi;
2. **DARE ATTO** che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento e ammontante ad iva inclusa, si farà fronte con l'impegno di spesa di cui al prospetto finanziario in calce al presente provvedimento;
3. **PRECISARE** che in ragione del valore dell'affidamento in oggetto e delle motivazioni esposte in narrativa, la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
4. **NOMINARE** Direttore dell'esecuzione del presente contratto l'Ing. Claudio Castagnola Melchiorre, Collaboratore Tecnico Professionale della U.O.S.D. Ingegneria Clinica;
5. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Letto, confermato e sottoscritto.



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO LOGISTICO
U.O.S.D. INGEGNERIA CLINICA

ALLEGATI ALL'ORDINANZA

- **Allegato n. 1** – Richiesta di intervento tecnico
- **Allegato n. 2** – Nota di accompagnamento Hospital Consulting
- **Allegato n. 3** – foto
- **Allegato n. 4** – rapporto tecnico
- **Allegato n. 5** - Trattativa Diretta, n. 3463959
- **Allegato n. 6** - OE Hospital Consulting

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Laura Prosperì)



A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

 U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio	Modulistica RICHIESTA DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA SU APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	Documento: Mod. PA07 03 Revisione n.: 2 Data: 28/09/2012 pag. 1 di 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Ripetere il numero presente sull'etichetta applicata all'apparecchiatura. Esempio:

n° Inventario: ECOCARFO 0011666

202.000.10.004
 0858220348
 0003802
 01/01/2012

PRESIDIO OSPEDALIERO / STRUTTURA AMBULATORIALE: CASA
 GIULIANOVA

UNITA' OPERATIVA: CARDIOLOGIA UTIC TEL. 085 8220348

PERSONA DI RIFERIMENTO: COORDINATORE UTIC

APPARECCHIATURA SU CUI INTERVENIRE: SOLIDA SU BRACCIALE
IN CORSO DI ESAME

N° SERIE O MATRICOLA: _____

DESCRIZIONE DEL GUASTO: _____

ALTRE EVENTUALI NOTE: URGENTISSIMO

DATA: 25 di GEN 2023 IL RICHIEDENTE: Dr. Sc. Legame

ORA: 10.45 TIMBRO E FIRMA: Legame
 (del richiedente)

FAX ASSISTENZA	linea interna	29938
	linea esterna	0861/217492
TEL. ASSISTENZA	linea interna	29946
	linea esterna	0861/429946

Riservato all'ATI
 Hospital Consulting S.p.a. - G.S.


2023/00255



MP



ALLEGATO 2



W2301092- Gestione della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali – Proposta di Dismissione / Exchange SONDA TRANSESOFA GEA, prod. GE Healthcare // Richiesta 2023/00255 (Allegato 1).

MP

AU, 2



Azienda Sanitaria Locale di Teramo
 Presidio Ospedaliero "G. Mazzini" - Piazza Italia, 1
 64100 - Teramo
 U.O.S.D. Ingegneria Clinica
 Alla c.a. dell'Ing. Fabiola Fiore

Prot. W2301092 del 16/02/2023

Oggetto: Gestione della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali - Proposta di Dismissione / Exchange SONDA TRANSESOFAGEA, prod. GE Healthcare // Richiesta 2023/00255 (Allegato 1).

In riferimento all'Art. 3.12 del Capitolato tecnico regolante l'attività di manutenzione, nello specifico, la proposta di dismissione, all'interno del Servizio di Manutenzione delle Apparecchiature Biomedicali offerto dalla scrivente ATI, si segnala l'impossibilità a procedere nel completamento della riparazione della seguente apparecchiatura in uso presso U.D.C. CARDIOLOGIA U.T.I.C. del P.O. di Giulianova:

Descrizione: SONDA TRANSESOFAGEA
 Marca: GE HEALTHCARE
 Modello: 6TC-OR TEE
 Matricola: 95149
 Inventario: 0011666

Nello specifico, si riporta che la sonda presenta numerosi difetti sulla guaina esterna (Allegato 2) e alcuni cavetti interni danneggiati e risulta essere non riparabile (Allegato 3).

In alternativa avanziamo due ipotesi:

1- Sostituzione in Exchange:

Descrizione	Importo
Sonda GE mod. 6Tc-RS (2021) *	9.480,00 €
Adattatore per Vivid 9	1.100,00 €
Totale	10.580,00 €

*Garanzia: 3 mesi

Tempi di consegna: entro 3/5 giorni data ricevimento ordine.



U.O.S.D. INGEGNERIA CLINICA
 INGEGNERE CLINICO
 CLAUDIO CASTAGNOLA M.

2- Noleggio muletto:

Descrizione	Importo
Sonda GE mod. 6Tc-RS (72 € al giorno, festivi inclusi) 30 gg	3.600,00 €
Adattatore per Vivid 9	324,00 €
Totale	3.924,00 €

W2301092- Gestione della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali - Proposta di Dismissione / Exchange SONDA TRANSESOFAGEA, prod. GE Healthcare // Richiesta 2023/00255 (Allegato 1).

Vivid ES inv. H1667

OK

MF



Considerando che un muletto di pari modello è attualmente in utilizzo presso il GRUPPO OPERATORIO CARDIOCHIRURGIA del P.O. di Teramo (richiesta 2022/03261) da 55 giorni, se si deciderà di procedere con la sostituzione in Exchange, indipendentemente se per la richiesta 2022/03261 o la richiesta 2023/00255, il noleggio non verrà conteggiato.

Appena avremo la dichiarazione di non riparabilità di casa madre, sarà ns premura integrare la presente proposta di dismissione.

In attesa di un vostro cortese riscontro in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Hospital Consulting S.p.a.

Ing. Maria Grazia Mazzoccoli





Chirurmedica®

Via Bardet,33/39
65126 Pescara - Italia
Tel.: +39.085.4510466
Fax: +39.085.4510516
E-mail: info@chirurmedica.it
Web: www.chirurmedica.it
CODICE UNIVOCO: E06UCUD

Spett.le
ASL TERAMO
UOC INGEGNERIA CLINICA
Piazza Italia, 1
64100 TERAMO

E-mail: ingegneria.clinica@aslteramo.it

Li, 22 febbraio '23

OGGETTO: NS.OFFERTA N.027/23 DEL 22/02/23 PER :
"REPAIR/EXCHANGE SONDA TRANSESOFAGEA GE 6Tc"

Con rif.to alla Vs. richiesta e-mail del 16/02/2023 siamo ad inviarVi la ns. migliore offerta alle condizioni sotto specificate per il repair/exchange del materiale di cui in oggetto:

Codice Articolo	Descrizione	Q.tà	Codice Articolo	P.Unitario Netto (iva esclusa)	Iva
H45551ZD	Sonda Transesofagea 6Tc	1	H45551ZD	REPAIR/EXCHANGE	€ 19.450,00
TOTALE IVATO				€ 23.729,00	22%

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA :

CONSEGNA : entro 30 gg. f. d.r.o.
VALIDITA' PREZZI : 180 gg.
TRASPORTO : Ns.carico
PAGAMENTO : Bonifico entro 60 gg. D.r.f.
GARANZIA : 12 mesi
IVA : 22% Vs.carico

Ufficio Commerciale

Dal 1970 fornitore di APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI

Cap. Soc. € 1.294.700 - C.C.I.A.A. PE 81112 - Cod. Fis. - P. IVA - Reg. Imprese PE 01282940681



ITALIA FM
Health Facility Management


SIEMENS
Healthcare

ALLEGATO 1




W2301092- Gestione della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali – Proposta di Dismissione / Exchange SONDA TRANSESOFOGEEA, prod. GE Healthcare // Richiesta 2023/00255 (Allegato 1).


MARIA LON

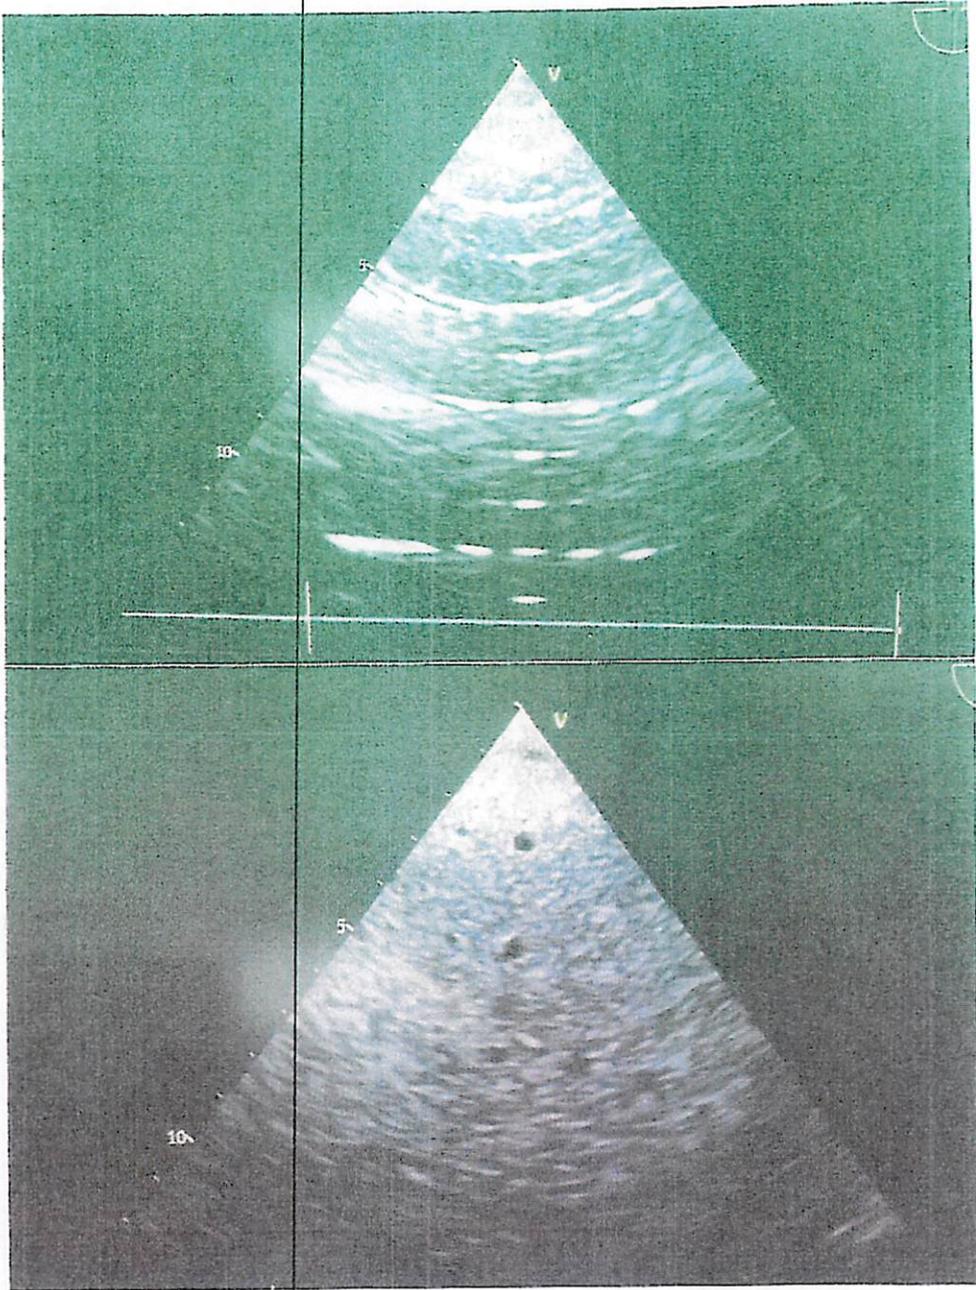

MS

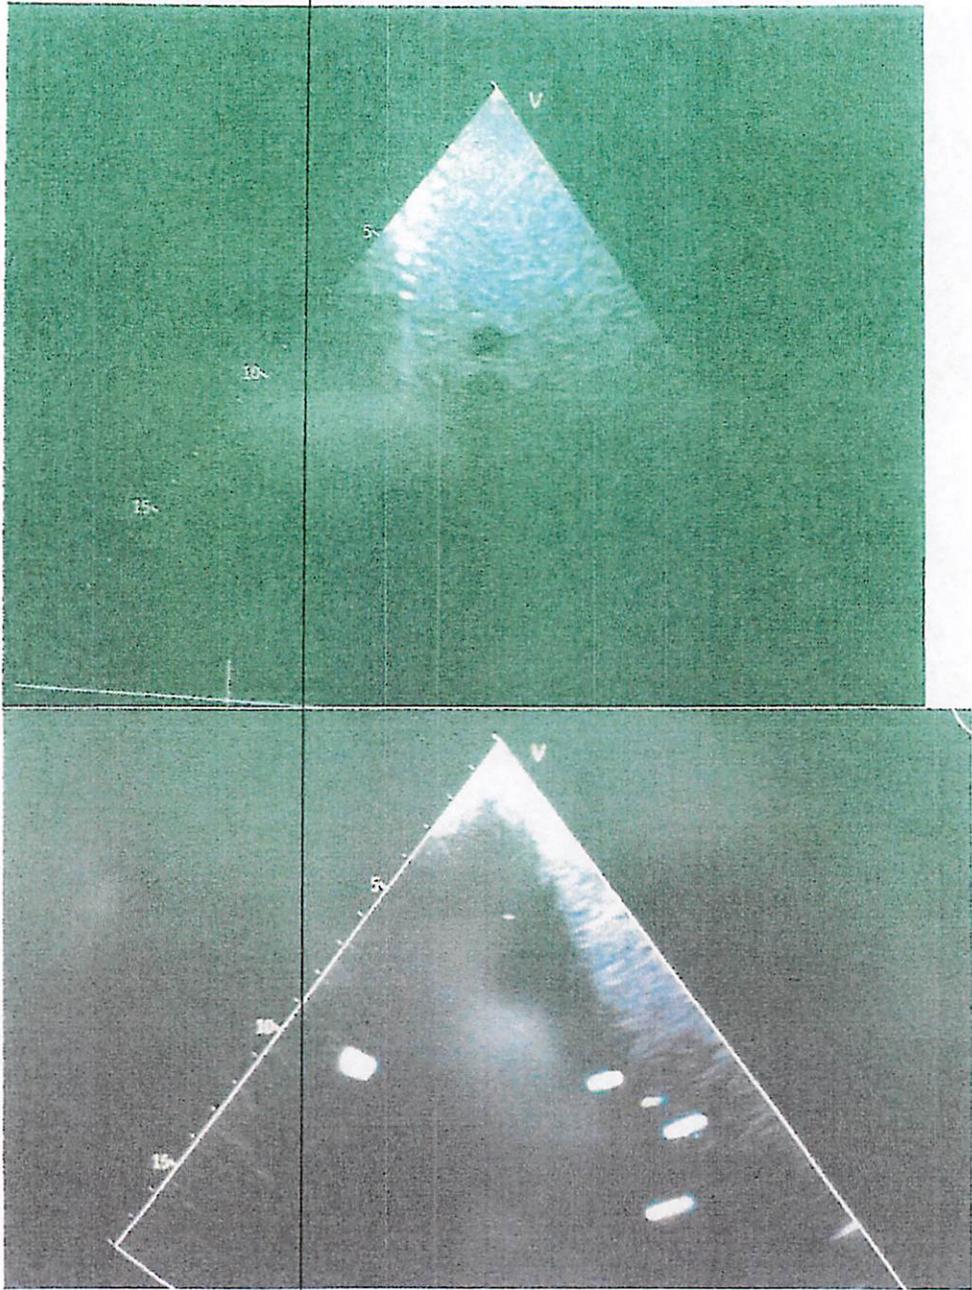


[Handwritten signature]

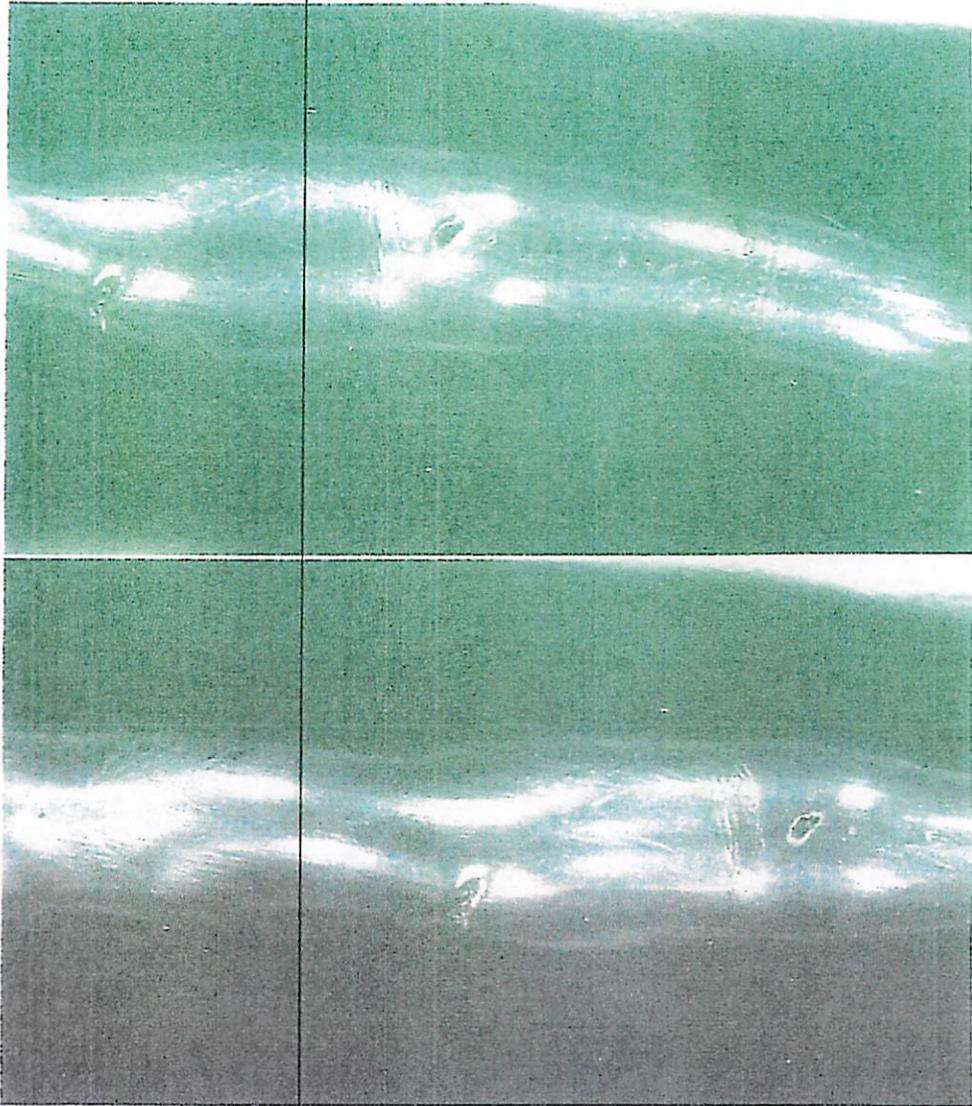

SECRETARIA LOCAL

HP

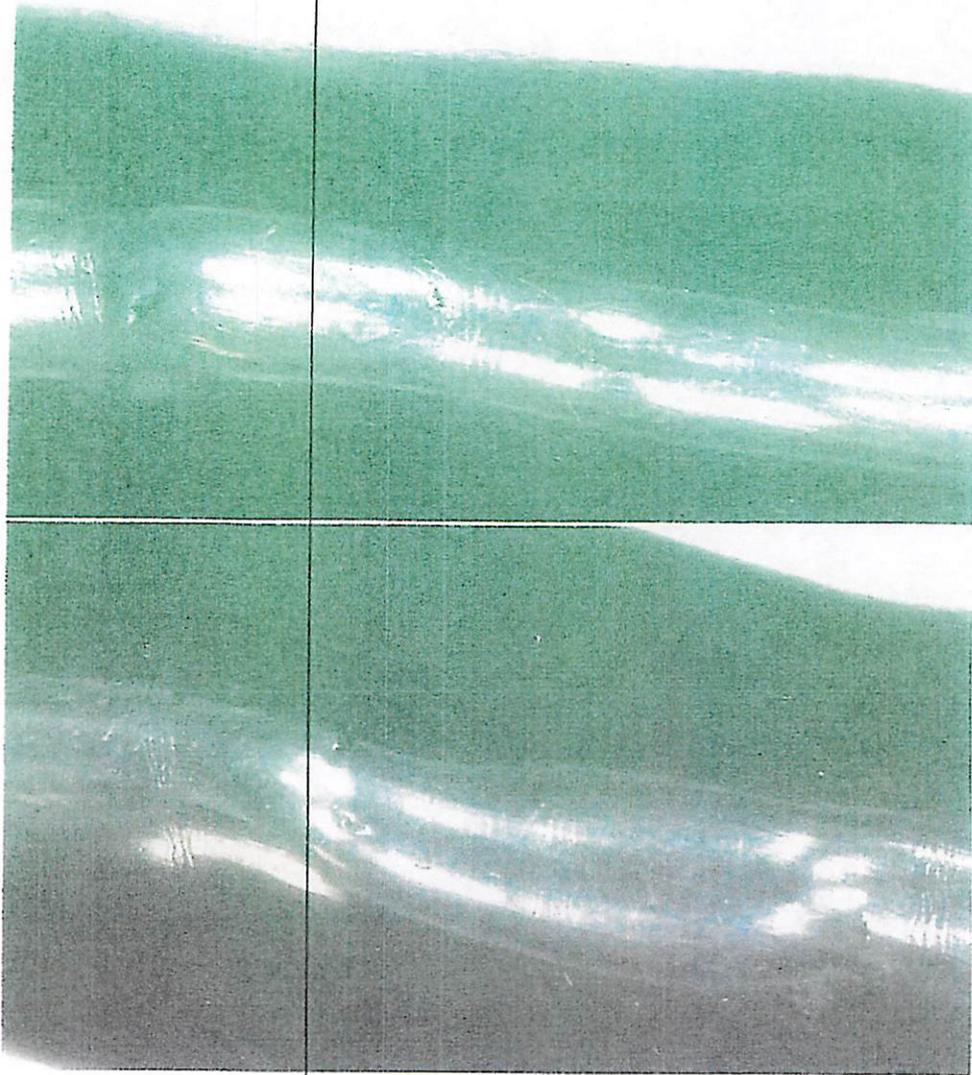


48

ARIAL
LON




MP

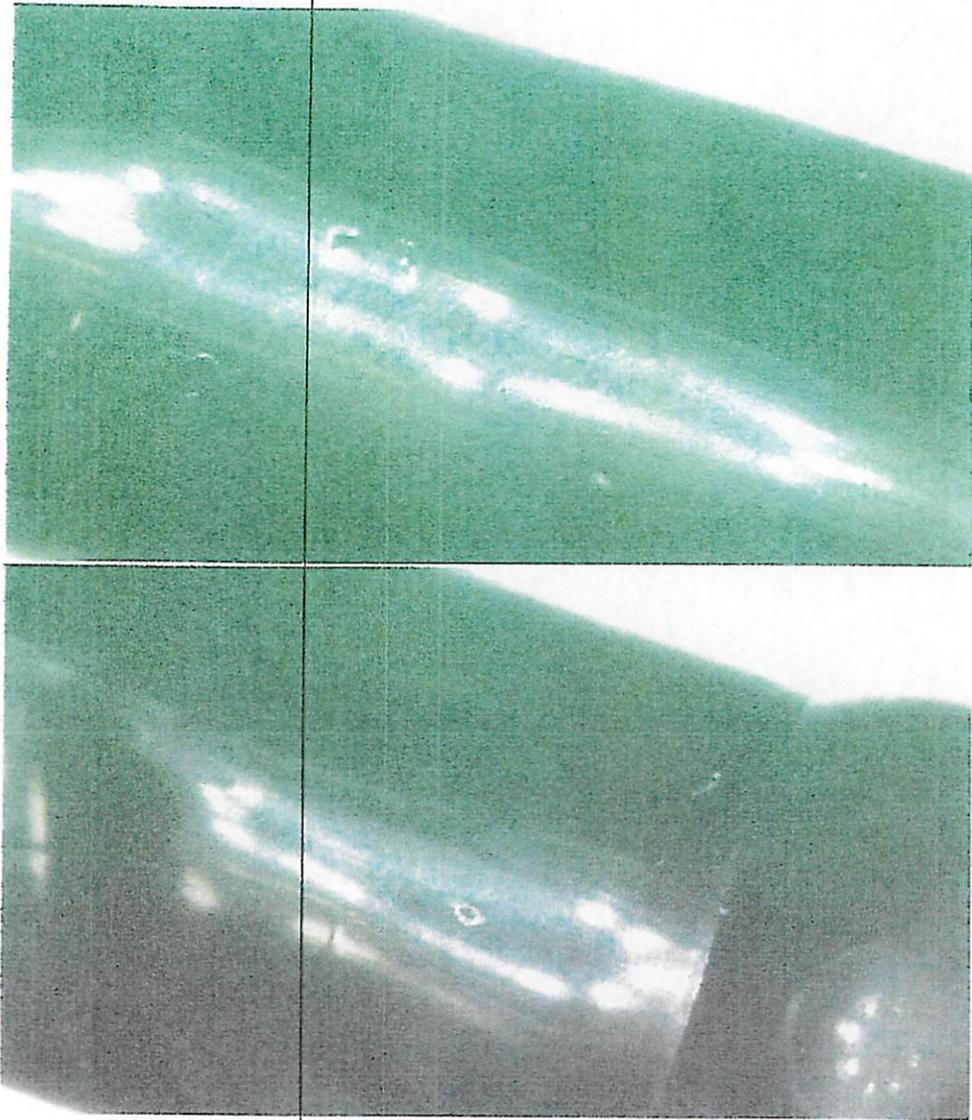


A small, handwritten mark or signature located in the bottom left corner of the page. It consists of a few dark, scribbled lines.

ATM
FARIALU

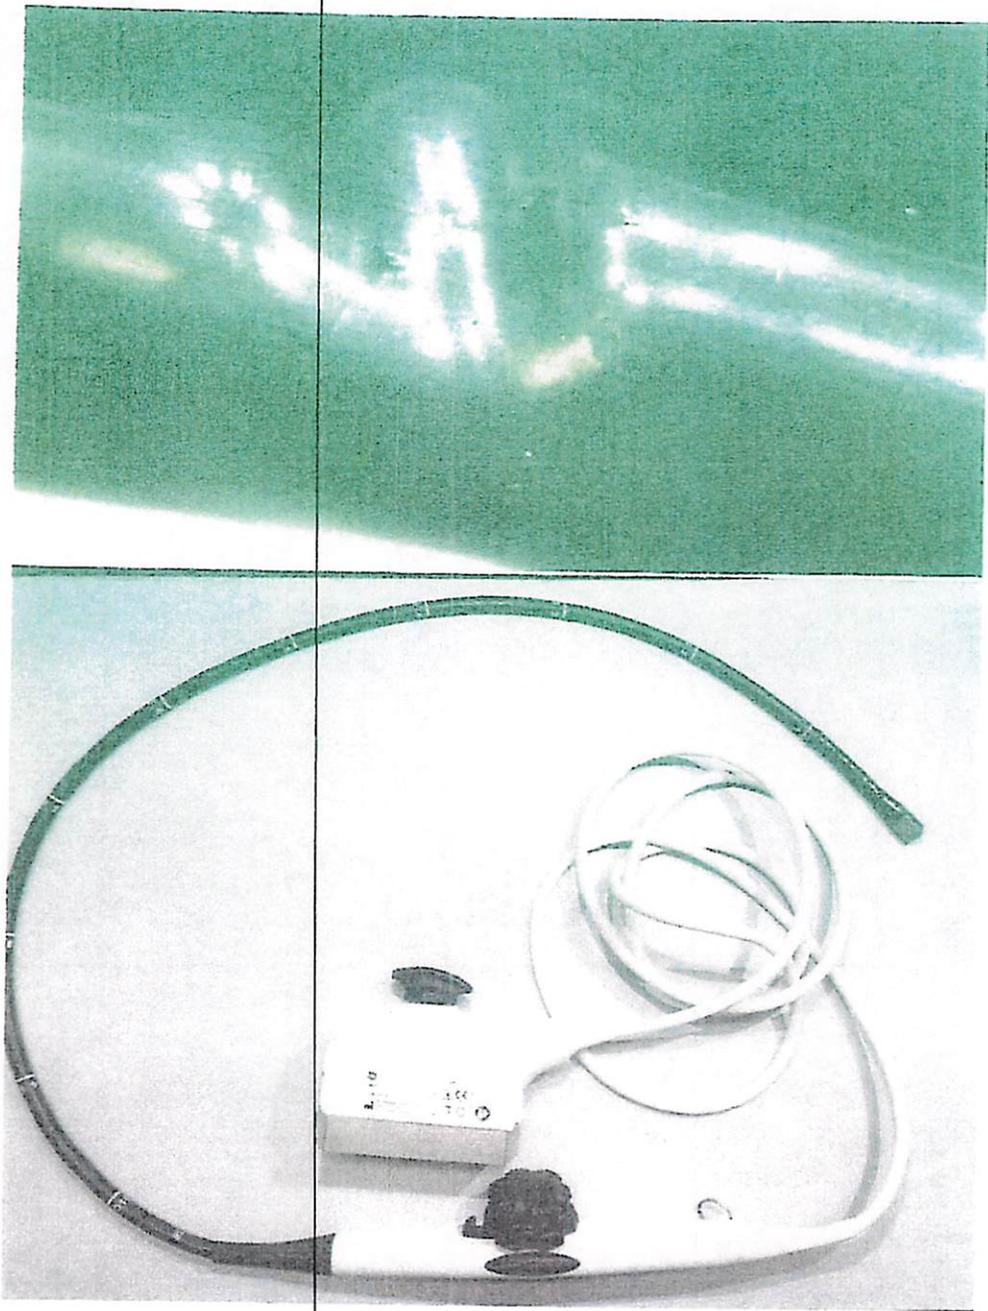

MP

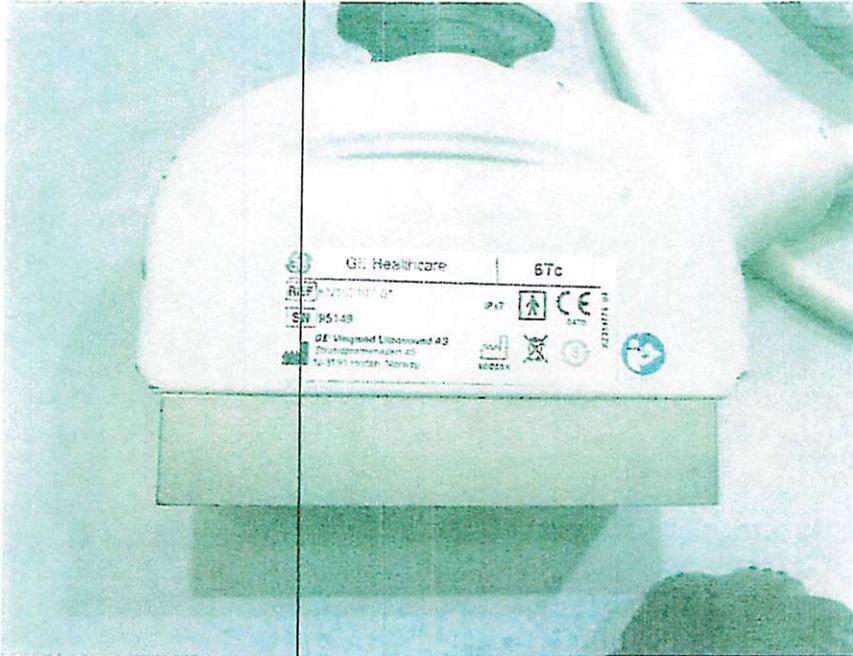

Handwritten signature or initials in the bottom left corner of the page.



ALLEGATO 3

MP

Alt 14



ANALISI - PROTOCOLLO D'ENTRATA NR.: 20230135

Secondo Normativa EN 62353

Data:	30.01.2023	Ordine nr.:	
Produttore:	GE	Resp. del progetto:	Patrick Lojnik
Modello sonda:	6Tc-OR	Cliente:	HC Hospital Consulting
Numero seriale:	95149		

1. ANALISI VISIVA

	OK	ACCETTABILE	FALLITA
Rivestimento della lente acustica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guaina sondale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guscio sondale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protezione antipiega	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guscio del connettore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cappuccio sondale (3D/4D)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perdita d'olio (3D/4D)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cavi tiranti (TEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rivestimento IT (TEE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spirale sondale (TEE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bending rubber (Guaina distale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. ANALISI ELETTRONICA / MECCANICA

MotControl (3D/4D/TEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cristalli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cavo sondale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contatti del connettore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. ANALISI SICUREZZA ELETTRICA (LEAKAGE TEST)




<input type="checkbox"/> Fluke ULT800	<input type="checkbox"/> Optima C-10	SUPERATO	NON SUPERATO	RISULTATO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ortner Medizintechnik e.U. • Strauchweg 26 TOP 1-3 • A-8501 Lieboch • +43 (0) 3136-62155 • office@ort-med.com







Handwritten signature

Handwritten initials or signature.

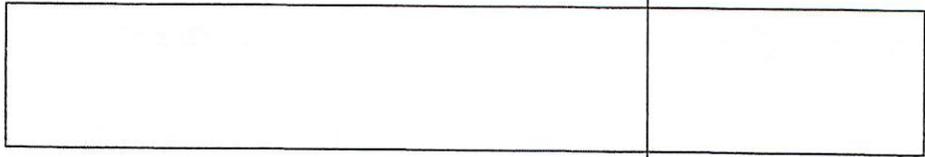

Note:

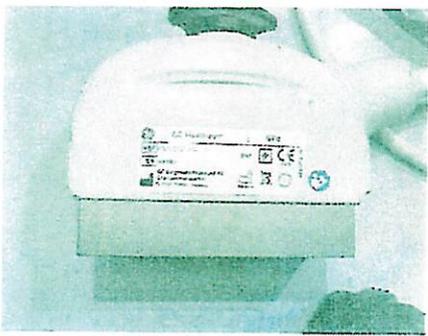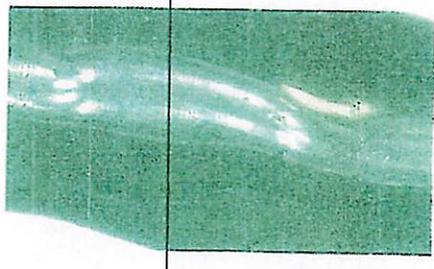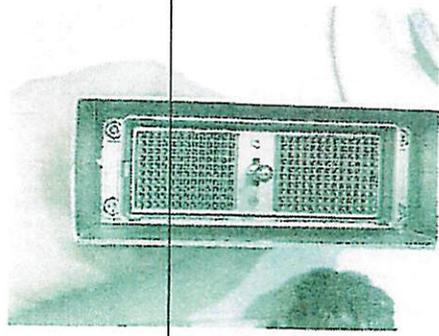
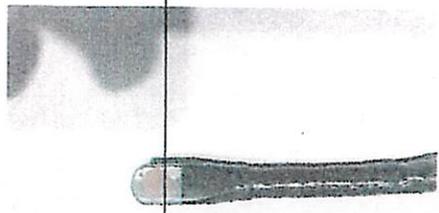


4. IMMAGINI D'ENTRATA





5. IMMAGINE PHANTOM (LIVE TEST)

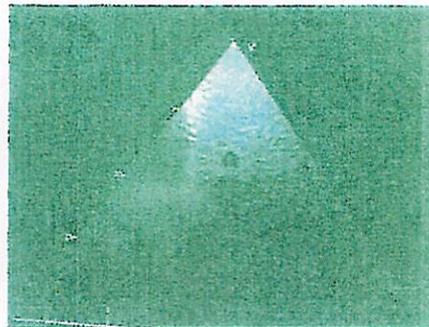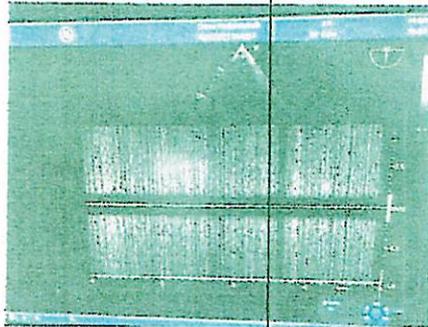

Note:

Empty rectangular box for notes.

6. SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DELLA SONDA

SI 02_Alcuni_cavetti_interni_danneggiati

NO

7. RIPARAZIONI RACCOMANDATE

ECD35-Nessuna_riparazione_possibile	-
-	-
-	-
-	-

Note:

Empty rectangular box for notes.

Walter Clementi

Walter Clementi
2023.01.30
12:14:00 +01'00'

Responsabile della pratica

Patrick Lörink
Firma dell' Esaminatore

Ortner Medizintechnik a.U. • Strauchweg 26 TOP 1-3 • A-8501 Lieboch • +43 (0) 3136-62155 • office@ort-med.com

mp

Att-10 S

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

servizio di riparazione in formula "repair exchange" della sonda transesofagea GE HEALTHCARE modello 6TC-OR TEE matricola 95149 inv. 0011666 in dotazione presso la U.O.C. di Cardiologia U.T.I.C. del P.O. di Giulianova, secondo proposta di preventivo prot. W2301092 del 16/02/2023

Dati Principali

Numero RDO

3463959

Nome RDO

riparazione repair exchange sonda transesofagea GE HEALTHCARE modello 6TC - OR TEE s/n 95149 inv. 0011666 in dotazione presso l'U.O.C. Cardiologia U.T.I.C. del P.O. di Giulianova

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Affidamento Diretto per Beni e/o Servizi fino a 40.000 Euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

LAURA PROSPERI
PRSLRA82B59L103M

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

LAURA PROSPERI PRSLRA82B59L103M

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL 4 Teramo

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL 4 Teramo



Date

Pubblicazione

 03/03/2023 10:59

Inizio presentazione offerte

 03/03/2023 10:59

Termine ultimo presentazione offerte

 31/03/2023 00:00

Data limite stipula contratto

 31/12/2023 00:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

1



Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

CIG
Z273A25273

CUP
-

CPV Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
50420000-5	Servizi di riparazione e	Servizi di assistenza,	100
50422000-9	manutenzione di attrezzature	manutenzione e riparazione di	
50421200-4	medico-chirurgiche	apparecchiature elettromedicali	
50421100-3			
50421000-2			

Formulazione offerta economica
VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta
2

Termini di pagamento
60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura
€ 10.580,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: PIAZZA ITALIA 1 C/O OSPEDALE G.MAZZINI, II LOTTO, III PIANO TERAMO (TERAMO); Consegna: PIAZZA ITALIA 1 C/O OSPEDALE G.MAZZINI, II LOTTO, III PIANO TERAMO (TERAMO); Aliquote: secondo la normativa vigente

Z273A25273



Handwritten signature or initials.

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

03010380487

H.C. HOSPITAL CONSULTING



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Att. to 6

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

riparazione repair exchange sonda transesofagea GE HEALTHCARE modello 6TC - OR TEE s/n 95149
inv. 0011666 in dotazione presso l'U.O.C. Cardiologia U.T.I.C. del P.O. di Giulianova
NUMERO RDO 3463959

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL 4 Teramo

CF AMMINISTRAZIONE 00115590671

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

H.C. HOSPITAL CONSULTING

PARTITA IVA

03010380487

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome**Valore****Valore offerto****10580,00**

Elenco dichiarazioni abilitazione



SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione dei "SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	51216898,00
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.



Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT



[Handwritten signature]

U.O.S.D. INGEGNERIA CLINICA

Ditta: H.C. HOSPITAL CONSULTING (P.I. 03010380487)

CIG: Z273A25273

Sottoconto: 07.03.03.01.01.00

Spesa anno 2023 € 12.907,60 iva inclusa - UA_ING_CLINICA/2022/1/57

Fonte di finanziamento: BILANCIO – FSN

Data _____


Il Dirigente Responsabile Ing. Clinica
(Ing. Fabiola Fiore)



U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – TERAMO

Originale

Il Responsabile
dell'Istruttoria:
Dott.ssa Laura Prosperi

Laura Prosperi

Il Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Laura Prosperi

Laura Prosperi

Il Dirigente Responsabile
dell'U.O.S.D.
Ingegneria Clinica
Ing. Fabiola Fiore

Fabiola Fiore

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale Informatico in data **17 APR. 2023** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L' addetto alla pubblicazione informatica

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Inviata al Collegio Sindacale in data

A small handwritten mark or signature in the bottom left corner.