

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 0686 del 09 APR. 2021

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI DEDICATI A UN SISTEMA DI IMMOBILIZZAZIONE PER TRATTAMENTI RADIOTERAPICI GIA' IN USO PRESSO DELL'U.O.C. RADIOTERAPIA DEL P.O. DI TERAMO. CIG Z7430D311F

Data 26/03/2021 Firma [Signature]

Data 26/03/2021 Firma [Signature]

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Emiliano Capasso

Il Responsabile del procedimento
Dott. Emiliano Capasso

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
(Dott.ssa Rossella Di Marzio)

26.3.21 Firma [Signature]
Il Direttore dell'U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
- non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 08/04/2021

Firma [Signature]
Il Direttore Amministrativo: Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
- non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 08/04/2021

Firma [Signature]
Il Direttore Sanitario: Dott. Maurizio Brucchi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'ambrosio

VISTA la richiesta, acquisita con Prot. Nr. 35583 del 01/03/2020 (all. 1), sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Oncologico Dott. Carlo D'Ugo, con la quale si richiede l'acquisto di:

- nr. 3 Monarch™ Individual Hands Grip (marca: CIVCO, COD. PROD. OAP160);
- nr. 3 Monarch™ Thermoplastic Frame (marca: CIVCO, COD. PROD. OAP120);
- nr. 1 C-Qual M BreastBoard (marca: CIVCO, COD. PROD. MTM400);
- Nr. 2 C-Qual™ BreastBoard con sistema Monarch (marca: CIVCO, COD. PROD. MT401);

sistemi di immobilizzazione ad integrazione di sistemi già in uso presso l'U.O.C. Radioterapia del P.O. di Teramo;

DATO ATTO che i beni oggetto della presente procedura di gara sono previsti nel piano dei fabbisogni aziendali per il Dipartimento Oncologico, approvato con deliberazione n. 601 del 25/03/2021, per un valore presunto di € 38.980,00 e ordine di priorità 2;

VISTI gli articoli:

- 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e stabilisce che: *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni.....si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice..."*;
- 36 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina, in particolare, i principi da seguire nell'affidamento di contratti di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi del quale *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50"*;
- 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 che, fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto stabilito all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di procedere, per l'acquisizione di servizi e forniture, mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 75.000,00;
- 1 comma 450 della legge n.296 del 2006 così come modificato dall'art.1, comma 130 della legge 30.12.2018 n.145 ai sensi del quale: *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: *"...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario,*



come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA”;

- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...”;

ATTESO che

- 1) ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.08.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- 2) da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che il bene oggetto di acquisizione è presente nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messi a disposizione da Consip;

PRECISATO che il presente provvedimento vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 3 della legge n. 120/2020;

DATO ATTO che, per quanto sopra, è stata inoltrata Trattativa Diretta sulla piattaforma Mepa nr. 1620611 (all.2) alla ditta Tema Sinergie (P. Iva 00970310397), rivenditore dei prodotti CIVCO per il territorio nazionale, al fine di ottenere un'offerta economica per la fornitura dei beni in argomento;

DATO ATTO che in data del 23/12/2020 la succitata ditta presentava la seguente offerta tecnico-economica (all.3):

- nr. 3 Monarch™ Individual Hands Grip (marca: CIVCO, COD. PROD. OAP160) al costo unitario di € 769,00 iva esclusa;
- nr. 3 Monarch™ Thermoplastic Frame (marca: CIVCO, COD. PROD. OAP120) al costo unitario di € 652,00 iva esclusa;
- nr. 1 C-Qual M BreastBoard (marca: CIVCO, COD. PROD. MTM400) al costo unitario di € 13.988,00 iva esclusa;
- Nr. 2 C-Qual™ BreastBoard con sistema Monarch (marca: CIVCO, COD. PROD. MT401) al costo unitario di € 10.362,00 iva esclusa;

per complessivi € 38.975,00 iva esclusa;

DATO ATTO della nota agli atti, a firma del legale rappresentante della ditta offerente, con la quale dichiara che l'offerta presentata è allineata alle condizioni praticate alle altre Strutture del S.S.N.;

RITENUTO di affidare la fornitura in argomento, nei termini e nei modi di cui alla Trattativa Diretta sulla piattaforma Mepa nr. 1620611, alla ditta Tema Sinergie (P. Iva 00970310397) con sede legale in via Malpighi, 120 – Faenza (RA);

RITENUTO, inoltre nominare come direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore dell'U.O.C. Radioterapia del P.O. di Teramo Dott. Carlo D'Ugo, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, trattandosi di fornitura caratterizzata da particolare complessità sotto il profilo sanitario, oltretutto, che la fornitura in argomento, impone il coinvolgimento di unità operative diverse dalla proponente (U.O.C. Radioterapia del P.O. di Teramo)

RITENUTO, inoltre, doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire, con la massima tempestività l'approvvigionamento di cui trattasi;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: **Z7430D311F**;

PROPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

- affidare**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020, alla ditta Tema Sinergie (P. Iva 00970310397) con sede legale in via Malpighi, 120 – Faenza (RA), Pec: dp.ravenna@pec.agenziaentrate.it, la fornitura di:
 - nr. 3 Monarch™ Individual Hands Grip (marca: CIVCO, COD. PROD. OAP160) al costo unitario di € 769,00 iva esclusa;
 - nr. 3 Monarch™ Thermoplastic Frame (marca: CIVCO, COD. PROD. OAP120) al costo unitario di € 652,00 iva esclusa;
 - nr. 1 C-Qual M BreastBoard (marca: CIVCO, COD. PROD. MTM400) al costo unitario di € 13.988,00 iva esclusa;
 - Nr. 2 C-Qual™ BreastBoard con sistema Monarch (marca: CIVCO, COD. PROD. MT401) al costo unitario di € 10.362,00 iva esclusa;per complessivi € 38.975,00 iva esclusa alle condizioni tecnico economiche di cui alla Trattativa diretta sul Mepa n. 1620611;
- prenotare** la spesa di € 47.549,50 IVA inclusa come da prospetto finanziario in calce;
- nominare** come direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore dell'U.O.C. Radioterapia del P.O. di Teramo Dott. Carlo D'Ugo, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti di cui al par. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, trattandosi di fornitura caratterizzata da particolare complessità sotto il profilo sanitario, oltretutto, che la fornitura in argomento, impone il coinvolgimento di unità operative diverse dalla proponente (U.O.C. Radioterapia del P.O. di Teramo);
- precisare** che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione di quanto riportato in narrativa;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Di Giosia

Azienda Unità Sanitaria Locale 4
Teramo
Dipartimento Amministrativo – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

Allegato n. 1 - Richiesta Prot. Nr. 35583 del 01/03/2020 (pag. 1);


Allegato n. 2 - Trattativa diretta sul Mepa n. 1620611 (pagg. 2-4);

Allegato n. 3 – Offerta tecnico-economica Tema Sinergie (P. Iva 00970310397) (pagg. 4-22)

Allegati n. 22



2



ASL n.4 TERAMO	SCHEDA PER RICHIESTA ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	ALLEGATO n. 4
Trasmessa a:	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Data richiesta 5/08/19

U.O. richiedente UCC DI RADOTERAPIA Centro di Costo BIES Direttore DE CARLO D'UGO

PRESENZA DELL'ACQUISTO NEL PIANO DEI FABBISOGNI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CLASSE DI PRIORITÀ ASSEGNATA NEL PIANO DEI FABBISOGNI:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

N.B. : RICHIESTE DI ACQUISTO NON PRESENTI NEL PIANO DEI FABBISOGNI O CON PRIORITÀ SUPERIORE A 20 SONO IMPROCEDIBILI

Richiesta beni strumentali (apparecchiature, software, arredi, ecc.)		da destinare a: (Utente, Ubicazione e rif. telefonico)	Num. inventario vecchie apparecchiature (solo se sostituzione)	costo presunto (EURO)	eventuali annotazioni
Quantità	Descrizione materiale richiesto				
2	C-QUALI BREASTBOARD CON SISTEMA MONARCH-FRAME INCLINATO PER IL TRATTAMENTO DELLA MAMMELLA COD. M1400	29636	38.980,00		
1	C-QUALI BREASTBOARD COD. M1400				
3	MONARCH THERMOPLASTIC FRAME Cod. CAP120 PER FISSARE MASCHERE TERMOPLASTICHE				
3	MONARCH INDIVIDUAL HAND GRIP - KIT da utilizzare sul sistema per avere posizionamento ASIMMETRICO PER LE ARTI SUPERIORI Cod. CAP100				

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta Interna



Prot. n.0035583/21 del 01/03/2021

Breve descrizione del motivo dell'acquisto, delle attività da automatizzare e dell'eventuale software che si intende utilizzare:
TALI BENI DI AUTOMATIZZAZIONE VUOLTO AD INTEGRARE I SISTEMI CHÈ IN USO OGGI IN QUANTO RISOLVONO I QUANTO ALLE ESIGENZE SPECIFICHE

Riferimento fonte di finanziamento (FSN, fondi finalizzati, entrate proprie, ecc.)

Nome e Firma del Richiedente DR. CARLO D'UGO

Firma del Dirigente Responsabile dell'U.O.

ASL n.4 - TERAMO
U.O.C. P. I. Dip.
07-90-1319
Dr. Carlo D'Ugo

Visto per approvazione e controllo dei dati riportati
Direttore Responsabile della struttura (Presidio / Distretto / Dipartimento)

Annotazioni dell'Alta Direzione o firma per approvazione/parere tecnico

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1620611
Descrizione	Affidamento fornitura di sistemi di immobilizzazione
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z7430D311F
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 4 Teramo - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 00115590671 64100 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO (TE)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFPL0H
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI / RDMMRC59R14L103F
Soggetto stipulante	MARCO RODOMONTI / RDMMRC59R14L103F ASL 4 Teramo
Data e ora inizio presentazione offerta	01/03/2021 11:30
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	09/03/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/03/2021 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
Fornitore	TEMA SINERGIE
Valore dell'offerta economica	38980
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi -
Dati di Consegna	CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 1 - 3° PIANO TERAMO - 64100 (TE) ABRUZZO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione:

SCHEDA TECNICA 1 DI 4

Nome Scheda Tecnica	Monarch Individual Hand Grip
Quantità	3

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CIVCO
2	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Monarch Individual Hand Grip
3	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
4	*Codice prodotto	Tecnico	Valore unico ammesso	OAP160

SCHEDA TECNICA 2 DI 4

Nome Scheda Tecnica	Monarch Thermoplastic Frame per fissaggio maschere termoplastiche
Quantità	3

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CIVCO
2	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Monarch Thermoplastic Frame
3	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
4	*Codice prodotto	Tecnico	Valore unico ammesso	OAP120

SCHEDA TECNICA 3 DI 4

Nome Scheda Tecnica	C-QuaLM Breastbord
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CIVCO
2	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	C-QUALM Breastbord
3	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
4	*Codice prodotto	Tecnico	Valore unico ammesso	MT400

SCHEDA TECNICA 4 DI 4

Nome Scheda Tecnica	C-Qual Breastboard con sistema Monarch - Piano inclinato per trattamento mammella
Quantità	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CIVCO
2	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	C-QUAL Breastbord
3	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
4	*Codice prodotto	Tecnico	Valore unico ammesso	MT401

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
Modello tracciabilità flussi finanziari	modello dichiarazione tracciabilità.doc
DGUE	DGUE mepa.doc

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
DGUE compilato	Si
Modello Tracciabilità compilato	Si
Offerta tecnico/economica dettagliata	Si
Dichiarazione congruità prezzi praticati	Si

Spett.le
ASL 4 TERAMO
Circonv. Ragusa, 1
64100 TERAMO

Att.ne Acquisizione Beni e Servizi

Faenza, 5 marzo 2021

Vs. Rif.	TD MEPA 1620611	
Ns. Rif.:	OFFERTA N. 210597-T26-00	RA
OGGETTO:	Affidamento fornitura di sistemi di immobilizzazione – CIG Z7430D311F	

RELAZIONE TECNICA 210597A-T26-00

1. OAP160 Monarch™ Individual Hands grip

CND: V0804

RDM: D.M. di Classe I di produzione estera; non necessita di registrazione al repertorio

Modello: OAP160

Ditta Produttrice: CIVCO Medical Solutions Inc., USA

CIVCO
Radiotherapy

Responsabile dell'immissione in commercio: TEMA Sinergie S.p.A.



Coppia di maniglie singole integrabili al sistema Monarch Overhead Arm Positioner, sia nella versione standalone OAP110 sia in combinazione ai piani inclinati MTM400 e MT401.

Permettono di posizionare le braccia della paziente ad una diversa distanza in modo da avere posizionamento asimmetrico per supportare la paziente in limiti fisici o andare incontro ad una esigenza clinica di posizionamento con braccia svincolate (per esempio, trattamento sovraclaveare).

e

5



Dimensioni (L x W x H) cm

8.0 x 5.2 x 20.1

Peso (Kg)

0.25

Materiale principale

ABS nero, Acetale bianco

Indicizzazione

Interamente indicizzato

MANUTENZIONE

Non sono necessarie misure di manutenzione.

EVENTUALE TOSSICITÀ DICHIARATA

Nessuna.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Al termine della vita del prodotto, i componenti devono essere smaltiti in conformità con le regolamentazioni vigenti in termini di controllo dei rifiuti. I diversi materiali devono essere separati e riciclati in modo appropriato. Non contiene materiali pericolosi.



C

6

2. OAP120 Monarch™ Thermoplastic Frame

CND V0804

RDM D.M. di classe I di produzione estera; non necessita di registrazione al repertorio

Modello: OAP120

Ditta Produttrice: CIVCO Medical Solutions Inc., USA

CIVCO
Radiotherapy

Responsabile dell'immissione in commercio: TEMA Sinergie S.p.A.

Il sistema OAP160 integrabile con frame per il fissaggio di maschere termoplastiche MONARCH Thermoplastic Frame (cod. OAP120). Il frame permette di fissare maschere MasterCast™ Pro e Posicast™ su sistema Monarch™ sia nella versione standalone OAP110 sia in combinazione ai piani inclinati MTM400 e MT401.



Dimensioni (L x W x H) cm

27.4 x 19.6 x 1.6

Peso (Kg)

0.27

Materiale principale

Acetale nero, Delrin bianco

Indicizzazione

Accessorio fisso

MANUTENZIONE

Non sono necessarie misure di manutenzione.

EVENTUALE TOSSICITÀ DICHIARATA

Nessuna.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Al termine della vita del prodotto, i componenti devono essere smaltiti in conformità con le regolamentazioni vigenti in termini di controllo dei rifiuti. I diversi materiali devono essere separati e riciclati in modo appropriato. Non contiene materiali pericolosi.

3

7

3. MTM400 C-Qual M™

CND: V0804

RDM: D.M. di Classe I di produzione estera; non necessita di registrazione al repertorio

Modello: MTM400

Ditta Produttrice: CIVCO Medical Solutions Inc., USA

CIVCO
Radiotherapy

Responsabile dell'immissione in commercio: TEMA Sinergie S.p.A.



Piano inclinato in Kevlar, top di gamma per il trattamento della mammella, progettato per essere efficace nell'immobilizzazione, image-friendly, rigido e confortevole per le pazienti ed al contempo pratico, maneggevole e veloce nel setup per gli operatori.

Principali caratteristiche:

- **Image-friendly:** la scelta dei materiali è stata fatta per rendere il sistema compatibile con tutte le tipologie di imaging (inclusa la RM) e con sistemi di Monitoring Ottico (OSMS)
- Il supporto per braccia e polsi, denominato **Monarch™**, ha un'impugnatura a forma di lettera "M" di nuova concezione che permette la naturale flessione dei polsi del paziente fornendo al contempo molteplici opzioni di posizionamento: essa può scorrere in 12 prestabilite posizioni indicizzate in direzione cranio-caudale così da potersi adeguare alle diverse necessità delle pazienti.



- Il nuovo profilo Monarch™ migliora inoltre la stabilità ed il comfort della paziente giacché supporta le braccia fin dalla regione ascellare evitando così che la paziente possa compiere rotazioni

involontarie del busto durante il trattamento in quanto le braccia sono completamente appoggiate sul supporto e non sono in trazione.



- **Monarch™** e quindi il poggiatesta, può scorrere lungo il piano inclinato in direzione cranio-caudale al fine di adattarsi a qualunque statura, adulta e pediatrica.
- Include un poggiatesta in schiuma modello Wide Headrest, anatomico e universale che abbraccia e sorregge il capo e il collo in maniera confortevole. Possono essere inseriti/utilizzati tutti i poggiatesta Civco, nel modello Posifix.
- Il bacino è supportato dal **Bottom Stop**, un dispositivo ergonomico, antiscivolo e stabile che blocca la paziente in posizione ed evita che possa scivolare in avanti. La posizione del **Bottom Stop** è facilmente regolabile in 11 posizioni per meglio adattarsi alle diverse stature delle pazienti ed è indicizzato per essere riproducibile.
- L'inclinazione del piano è resa possibile grazie al sistema "Sure-Set" che garantisce un'inclinazione riproducibile, indicizzata, sicura, robusta, accurata e precisa da 5° a 25° con 9 diverse posizioni: 0°, 5°, 7.5°, 10°, 12.5°, 15°, 17.5°, 20°, 22.5°, 25°
- Il supporto Monarch™ può essere facilmente sfilato dal piano inclinato e utilizzato anche come dispositivo stand-alone per trattamenti a 0° di inclinazione, da ancorare direttamente al lettino di trattamento mediante barra di fissaggio.

3

9



Questo piano inclinato è indicizzabile a qualsiasi lettino di imaging/trattamento mediante barra di fissaggio.

È stato previsto di poter integrare al piano inclinato, sia un frame (cod. OAP120) per il fissaggio di maschere termoplastiche, sia delle maniglie individuali (cod. OAP160).

Dimensioni (L x W x H) cm	133.3x59.4x26.1(altezza minima)
Peso (Kg)	10
Materiale principale	Kevlar, Acetale, ABS



C-QUAL SETUP-SHEET

Per facilitare e velocizzare la fase di setup della paziente, la Civco Medical Solutions, fornisce un Setup Sheet precompilato sul quale spuntare e indicare in maniera molto semplice e veloce tutte le indicizzazioni scelte per la specifica paziente al fine di eliminare il più possibile errori di trascrizione/lettura:

3

10

CIVCO Set-up Sheet

C-Qual™
Breastboard

Monarch™
Overhead Arm Positioner

C-Qual™ Breastboard with Monarch™ Overhead Arm Positioner

Patient:


Date:

Notes:

Head Support Used

1 Index Lok-Bar™ to table (ex: H1, F2)


2 Set Tilting Board Elevation Angle (5° - 25°)



3 Position Bottom Stop (B0-B10)




4 Set Monarch™ Overhead Arm Positioner (P0-P77)



5 Position Hand Grip (G1-G12)

Hand Placement Top Side

6 Laser Alignment Location



7 Thermoplastics Used

Head-Only Yes No

Breast Yes No

Global Sales Office
Orange City, Iowa, USA
800.842.8688 | +1 712.787.8688

info@civco.com
www.civco.com

© 2017 CIVCO. CIVCO is a registered trademark of CIVCO Medical Solutions, LLC. CIVCO and MONARCH are trademarks of CIVCO. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. ALL RIGHTS RESERVED BY CIVCO. CIVCO, 2017. 0001

CIVCO
Radiotherapy

3

11

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO / UTILIZZO, PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI

Trattasi di dispositivo pluriuso. Lo stesso può e deve essere necessariamente utilizzato più volte per lo stesso paziente, dal setup iniziale fino all'ultima seduta di trattamento, allo scopo di garantire la massima riproducibilità di posizionamento del paziente durante il ciclo di terapia previsto ma può essere riutilizzato per altri pazienti.

Il personale clinico utente ha l'obbligo e la responsabilità di prendere tutte le necessarie misure preventive allo scopo di evitare qualunque tipo d'infezione, sia durante l'utilizzo del poggiatesta, sia durante l'intervallo temporale che intercorre tra un'applicazione e quella successiva, scegliendo quindi in modo opportuno i modi ed i luoghi di stoccaggio temporaneo.

Prima di ogni utilizzo è consigliata la pulizia e disinfezione del poggiatesta tramite l'impiego di soluzioni disinfettanti. Non vengono raccomandate soluzioni disinfettanti specifiche.

MANUTENZIONE

Non sono necessarie misure di manutenzione.

EVENTUALE TOSSICITÀ DICHIARATA

Nessuna.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Al termine della vita del prodotto, i componenti devono essere smaltiti in conformità con le regolamentazioni vigenti in termini di controllo dei rifiuti. I diversi materiali devono essere separati e riciclati in modo appropriato. Non contiene materiali pericolosi.



3

12

4. MT401 C-Qual™ BreastBoard con Sistema Monarch

CND V0804

RDM D.M. di classe I di produzione estera; non necessita di registrazione al repertorio

Modello: MT401

Ditta Produttrice: CIVCO Medical Solutions Inc., USA

CIVCO
Radiotherapy

Responsabile dell'immissione in commercio: TEMA Sinergie S.p.A.



Piano inclinato in fibra di carbonio e Kevlar top di gamma per il trattamento della mammella, disegnato per essere efficace nell'immobilizzazione, rigido e confortevole per le pazienti ed al contempo pratico, maneggevole e veloce nel setup per gli operatori.

Principali caratteristiche:

- Questo piano inclinato prevede che la zona di trattamento sia a **bassissima attenuazione in quanto traforata (0.8% di attenuazione per fasci di fotoni 6MV passanti attraverso l'area traforata)**.
- Il supporto per braccia e polsi, denominato **Monarch™**, ha un'impugnatura a forma di lettera "M" di nuova concezione che permette la naturale flessione dei polsi del paziente fornendo al contempo molteplici opzioni di posizionamento: essa può scorrere in 12 prestabilite posizioni indicizzate in direzione cranio-caudale così da potersi adeguare alle diverse necessità delle pazienti.




- Il nuovo profilo Monarch™ migliora inoltre la stabilità ed il comfort della paziente giacché supporta le braccia fin dalla regione ascellare evitando così che la paziente possa compiere rotazioni involontarie del busto durante il trattamento in quanto le braccia sono completamente appoggiate sul supporto e non sono in trazione.



- Monarch™ e quindi il poggiatesta, può scorrere lungo il piano inclinato in direzione cranio-caudale al fine di adattarsi a qualunque statura, adulta e pediatrica.

3


14

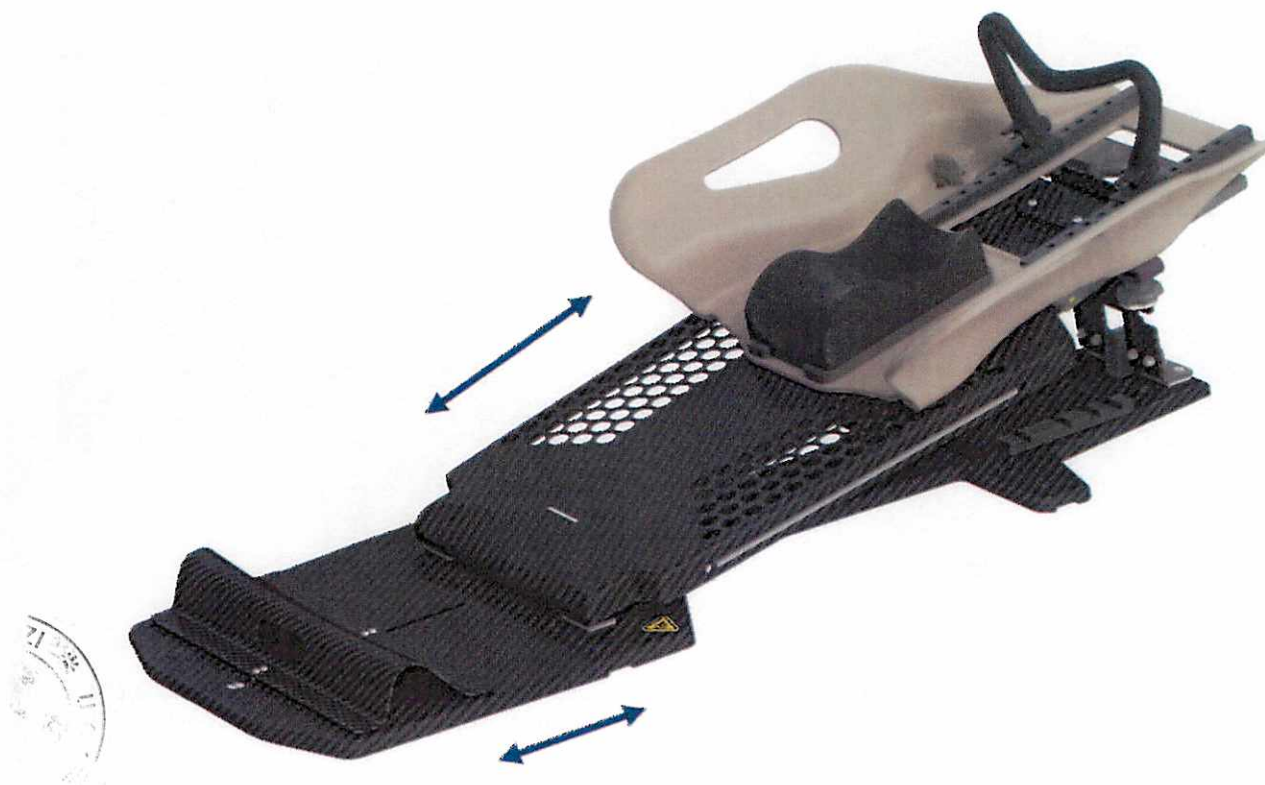


- Include un **poggiatesta in schiuma** modello Wide Headrest, **anatomico e universale** che abbraccia e sorregge il capo e il collo in maniera confortevole. Possono essere inseriti/utilizzati tutti i poggiatesta Civco, nel modello Posifix.
- Il bacino è supportato dal **Bottom Stop**, un dispositivo **ergonomico, antiscivolo e stabile** che blocca la paziente in posizione ed evita che possa scivolare in avanti. La **posizione del Bottom Stop** è facilmente regolabile in **11 posizioni** per meglio adattarsi alle diverse stature delle pazienti ed è indicizzato per essere riproducibile.



- L'inclinazione del piano è resa possibile grazie al sistema "Sure-Set" che garantisce un'**inclinazione riproducibile, indicizzata, sicura, robusta, accurata e precisa** da 5° a 25° con 9 diverse posizioni: 0°, 5°, 7.5°, 10°, 12.5°, 15°, 17.5°, 20°, 22.5°, 25°



- Il supporto Monarch™ può essere facilmente sfilato dal piano inclinato e utilizzato anche come dispositivo stand-alone per trattamenti a 0° di inclinazione, da ancorare direttamente al lettino di trattamento mediante barra di fissaggio.



Questo piano inclinato è indicizzabile a qualsiasi lettino di imaging/trattamento mediante barra di fissaggio.

È stato previsto di poter integrare al piano inclinato, sia un frame (cod. OAP120) per il fissaggio di maschere termoplastiche, sia delle maniglie individuali (cod. OAP160).

Dimensioni (L x W x H) cm	133.3x59.4x26.1(altezza minima)
Peso (Kg)	8.89
Materiale principale	Fibra di carbonio
Indicizzazione	Interamente indicizzato

C-QUAL SETUP-SHEET

Per facilitare e velocizzare la fase di setup della paziente, la Civco Medical Solutions, fornisce un Setup Sheet precompilato sul quale spuntare e indicare in maniera molto semplice e veloce tutte le indicizzazioni scelte per la specifica paziente al fine di eliminare il più possibile errori di trascrizione/lettura:

CIVCO Set-up Sheet



C-Qual™ Breastboard with Monarch™ Overhead Arm Positioner

Patient:


Date:

Notes:

Head Support Used

1 Index Lok-Bar™ to table (ex: H1, F2)


2 Set Tilting Board Elevation Angle (5° - 25°)



3 Position Bottom Stop (B0-B10)




4 Set Monarch™ Overhead Arm Positioner (F0-P77)



5 Position Hand Grip (G1-G12)

Hand Placement Top Side

6 Laser Alignment Location



7 Thermoplastics Used

Head-Only Yes No

Breast Yes No

Global Sales Office
Orange City, Iowa, USA
800.842.8688 | +1 712.737.8688

info@civco.com
www.civco.com

© 2017 CIVCO. CIVCO, C-Qual, Monarch, and Monarch™ are trademarks of CIVCO Medical Solutions. All other trademarks are the property of their respective owners. All products are used as described in the corresponding user manual. 210597A-13

CIVCO
Radiotherapy

3

17

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO / UTILIZZO, PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI

Trattasi di dispositivo pluriuso. Lo stesso può e deve essere necessariamente utilizzato più volte per lo stesso paziente, dal setup iniziale fino all'ultima seduta di trattamento, allo scopo di garantire la massima riproducibilità di posizionamento del paziente durante il ciclo di terapia previsto ma può essere riutilizzato per altri pazienti.

Il personale clinico utente ha l'obbligo e la responsabilità di prendere tutte le necessarie misure preventive allo scopo di evitare qualunque tipo d'infezione, sia durante l'utilizzo del poggiatesta, sia durante l'intervallo temporale che intercorre tra un'applicazione e quella successiva, scegliendo quindi in modo opportuno i modi ed i luoghi di stoccaggio temporaneo.

Prima di ogni utilizzo è consigliata la pulizia e disinfezione del poggiatesta tramite l'impiego di soluzioni disinfettanti. Non vengono raccomandate soluzioni disinfettanti specifiche.

MANUTENZIONE

Non sono necessarie misure di manutenzione.

EVENTUALE TOSSICITÀ DICHIARATA

Nessuna.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Al termine della vita del prodotto, i componenti devono essere smaltiti in conformità con le regolamentazioni vigenti in termini di controllo dei rifiuti. I diversi materiali devono essere separati e riciclati in modo appropriato. Non contiene materiali pericolosi.

Distinti saluti
Il Legale Rappresentante
Ing. Luciano Piancastelli
FIRMATO DIGITALMENTE

Spett.le
ASL 4 TERAMO
Circonv. Ragusa, 1
64100 TERAMO



Att.ne Acquisizione Beni e Servizi


Faenza, 5 marzo 2021

Vs. Rif.	TD MEPA 1620611	
Ns. Rif.:	OFFERTA N. 210597-T26-00	RA
OGGETTO:	Affidamento fornitura di sistemi di immobilizzazione – CIG Z7430D311F	

Il sottoscritto PIANCASTELLI LUCIANO nato a Castel Bolognese (RA) il 07.06.1942, residente in Castel Bolognese (RA) Via Biancanigo n. 264, C.F. PNC LCN 42H07 C065N in qualità di Legale Rappresentante (Presidente) della Società TEMA SINERGIE S.p.A. , Via Malpighi, 120 48018 Faenza (RA), P. IVA 00970310397, è lieto di offrire quanto segue:

Pos.	Mod.	Descrizione	Qtà	Prezzo Unit. €	Prezzo Tot. €
1.	OAP160	<p>CND: D.M. di classe I di produzione estera; non necessita di registrazione al repertorio</p> <p>Monarch™ Individual Hands Grip</p>  <p>Coppia di maniglie singole integrabili al sistema Monarch™ Overhead Arm Positioner, sia nella versione standalone OAP110 sia in combinazione ai piani inclinati MT400, MT401, per avere posizionamento asimmetrico degli arti superiori.</p> <p>Permettono di posizionare le braccia della paziente ad una diversa distanza in modo da avere posizionamento</p>	3	769,00	2.307,00

	<p>asimmetrico per supportare la paziente in limiti fisici o andare incontro ad una esigenza clinica di posizionamento con braccia svincolate (per esempio, trattamento sovraclaveare).</p> <p><i>Richiede codice OAP100 o OAP110 o MTM400 o MT401.</i></p>			
2.	<p>OAP120 CND: D.M. di classe I di produzione estera; non necessita di registrazione al repertorio</p> <p>Monarch™ Thermoplastic Frame</p>  <p>Frame per il fissaggio di maschere termoplastiche. Permette di fissare maschere MasterCast™ Pro e Posicast™ su sistema Monarch™</p>	3	652,00	1.956,00
3.	<p>MTM400 CND: D.M. di classe I di produzione estera; non necessita di registrazione al repertorio</p> <p>C-Qual M BreastBoard</p>  <p>Piano inclinato per il trattamento della mammella progettato per integrare le funzionalità del sistema Monarch Overhead Arm Positioner per il supporto degli arti superiori.</p> <p>L'impugnatura di nuova concezione permette la flessione naturale dei polsi del paziente; inoltre, il nuovo profilo di Monarch migliora il comfort del paziente perché permette di variare in direzione cranio-caudale la posizione del board al fine di adattarsi meglio alla statura del paziente.</p> <p>Principali caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il sistema è interamente composto da materiale non ferromagnetico (Kevlar, Black Acetal, Grey Kydex, Black ABS). • Dispositivo "Sure-Set" che garantisce l'inclinazione accurata e precisa da 5° a 25° con 9 step. • Sistema di indicizzazione per garantire setup efficiente ed accurato. • Include poggiatesta tipo <i>wide headrest</i>. 	1	13.988,00	13.988,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con sistemi di Monitoring Ottico (OSMS) • Facile maneggevolezza. 			
4.	<p>MT401 CND: D.M. di classe I di produzione estera; non necessita di registrazione al repertorio</p> <p>C-Qual™ BreastBoard con sistema Monarch</p>  <p>Piano inclinato Civco top di gamma in fibra di carbonio per il trattamento della mammella disegnato per essere confortevole, efficace ed efficiente nel setup delle pazienti. Estremamente ergonomico, leggero e con la zona di trattamento a bassissima attenuazione in quanto traforata. Questo piano inclinato è stato progettato per integrare le funzionalità del sistema Monarch Overhead Arm Positioner per il supporto degli arti superiori. Il supporto per le braccia è ampio e sorregge braccio e avambraccio, evitando rotazioni della paziente durante il trattamento. L'impugnatura di nuova concezione permette la flessione naturale dei polsi del paziente; inoltre, il nuovo profilo di Monarch migliora il comfort del paziente perché permette di variare in direzione cranio-caudale la posizione del board al fine di adattarsi alla statura del paziente.</p> <p>Principali caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclinazione "Sure-Set": riproducibile, indicizzata, sicura, robusta accurata e precisa in 9 diverse posizioni da 5° a 25° (0°, 5°, 7.5°, 10°, 12.5°, 15°, 17.5°, 20°, 22.5°, 25°). • Il bacino è supportato dal Bottom Stop, un dispositivo antiscivolo che blocca la paziente in posizione ed evita che possa scivolare in avanti. Regolabile in 11 posizioni per meglio adattarsi alle diverse stature delle pazienti ed indicizzato per essere riproducibile. • Doppia indicizzazione per garantire setup efficiente ed accurato: indicizzabile a qualsiasi lettino di imaging/trattamento mediante barre di fissaggio in due punti. • Include poggiatesta tipo <i>wide headrest</i>. • Compatibile con tutti i poggiatesta Civco nel modello Posifix • Facile maneggevolezza. 	2	10.362,00	20.724,00
	PREZZO TOTALE A VOI RISERVATO POS. 1 ÷ 4			38.975,00

Caratteristiche come da allegata Relazione Tecnica 210597A-T26-00.

TERMINI DI FORNITURA	
CONSEGNA	60 gg. dal ricevimento Vs. gradito ordine
IMBALLO	compreso nei prezzi
MERCE RESA	franco Vs. sede
PAGAMENTO	Bonifico Bancario a 30 gg. data fattura
IVA	a Vostro carico a norma di Legge
VALIDITA' OFFERTA	180 gg. dal 09.03.2021
GARANZIA	<p>12 mesi</p> <p>Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fabbricazione o a sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambio né per le spese di trasporto. Sono esclusi dalla garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura - i danni dovuti a negligenza del Cliente. <p>La garanzia decade in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema Sinergie - sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie.
INSTALLAZIONE	Compresa nei prezzi
FORMAZIONE PERSONALE UTENTE	Compresa nei prezzi
ASSISTENZA POST VENDITA	Compresa nei prezzi durante tutto il periodo di garanzia

Distinti saluti
Il Legale Rappresentante
Ing. Luciano Piancastelli
FIRMATO DIGITALMENTE



22

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

U.O.C. Programmazione e Gestione
Attività Economiche e Finanziarie

CIG. Z7430D311F

Tema Sinergie (P. Iva 00970310397)

Spesa anno 2021 € 47.549,50 Sottoconto 01.01.02.05.0100
Attrezzature sanitarie e scientifiche

Fonte di Finanziamento : FSN


Referente U.O.C. proponente: Dott. Emiliano Capasso

Data: 26.3.21

Utilizzo prenotazione: O S

Il Dirigente

(Dott. Vittorio D'Ambrosio)

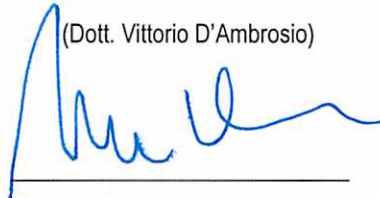

Prenotazione:

481/2021

Prenotazione:

Settore:

Data:

20.3.21

Il Contabile

Il Dirigente

(_____)

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
ASL n. 1 TERAMO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Annabella Di Silvestre



Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 12 APR. 2021 con prot. n. 1259/21 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suesesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suesesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C