

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO


Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano


Deliberazione n° **1433** del **- 5 AGO. 2019**

U.O.C.: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale conclusione Accordo Quadro tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di elevatori di infusione per le esigenze della Asl di Teramo. 1° contratto Attuativo;
CIG: ZE828B5347. R.D.O. nr. 2320468/2019.

Data 29/07/2019 Firma 

Il Responsabile dell'Istruttoria
 (Dott. Dante Castagnoli)

Data 28.7.2019 Firma 

Il Responsabile del Procedimento
 (Rag. Romano Pellone)

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 28.7.2019

Firma 

Il Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
 (Dott. Vittorio D'Ambrosio)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole

Data 2/8/2019

Firma 

Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole

Data 5/8/2019

Firma 

Il Direttore Sanitario: Dott. ssa Maria Mattucci



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C.: Dott. Vittorio D'Ambrosio

VISTA la richiesta di acquisto di beni strumentali acquisita al protocollo aziendale n.57024/19 del 04/06/2019, con la quale il Direttore dell'U.O. di Urologia del P.O. di Atri, chiede la fornitura di n.5 elevatori di soluzione infusione, aventi le caratteristiche riportate nella documentazione (all.1);

DATO ATTO CHE:

- la richiesta è stata autorizzata dal Direttore F.F. del Dipartimento Discipline Chirurgiche, Dott. Pietro Romualdi;
- il bene richiesto è inserito nel piano investimenti approvato dalla Direzione Generale per il periodo 2017/2019;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare una specifica procedura di affidamento, al fine di far fronte, non soltanto alle attuali esigenze, ma, in un'ottica di programmazione, anche a quelle che, presumibilmente, verranno a determinarsi nel corso dei prossimi 48 mesi per un valore complessivo presunto di € 30.000,00;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra e proprio in considerazione della variabilità del volume di prestazioni a richiedere agli operatori economici, nell'ambito del periodo temporale di vigenza del contratto, è possibile ricorrere alla formula dell'accordo quadro con un unico operatore economico di cui all'art.54 comma 1, 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, nell'ambito del quale saranno poi affidati i singoli contratti di fornitura a fronte delle effettive necessità che dovessero manifestarsi nel periodo di validità dell'accordo quadro stesso;

PRECISATO che l'affidamento e la conseguente stipula dell'accordo quadro non vincola in alcun modo l'Asl, costituendo, tale fattispecie contrattuale, unicamente il documento base per la regolamentazione di eventuali e successivi contratti specifici stipulati sulla base di concreti bisogni;

VISTO il documento "Condizioni particolari di contratto", da cui risulta che il valore stimato della procedura in argomento, riferito alla durata quadriennale dell'accordo quadro, ammonta a presuntivi € 30.000,00 Iva esclusa;

VISTO:

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";



- l'art. 15 comma 13 lett d) del D. L n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: *"gli enti del servizio sanitario nazionale...(omissis) ..., utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;
- l'art. 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: *"...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA"*;
- l'art. 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto..."*;

ATTESO che

- ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.8.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che il materiale oggetto di acquisizione è comunque presente nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip;

RILEVATO che, in ragione del valore della procedura che risulta di importo inferiore a € 40.000,00 iva esclusa, è consentito l'affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) D.lgs 50/2016 e che, pertanto, la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del quadro normativo come sopra delineato e di quanto in particolare previsto nel richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che per la fornitura in argomento, è stata attivata in data 07/06/2019 la procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante R.D.O. nr. 2320468/2019, costituita da un unico lotto con la formula dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, all'uopo interpellando tutti gli operatori economici abilitati al bando di competenza, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo (all.2);

CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza fissato per il giorno 21.06.2019 sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte (all.3):

- COREMEC S.r.l. (P.I. 04327730018)
- MIAMED S.r.l. (P.I. 02111490682)

CONSIDERATO che, a seguito della verifica, sul portale M.E.P.A., della regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa trasmessa (agli atti), si è proceduto all'apertura della busta tecnica;

ACCERTATO, dall'esame della documentazione tecnica presentata dalle suindicate ditte, che le offerte delle ditte "COREMEC S.r.l." e "MIAMED S.r.l." sono conformi a quanto riportato negli atti di gara, giusta dichiarazione in tal senso resa, in calce all'offerta tecnica, dal Dott. Federico Narcisi nella sua qualità di Dirigente Medico dell'U.O. di Urologia del P.O. di Atri (all.4);



ESAMINATE, quindi, le offerte economiche delle citate ditte ritenute conformi, attivando la seduta pubblica sul MEPA, come di seguito riportato:

Offerente	Descrizione	Qt.	Prezzo Unitario Iva esclusa	Prezzo complessivo Iva inclusa
COREMEC S.r.l.	Elevatore di soluzione infusioneale	20	€ 1.089,00	€ 21.780,00
MIAMED S.r.l.	Elevatore di soluzione infusioneale	20	€ 1.591,80	€ 31.836,00

PRESO ATTO che la migliore offerta pervenuta, risulta proposta dalla Ditta Coremec S.r.l. (P.I. 04327730018), con sede in Corso Vittime del Lavoro, 9 Nichelino (MI) (Tel.:011/3589481- Fax:011/3589483) (All.5):

VISTA l'apposita dichiarazione, agli atti, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che, stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, è in corso la verifica, in capo alla Ditta Coromec S.r.l., affidataria della fornitura in oggetto, il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;

ACCERTATA, altresì la regolarità della documentazione prodotta che è stata sottoscritta tramite apposizione di firma digitale;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: ZE828B5347;

RITENUTO, per quanto sopra espresso:

- di aggiudicare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) e dell'art.54 comma 1,2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico Coremec S.r.l. (P.I. 04327730018), con sede in Corso Vittime del Lavoro, 9 Nichelino (MI) (Tel.:011/3589481- Fax:011/3589483), – email : coremec@coremec.it, la fornitura quadriennale di elevatori di soluzione infusioneale, mediante la formula dell'accordo quadro, da destinare a varie UU.OO. della A.s.l. di Teramo alle condizioni di cui all'offerta tecnica/economica del 13/06/2019 come da R.D.O. n.2320468/2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 21.780,00 oltre I.V.A.;
- di affidare quale 1° contratto attuativo dell'A.Q. la fornitura di n.5 elevatori di soluzione infusioneale da destinarsi all'U.O. di Urologia del P.O. di Atri come da richiesta prot.n. 57024/19 del 04/06/2019 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 5.445,00 oltre I.V.A.;
- di approvare il seguente quadro economico determinato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016:



QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo del bene soggetto a ribasso		30.000,00 €
A2	Importo di aggiudicazione		21.780,00 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA GARA A2		30.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Fondo ex art. 113, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	2% di A1	600,00 €
B1.1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016	80% di B1	480,00 €
B1.2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016	20% di B1	120,00 €
B2	I.V.A. su importo di aggiudicazione	22% di A	4.791,60 €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2		5.391,60 €
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		35.391,60 €

[Handwritten signature]

- doversi nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) di cui al presente provvedimento il Dott. Vincenzo Cipolletti, Responsabile dell'U.O. di Urologia del P.O. di Atri;
- dover rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire, con la massima tempestività, l'approvvigionamento di quanto in oggetto;

PROPONE

- 1) **AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) e dell'art.54 comma 1,2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico Coremec S.r.l. (P.I. 04327730018), con sede in Corso Vittime del Lavoro, 9 Nichelino (MI) (Tel.:011/3589481- Fax:011/3589483), – email : coremec@coremec.it, la fornitura quadriennale di elevatori di soluzione infusione, mediante la formula dell'accordo quadro, da destinare a varie UU.OO. della A.s.l. di Teramo alle condizioni di cui all'offerta tecnica/economica del 13/06/2019 come da R.D.O. n.2320468/2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 21.780,00 oltre I.V.A.;
- 2) **DI APPROVARE** il seguente quadro economico determinato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 :

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo del bene soggetto a ribasso		30.000,00 €
A2	Importo di aggiudicazione		21.780,00 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA GARA A2		30.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Fondo ex art. 113, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	2% di A1	600,00 €
B1.1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016	80% di B1	480,00 €
B1.2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016	20% di B1	120,00 €
B2	I.V.A. su importo di aggiudicazione	22% di A	4.791,60 €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2		5.391,60 €
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		35.391,60 €

- 3) **PRECISARE** che il presente atto costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;
- 4) **PRECISARE** che l'Accordo Quadro in oggetto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di caricamento a sistema del contratto di stipula firmato digitalmente dalla Stazione Appaltante, e comunque fino all'esaurimento dell'importo previsto in gara;
- 5) **AFFIDARE**, la fornitura quale 1° contratto attuativo dell'A.Q. di n.5 elevatori di soluzione infusione da destinarsi all'U.O. di Urologia del P.O. di Atri come da richiesta prot.n. 57024/19 del 04/06/2019 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 5.445,00 oltre I.V.A.;
- 6) **PRENOTARE** la spesa complessiva di € 6.642,90 (iva inclusa) al sottoconto 01.01.02.060100 del bilancio dell'Ente – esercizio 2019, come da prospetto finanziario in calce;



- 7) **PRENOTARE** la spesa complessiva di € 480,00 al sottoconto 07.08.02.010302 del bilancio dell'Ente – esercizio 2019, come da prospetto finanziario in calce;
- 8) **PRENOTARE** la spesa complessiva di € 120,00 al sottoconto 01.01.02.090401 del bilancio dell'Ente – esercizio 2019, come da prospetto finanziario in calce;
- 9) **NOMINARE**, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) di cui al presente provvedimento il Dott. Vincenzo Cipolletti, Responsabile dell'U.O. di Urologia del P.O. di Atri;
- 10) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.



IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Roberto Fagnano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Fagnano".



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

ALLEGATI ALLA DELIBERA

1. Richiesta;
2. R.D.O. N.2320468/2019;
3. Ditte partecipanti;
4. Valutazione tecnica;
5. Offerta economica.

Allegati n. pag. 22





[Handwritten signature]

Al direttore U.O.C. Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
ASL di Teramo
Dottor Vittorio D'Ambrosio

OGGETTO. Adempimenti per la sicurezza ai sensi della Legge T.U. Sicurezza 81/08

Il sottoscritto dottor VINCENZO CIPOLLETTI Responsabile dell' UOSD di Urologia del P.O. di Atri (TE), ai sensi della sicurezza e la salute degli operatori che sono costretti a sforzi continui sia per sollevare le sacche di lavaggio vescicale (dal peso di kg 5 cadauno) con grosse problematiche nella sostituzione delle stesse, giacche le aste fisse sono predisposte con agganci ad altezza superiore ai 170 cm, potrebbero provocare incidenti sul lavoro di varia entità, inoltre alcuni operatori di statura bassa, devono usare delle pedane con scalini ai fini della loro sostituzione (*si ricorda che il datore di lavoro ha l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare la salute dei propri dipendenti ai sensi della Legge T.U. sicurezza 81/2008*) ed ai fini della prevenzione del rischio clinico per eventuali cadute delle sacche sui pazienti.

Pertanto da quanto esposto si richiede con procedura d'urgenza, l'acquisto di n° 5 (cinque) dispositivi idraulici per sollevare le sacche di irrigazione (cistoclisi) vescicale che si trovano in

commercio da destinare rispettivamente:

1 per la sala operatoria

1 per gli ambulatori di Urologia

3 per il reparto di degenza.

Si chiede inoltre l'annullamento della richiesta inviata con protocollo 0024493/19 del 06/03/2019.

Atri li 28/5/19

il Responsabile dell' UOSD di Urologia del P.O. di Atri (TE)

Dr. Vincenzo Cipolletti
Dirigente Reparto Urologia
A.S.L. Teramo

PRESIDIO OSPEDALIERO di TERAMO
U.O.C. Direzione Medica e
Gestione Complessiva del P.O.
Direttore Medico Affidatario: Dr. Pietro Romuzzi

INSEDIARE
PIANO INVESTIMENTI
P.O. ATRI

SCHEDA PER RICHIESTA ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI

ALLEGATO n. 4 alla Procedura per la gestione degli acquisti dei beni mobili durevoli e di beni immobili, per la gestione degli inventari, per la gestione dei fuori uso.

U.O. richiedente **UROLOGIA** Centro di Costo **5130** Direttore **Dottor Vincenzo Cipolletti**

PRESENZA DELL'ACQUISTO NEL PIANO DEI FABBISOGNI SI NO

Data richiesta:

N.B. : RICHIESTE DI ACQUISTO NON PRESENTI NEL PIANO DEI FABBISOGNI O CON PRIORITÀ SUPERIORE A 20 SONO IMPROCEDIBILI

Quantità	Descrizione del bene richiesto	da destinare a: (Utente, Ubicazione e rif. telefonico)	Num. Inventario vecchie apparecchiature (solo se sostituzione)	costo presunto (EURO)	Classe di priorità assegnata nel piano dei fabbisogni	eventuali annotazioni
5	Elevatori di soluzione infusione ed irrigazione ad servoassistita idraulicamente in conformità al T.U. D.Igvo	Sala Operatoria urologica ambulatori di Urologia unita di degenza			con urgenza ai sensi del T.U. 81/2008	annullo precedente richiesta con protocollo 0024493/19 del 06/03/2019.

Breve descrizione del motivo dell'acquisto, delle attività da automatizzare e dell'eventuale software che si intende utilizzare:

Riferimento fonte di finanziamento (FSN, fondi finalizzati, entrate proprie, ecc.)

Nome e Firma del Richiedente

Firma del Dirigente Responsabile dell'U.O.

Visto per approvazione e controllo dei dati riportati
Direttore Responsabile della struttura (Presidio / Distretto / Dipartimento)

A.S.L. A - TERAMO
Dipartimento Discipline Chirurgiche
DIRETTORE F.F.
Dr. Pietro ROMUALDI

(Firma)
Dr. Vincenzo Cipolletti
Dirigente Responsabile
A.S.L. Teramo

Annotazioni dell'Alta Direzione o firma per approvazione/parere tecnico


ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta Interna



Prot. nr. 0057024/19 del 04/06/2019




(Firma)



IQF
91

IQI
54

Elevatore di soluzione infusionale per terapia infusionale e irrigazione sito chirurgico, ad elevazione servoassistita idraulicamente.



Conformità
D.Lgs 81/08
Metodo NIOSH

- Indicato per Reparto Operatorio, Reparto Ortopediaco e Urologia
- Altezza massima del supporto infusione: 2830 mm
- Portata massima del dispositivo: 24 Kg
- Altezza carico di soluzione: 1550 mm (D.Lgs 81/08 Metodo NIOSH)
- Rapporto N° pedalate e Forza resistente ottimizzato
- Supporto infusione rotante a 4 gradi di sicurezza in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)
- Struttura verticale telescopica in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)
- Basamento 5 razze in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)

SAFE Tech

Efficacia
IQF 100

Sanificabilità
IQF 85,3

Usabilità
IQF 90,2

Versatilità
IQF 83,3

Compatibilità Sistemica
IQF 79,3

Compatibilità Ambientale
IQF 100


3

Proprietà del Dispositivo	Rif. Caratteristica Tecnico-Funzionale	Caratteristiche del Dispositivo							
Versatilità	6.2.1	Ambiente di destinazione	Domicilio	Ambulatorio Medico	Degenza	R.M.N.	Terapia Intensiva	Reparto Operatorio	
			OK	OK	OK		OK	OK	
Efficacia	6.1.2	Altezza massima del Supporto Soluzione Infusionale (Hsi Max) (+50 / -0)	2830		mm				
Efficacia	6.1.1	Portata Massima (Soluzione Infusionale) (Kg)	Portata Max Dispositivo (M)	24	Portata singolo Gancio		6		
Compatibilità Sistemica	6.5.5	Pompe Infusionali (Peso ammissibile)	fino a 10 Kg (Asta Strutturale)		fino a 20 Kg (HID-ACS12)				
Usabilità / Sanificabilità	6.3.1 6.4.1	Regolazione Altezza del Supporto Soluzione Infusionale	Servoassistenza idraulica a pedale (N° pedalate - Forza resistente = Ottimizzata per operatore medio)						
Sanificabilità	6.3.1	Supporto Soluzione Infusionale	Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)						
Usabilità	6.4.2		N°4 Ganci anti caduta accidentale delle Soluzioni (O3)						
Usabilità	6.4.2		Resistenza meccanica singolo Gancio (Kg)					8	
Usabilità	6.4.2		Rotante						
Usabilità	6.4.5	Ergonomia-Aggancio Soluzioni infusionali (Metodo Niosh)	(Hsi Min) Altezza di carico Soluzione Infusionale = 1550 mm da terra						
Sanificabilità	6.3.2	Struttura verticale telescopica (Materiali / Tech. / Dimensioni)	Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) (Ø50 / Ø25) Morsetto S.A.F.E. Technology						
Sanificabilità	6.3.2	Ergonomia-Basamento (Inciampo)	Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Raccordi e Razze S.A.F.E. Technology						
Usabilità	6.4.5		N°5 razze						
Usabilità	6.4.4	Maneggevolezza del Dispositivo (al Max della Portata)	N°5 ruote gemellate Ø 75 mm		N°2 con freno				
Sanificabilità	6.3.3	Vincoli a Terra							
Sanificabilità	6.3.4	Procedura di sanificazione ammessa	Manuale/Vapore/Nebulizzazione/Termodisinfettore						
Compatibilità Sistemica	6.5.1	Dimensioni e geometrie [mm] Peso [Kg]	Ø 680 x 1550/2830H		21 Kg				
Usabilità	6.4.5	Indice di stabilità (Rst Max) <small>Nota da applicare alla base del dispositivo per determinare il ribaltamento</small>	15,85		Kg				
Usabilità	6.4.3	Dispositivo per discesa rallentata del Supporto Soluzione Infusionale	Si						
Compatibilità Sistemica	6.5.2	Dispositivi per: Conduttività cariche elettrostatiche a Terra	Applicati						
Compatibilità Sistemica	6.5.3	Insensibilità ai campi magnetici da RMN	NO						
Compatibilità Sistemica	6.5.4	Colorazioni Disponibili. Identificazione , Design	Opzione disponibile						
Compatibilità Ambientale	6.6	Resistenza al fuoco/ Latex free / Riciclabile	100%	100%	100%				
Compatibilità Sistemica	6.5.6	Accessori disponibili della serie HID-ACS.....	0-i-1-12-13-SQ						
Durata nel tempo	6.7	Opzione Garanzia (vedi conferma su offerta economica)	5		Anni				
		Dispositivo medico	Conformità 93/42 CEE / Classe I CE						
Indicatori di Qualità della Proprietà (IQP)									
	6.1		Efficacia						
	6.3		Sanificabilità						
	6.4		Usabilità						
	6.2		Versatilità						
	6.5		Compatibilità Sistemica						
	6.6		Compatibilità Ambientale						
	[5 x (Efficacia+Sanificabilità+Usabilità) + 1 x (Versatilità,+Comp. Sisti. +Comp. Ambientale) / 10		Indicatore di Qualità Intrinseca (IQI)						
	6.7		Indicatore di QUALITA' INTRINSECA TOTALE nel TEMPO (IQT)						

acquistinretepa.it

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2320468
Descrizione RDO:	Elevatori di soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016).	no
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 4 Teramo 00115590671 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO TE
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI
Soggetto stipulante	Nome: MARCO RODOMONTI Amministrazione: ASL 4 Teramo
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Non disponibile Dott. Dante Castagnoli
Inizio presentazione offerte:	07/06/2019 13:03
Termine ultimo presentazione offerte:	21/06/2019 18:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	17/06/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del	31/12/2019 12:30

5 

Fornitore)	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	31/12/2023 :
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Elevatori di soluzione infusioneale destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo
CIG	ZE828B5347
CUP	
Formola di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Piazza italia, 1 c.da villa mosca Teramo - 64100 (TE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	30000,00000000



Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Elevatori di soluzione infusioneale destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Fornitura oggetto prevalente della RdO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto • Noleggio
3	* Prezzo complessivo della fornitura	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
DUVRI	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si

7 

all'avvalimento					
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
MODALITA' DI CONSEGNA	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
PATTO DI INTEGRITA' AZIENDALE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALL'OFFERTA	Elevatori di soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
MODELLO OFFERTA TECNICA	Elevatori di soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA DA ALLEGARE ALL'OFFERTA	Elevatori di soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
MODELLO OFFERTA ECONOMICA	Elevatori di soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di	Elevatori di	Economica	Invio telematico	Obbligatorio	Si



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right corner of the page.

sistema)	soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo		con firma digitale		
TRACCIATO OFFERTA	Elevatori di soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Offerte per la gara Elevatori di soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo

Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	COREMEC S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/06/2019 12:29:49
2	MIAMED SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	20/06/2019 17:36:56



[Handwritten signature]

Art. 2692P3 ASTA PORTAFLEBO OLEODINAMICA PER POMPE INFUSIONE

Codice Articolo	2692P3
N°. Repertorio	1686892/R
Codice CND	V0899



U.O.S.D. ...
Dr. Fedegari ...
Carpi
o quanto
richiedi

Scheda Dimensionale	
Dimensione (L x P x H) Cm	147 / 247
Portata Kg	28
Peso netto Kg	20,5
Peso lordo Kg	22,0
Volume mc	0,06
Numero colli	2
Imballo (L x P x H) Cm (Base)	60 x 14 x 62
Imballo (L x P x H) Cm (Stelo)	10 x 10 x 150

Piantana per ipodermoclisi ad elevazione oleodinamica, porta sacche di fluido per irrigazioni operative e infusionali, pompa oleodinamica con pedale per la regolazione in altezza, gancio a 4 posti in tondo d'acciaio inox AISI 304 con dispositivo di sicurezza antigancio, base a cinque razze in lamiera di acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite, monta ruote piroettanti d. 75 mm di cui (2 antistatiche frenanti e 3 normali) e paracolpi in vipla grigia. Con maniglia di presa in tondo di acciaio inox per facilitarne la movimentazione, con la possibilità di variare la posizione della maniglia.

Struttura :

- Stelo : pompa oleodinamica con camicia in acciaio inox
- Base : lamiera di acciaio inox AISI 304 nichel cromo 18/10 - UNI X5 CrNi1810, spessore 5 mm.

Finitura :

- Stelo : inox lucidato.
- Base : inox satinato.

Altri componenti :

- quali viti, componenti ferramenta, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

Pulitura :

- Per la pulizia possono essere utilizzati normali detersivi, purché non contengano cloro e suoi composti. Al momento della pulizia è importante seguire il senso della satinatura dell'acciaio inossidabile, senza esercitare una pressione eccessiva.
- Nel caso di macchie persistenti provare con prodotti specifici per l'acciaio inox.

Attenzione:

1. Non usare per la pulizia pagliette in acciaio o altro che possa graffiare o smerigliare.
2. Evitare l'uso di acido muriatico o candeggina.
3. Non lasciare a lungo sul piano oggetti di ferro.

LATEX FREE

Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorare ai prodotti senza modificarne la sostanza.
 Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.
 Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
 C.so Vittime del lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
 Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483



COREMEC s.r.l.
 Export Department
 e-mail: export@coremec.it

www.coremec.it e-mail: coremec@coremec.it


Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti
 ST_2692_P3 Edizione _r04_2019

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.




P.to 1 Elevatore di soluzione infusione per terapia infusione e irrigazione sito chirurgico, ad elevazione servoassistita idraulicamente.



Conformità
D.Lgs 81/08
Metodo NIOSH

ING. MERINO - RO. ATRI
U.S. UROLOGIA ANDROLOGIA
Dr. Francesco Nazzari






CONFORME A
QUANTO
RICHIESTO

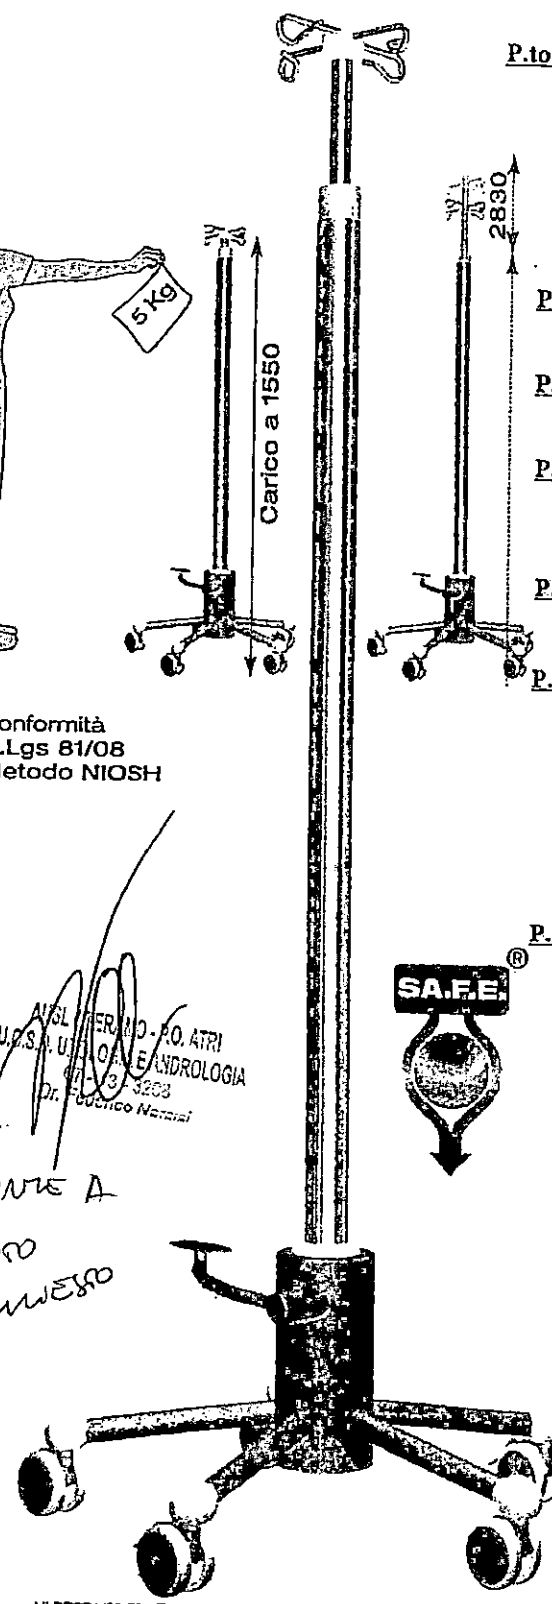

HI-DROP MGS-P03 Po400


- Indicato per Reparto Operatorio, Reparto Ortopedia ed Urologia.
- Altezza massima del supporto infusione: 2830 mm
- Portata massima del dispositivo: 24 Kg
- Altezza carico di soluzione: 1550 mm (D.Lgs 81/08- Metodo NIOSH)
- Rapporto N° pedalate e Forza resistente ottimizzato.
- Supporto Infusioni rotante a 4 ganci di sicurezza in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)
- Struttura verticale telescopica in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)
- Basamento 5 razze in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)

SAF.E. Tech.



U.P.S.D. *Dr. Ferraro*

CONFERMA A QUANTO NOME

Proprietà del Dispositivo	Rifer. Caratteristica Tecnica, Funzionale	Caratteristiche del Dispositivo						IQI	
Versatilità	6.2.1	Ambiente di destinazione	Domicilio	Ambulatorio Medico	Degenza	R.M.N.	Terapia Intensiva	Reparto Operatorio	83,33
			OK	OK	OK		OK	OK	
Efficacia	6.1.2	Altezza massima del Supporto Soluzione Infusionale (Hsi Max) (+50 / -0)	2830		mm			100,00	
Efficacia	6.1.1	Portata Massima (Soluzione Infusionale) (Kg)	Portata Max Dispositivo (M)	24	Portata singolo Gancio		6	100,00	
Compatibilità Sistemica	6.5.5	Pompe Infusionali (Peso ammissibile)	fino a 10 Kg (Asia Strutturale)		fino a 20 Kg (HID-ACS12)			100,00	
Usabilità / Sanificabilità	6.3.1 6.4.1	Regolazione Altezza del Supporto Soluzione Infusionale	Servoassistenza idraulica a pedale (N° pedalate - Forza resistente - Ottimizzata per operatore medio)						100,00
Sanificabilità	6.3.1	Supporto Soluzione Infusionale	Acciaio inossidabile Austenitico (AISI 304)						100,00
Usabilità	6.4.2		N°4 Ganci anti caduta accidentale delle Soluzioni (Ø8)						100,00
Usabilità	6.4.2		Resistenza meccanica singolo Gancio (Kg)				8		100,00
Usabilità	6.4.2		Rotante						90,00
Usabilità	6.4.5		Ergonomia-Aggancio Soluzioni Infusionali (Metodo Niosh)	(Hsi Min) Altezza di carico Soluzione Infusionale = 1550 mm da terra					
Sanificabilità	6.3.2	Struttura verticale telescopica (Materiali / Tech. / Dimensioni)	Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) (Ø50 / Ø25) Morsetto S.A.F.E. Technology						100,00
Sanificabilità	6.3.2	Ergonomia-Basamento (inciampo)	Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) Raccordi e Razze S.A.F.E. Technology						100,00
Usabilità	6.4.5		N°5 razze						70,00
Usabilità	6.4.4	Maneggevolezza del Dispositivo (al Max della Portata)	N°5 ruote gemellate Ø 75 mm		N°2 con freno			57,34	
Sanificabilità	6.3.3	Vincoli a Terra	Manuale/Vapore/Nebulizzazione/Termodesinfettore						100,00
Sanificabilità	6.3.4	Procedura di sanificazione ammessa	Manuale/Vapore/Nebulizzazione/Termodesinfettore						100,00
Compatibilità Sistemica	6.5.1	Dimensioni e geometrie (mm) Peso (Kg)	Ø 680 x 1550/2830H		21 Kg			55,88	
Usabilità	6.4.5	Indice di stabilità (Rst' Max)	15,85		Kg			100,00	
Usabilità	6.4.3	Dispositivo per discesa rallentata del Supporto Soluzione Infusionale	Si						100,00
Compatibilità Sistemica	6.5.2	Dispositivi per: Conducibilità cariche elettrostatiche a Terra	Applicati						100,00
Compatibilità Sistemica	6.5.3	Insensibilità ai campi magnetici da RMN	NO						40,00
Compatibilità Sistemica	6.5.4	Colorazioni Disponibili, Identificazione, Design	Opzione disponibile						80,00
Compatibilità Ambientale	6.6	Resistenza al fuoco/ Latex free / Riciclabile	100%	100%	100%			100,00	
Compatibilità Sistemica	6.5.6	Accessori disponibili della serie HID-ACS.....	0-1-12-13-SQ						100,00
Durata nel tempo	6.7	Opzione Garanzia: (vedi conferma su offerta economica)	5		Anni				
		Dispositivo medico	Conformità 93/42 CEE / Classe 1 CE						
Indicatori di Qualità della Proprietà (IQP)									
	6.1		Efficacia						100,00
	6.3		Sanificabilità						83,33
	6.4		Usabilità						90,9
	6.2		Versatilità						83,33
	6.5		Compatibilità Sistemica						79,3
	6.6		Compatibilità Ambientale						100,00
	$(5 \times \text{Efficacia} + \text{Sanificabilità} + \text{Usabilità}) \div 3 \times (\text{Versatilità} + \text{Comp. Sist.} + \text{Comp. Ambientale}) \div 3$		Indicatore di Qualità Intrinseca (IQI)						
	6.7	Indicatore di QUALITA' INTRINSECA TOTALE nel TEMPO (IQT)							


Il produttore si riserva la facoltà di appettare modifiche al prodotto qui descritto, pertanto i dati e le immagini contenute in questo documento non devono essere considerate vincolanti.



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2320468
Descrizione RDO	Elevatori di soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Elevatori di soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo)
CIG	ZE828B5347
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	ASL 4 Teramo
Codice Fiscale Ente	00115590671
Nome ufficio	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	Circonv. Ragusa, 1 - TERAMO (TE)
Telefono / FAX ufficio	0861420297 / 0861420292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	RODOMONTI MARCO / CF:RDMMRC59R14L103F
Firmatari del contratto	ORIANA PONZUOLI / CF:PNZRNO56A47G547P

FORNITORE	
Ragione Sociale	COREMEC S.R.L.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	04327730018
Codice Fiscale Impresa	04327730018
Indirizzo Sede Legale	C.SO VITTIME DEL LAVORO 9 - NICHELINO (TO)
Telefono / Fax	0113589481 / 0113589483
PEC Registro Imprese	INFO@COREMEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro	626350

74 

Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	03/03/1983
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	5117034
INPS: Matricola aziendale	8136970105
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	8096666/17 – 8096667/62 – 8096668/18
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT40R0200801013000001034970
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ORIANA PONZUOLI RENATA SUPERTI

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5575731
Offerta sottoscritta da	PONZUOLI ORIANA
Email di contatto	INFO@COREMEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2019 12:30
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Elevatori di soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo
Categoria	Forniture specifiche per la sanità
Descrizione Oggetto di Fornitura	Elevatori di soluzione infusione destinati alle varie UU.OO. P.O. Teramo
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Fornitura oggetto prevalente della RdO	Art. 2692P3 ASTA PORTAFLEBO OLEODINAMICA PER POMPE INFUSIONE

ACQUISIZIONE


Tipo contratto	Acquisto
Prezzo complessivo della fornitura*	21780
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	21780,00000000 Euro (ventunomilasettecentottanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 150,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	31/12/2023 :
Dati di Consegna	Piazza italia, 1 c.da villa mosca Teramo - 64100 (TE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

16 



Handwritten signature or initials.

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.


ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Lotto	Cig	Tipo dispositivo 1= Dm di classe - 2=assemblato	Numero RDM (Repertorio)	Codice Farmadati	Pezzi per confezione minima di vendita	Denominazione del fornitore se diverso da fabbricante	Partita iva del fornitore se diverso da fabbricante	Quantità aggiudicata	Quantità contrattualizzata	Prezzo unitario aggiudicato	Aliquota Iva	Tipo aliquota Iva S(aliquota standard) - A(aliquota agevolata) - M(aliquota mista)	Servizi accessori che Influiscono sul Prezzo (SI/NO)	Conto deposito (SI/NO)
UNICO	ZE828B5347	1	1686892/R	NON APPLICABILE	1			20		1.089,00 €	22%	S	NO	NO

Nichelino (to), 13 giugno 2019

Coremec S.r.l. _____
 Oriana Ponzuoli - Amministratore Unico
documento firmato digitalmente



Handwritten signature or mark.

87

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE						Area compilata dal FORNITORE COREMEC S.r.l.				
metaprodotto o Mepa	Descrizione/specifiche del prodotto	Codice	Unità Operativa	Q.tà presunta 4 anni	Codice Equivalente	Descrizione prodotto offerto	Marca	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo (IVA esclusa) totale per articolo	
FORNITURA A CORPO SANITA'	Elevatore di soluzione infusione per terapia infusione ed irrigazione sito chirurgico, ad elevazione servoassistita idraulicamente. - Altezza massima del supporto infusione:2830mm. - Portata massima del dispositivo:24Kg - Altezza di carico soluzione 1550 mm (D.Lgs 81/08 - NIOSH) - Rapporto N° pedalate e Forza resistenze ottimizzato Supporto infusione rotante a 4 ganci di sicurezza in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) - Basamento 5 razze in Acciaio Inossidabile Austenitico(AISI 304).	LUCINI HI DROP	UU.OO. Varie A.S.L.Teramo	20	2692.P3	Art. 2692P3 Piantana per ipodermoclisi ad elevazione oleodinamica, porta sacche di fluido per irrigazioni operative e infusionali	GALENO	€ 1.089,00	€ 21.780,00	
Importo Totale della fornitura									€ 21.780,00	

Coremec Srl
 Oriana Ponzuoli - Amministratore Unico
 documento firmato digitalmente

19


Spettabile
REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Circonvallazione Ragusa 1
64100 TERAMO (TE)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER
LA FORNITURA DI ELEVATORI SOLUZIONE
INFUSIONALE DESTINATI ALLE VARIE UU.OO.
DELL'ASL DI TERAMO. - R.D.O. n.2320468/2019

Dichiarazione di congruità del prezzo con indicazione delle strutture dove esso è stato applicato e a quali prezzi

Con riferimento alla congruità del prezzo offerto e all'indicazione delle strutture dove esso è stato applicato e a quali prezzi, che solo a far data dal presente anno ci siamo attivati per la vendita diretta dell'articolo offerto e che in precedenza ci siamo avvalsi della collaborazione di distributori locali.

Nichelino, 13 Giugno 2019

COREMEC s.r.l. _____

Oriana Ponzuoli * Amministratore Unico
Documento firmato digitalmente



Spettabile
REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Circonvallazione Ragusa 1
64100 TERAMO (TE)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER
LA FORNITURA DI ELEVATORI SOLUZIONE
INFUSIONALE DESTINATI ALLE VARIE UU.OO.
DELL'ASL DI TERAMO. - R.D.O. n.2320468/2019

Dichiarazione percentuale di Sconto su Listino

In allegato si unisce Listino Prezzi Coremec Linea Galeno 2019 rev.0 sulle cui quotazioni lo sconto a Voi riservato è il seguente:

48% (QUARANTOTTO PERCENTO)

Nichelino, 13 Giugno 2019

COREMEC s.r.l. _____

Oriana Ponzuoli * Amministratore Unico
Documento firmato digitalmente



Galeno



Listino prezzi anno 2019 rev.0
valido dal 01.04.2019

www.galeno.co

www.coremec.i

Codice	Descrizione prodotto	Conf.	Prezzo IVA esclusa	IVA%
B	Aste per ipodermo e fleboclisi			
B.2686/ICR	piantana a 2/4 ganci base in plastica con ruote	1	48,00	22
B.2688/P	piantana a 4 ganci base in plastica	1	77,00	22
B.2686/TX	piantana con 2 ganci e asta in acciaio inox, base alluminio	1	136,00	22
B.2688/TX	piantana con 4 ganci e asta in acciaio inox, base alluminio	1	158,00	22
B.2686/TXQ	piantana con 2 ganci asta e base in acciaio inox	1	177,00	22
B.2688/TXQ	piantana con 4 ganci asta e base in acciaio inox	1	199,00	22
B.2686/TXF	piantana con 2 ganci asta e base in acciaio inox h 100 cm	1	86,00	22
B.2688/TXF	piantana con 4 ganci asta e base in acciaio inox h 100 cm	1	92,00	22
B.2692	piantana a 4 ganci per pompa infusione con ruote	1	199,00	22
B.2692/P3	piantana a 4 ganci per pompa infusione con ruote oleodinamica	1	2.095,00	22



<p style="text-align: center;">U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi</p>	<p style="text-align: center;">U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie</p>
<p>Spesa 2019 € 480,00 Sottoconto 07 08 02 010302</p> <p>Incentivo art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016</p> <p>Spesa 2019 € 120,00 Sottoconto 01 01 02 090401</p> <p>Innovazione tecnologica art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016</p>	<p>Prenotazione n. <u>2028</u> /2019</p> <p>Prenotazione n. <u>2036</u> /2019</p>
<p>CIG: ZE828B5347.</p> <p>Spesa anno 2019 € 6.642,90 (iva inclusa) Sottoconto 01.01.02.05200</p> <p>Fonte di finanziamento: FSN</p> <p>Referente U.O.C. proponente: Sig. Romano Pellone</p> <p style="text-align: right;">Utilizzo prenotazione: 0</p> <p>Data: 29/07/2019</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente Responsabile UOC Acquisizione Beni e Servizi (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p>	<p>Prenotazione n. <u>2040</u> /2019</p> <p>Settore E 44</p> <p>Data: <u>01/08/2019</u></p> <p>Il Contabile Il Dirigente</p> <p style="text-align: center;">   </p>

ASL 4 TERAMO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre



Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

6 AGO. 2019 con prot. n. **3025/19**

all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"



Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		