

Originale1300

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO
Dipartimento Amministrativo
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

06 OTT. 2020

Il giorno _____, nella sede della ASL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 28 del 9.01.2019, e nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011 così come successivamente modificata dalla Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. 1635

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di una stampante medica per apparecchiatura radiologica GE in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Teramo. CIG Z152E49228.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con apposita richiesta di acquisto beni strumentali, acquisita agli atti della proponente UOC, protocollo aziendale n.64766/2020, il Dott. Stefano Minora, Direttore dell'UOC di Anestesia e Rianimazione, Gruppo Operatorio e Terapia del Dolore del P.O. di Teramo, nonché Direttore del Dipartimento Emergenza e Urgenza dell'ASL di Teramo, ha chiesto l'acquisizione urgente di una stampante Sony UP per apparecchio radiologico GE in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Teramo, in quanto quella in dotazione non è più riparabile per irreperibilità dei pezzi di ricambio e pertanto ne è stato dichiarato il fuori uso, come da documentazione in atti;

DATO ATTO che il valore complessivo stimato per la fornitura in oggetto, è inferiore € 5.000,00 IVA esclusa;

VISTI gli artt.:

- 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

- 1 comma 450 della legge n. 296 del 2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145 ai sensi del quale: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: "Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...";
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA";

ATTESO che ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.08.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO, in ragione del valore stimato della fornitura, contenuto nel limite di € 5.000,00, potersi prescindere dall'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip SpA ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa;

CONSIDERATO che il presente provvedimento vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, in ragione di quanto sopra, tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta sul Mercato Elettronico della P.A. n. 2642412/2020, sono state acquisite le offerte di seguito sinteticamente riportate:

#	Denominazione concorrente	Importo complessivo offerto (iva esclusa)
1	BIESSE MEDICA SRL	€ 2.383,00
2	CERACARTA	€ 2.690,00
3	TECNO SYSTEM SRL	€ 2.700,00
4	FRANGI	€ 2.798,00

PRESO ATTO che la migliore offerta è quella della ditta BIESSE MEDICA SRL (€ 2.383,00 iva esclusa) per aver praticato il prezzo più basso;

RITENUTO, quindi, di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta BIESSE MEDICA SRL con sede in Via Inzago 48 – 00100 Roma – P.I. 04409721000 – la fornitura di una "Stampante Sony UP-991AD" alle condizioni di cui all'offerta relativa alla R.d.O. n. 2642412/2020;

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente CIG: Z152E49228,

DBuy

DISPONE di

- 1) **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta BIESSE MEDICA SRL con sede in Via Inzago 48 – 00100 Roma – P.I. 04409721000 – la fornitura di una "Stampante Sony UP-991AD" per le esigenze del Blocco Operatorio del P.O. di Teramo alle condizioni di cui all'offerta relativa alla R.d.O. n. 2642412/2020, con precisazione che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 2) **DETERMINARE** la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi in € 2.383,00 (iva 22 % esclusa).
- 3) **PRENOTARE** la spesa complessiva di € 2.907,26 iva inclusa al Bilancio dell'Ente – esercizio 2020 – come da prospetto finanziario in calce.
- 4) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.

Letto, confermato, sottoscritto.



D. Lus

ALLEGATI ALL'ORDINANZA

- Offerta economica ditta BIESSE MEDICA

Allegati n. pag 10



Dony

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2642412
Descrizione RDO	Procedura negoziata urgente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento della fornitura di una STAMPANTE SONY UP-991AD per le esigenze del gruppo operatorio del P.O. di Teramo
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (STAMPANE SONY UP-991AD per apparecchio radiologico GE Vascular OEC-9800Plus)
CIG	Z152E49228
CUP	Non inserito



AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	ASL 4 Teramo
Codice Fiscale Ente	00115590671
Nome ufficio	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	Circonv. Ragusa, 1 - TERAMO (TE)
Telefono / FAX ufficio	0861420297 / 0861420292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFPL0H
Punto ordinante	RODOMONTI MARCO / CF:RDMMRC59R14L103F
Firmatari del contratto	ALBERTO BRUGNONI / CF:BRGLRT55P26E256H

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	BIESSE MEDICA S.R.L.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	04409721000
Codice Fiscale	04409721000

Deby

2

Operatore Economico	
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA INZAGO 48 - ROMA (RM)
Telefono	063090901
Posta Elettronica Certificata	INFO@BIESSEMEDICA.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04409721000
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	RM
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IROMA.UTROMA2@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT78P0200805037000500023557
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ALBERTO BRUGNONI - C.F. BRGLRT55P26E256H



DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6574591
Offerta sottoscritta da	BRUGNONI ALBERTO
Email di contatto	INFO@BIESSEMEDICA.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2020 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Procedura negoziata urgente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)

DBuy

	del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento della fornitura di una STAMPANTE SONY UP-991AD per le esigenze del gruppo operatorio del P.O. di Teramo
Categoria	Stampanti termiche
Descrizione Oggetto di Fornitura	STAMPANE SONY UP-991AD per apparecchio radiologico GE Vascular OEC-9800Plus
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	SONY
Codice articolo produttore	UP-991AD
Nome commerciale della stampante termica*	UP-991AD
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica	ORIGINALE SONY Stampante analogica e digitale monocromatica in formato A4 per carta termica e lastra blu
Tipo contratto*	Acquisto
Prezzo*	2383
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	2383,0000000 Euro (duemilatrecentoottantatre Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 5,00000000 (Euro)	



INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	PRESIDIO OSPEDALIERO TERAMO - P.ZZA ITALIA 1 C.DA VILLA MOSCA - 64100 TERAMO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente

D. D. D.

3

Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
----------------------	---

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto



D. De Rosa


Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili all/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta esclude l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Dey


5

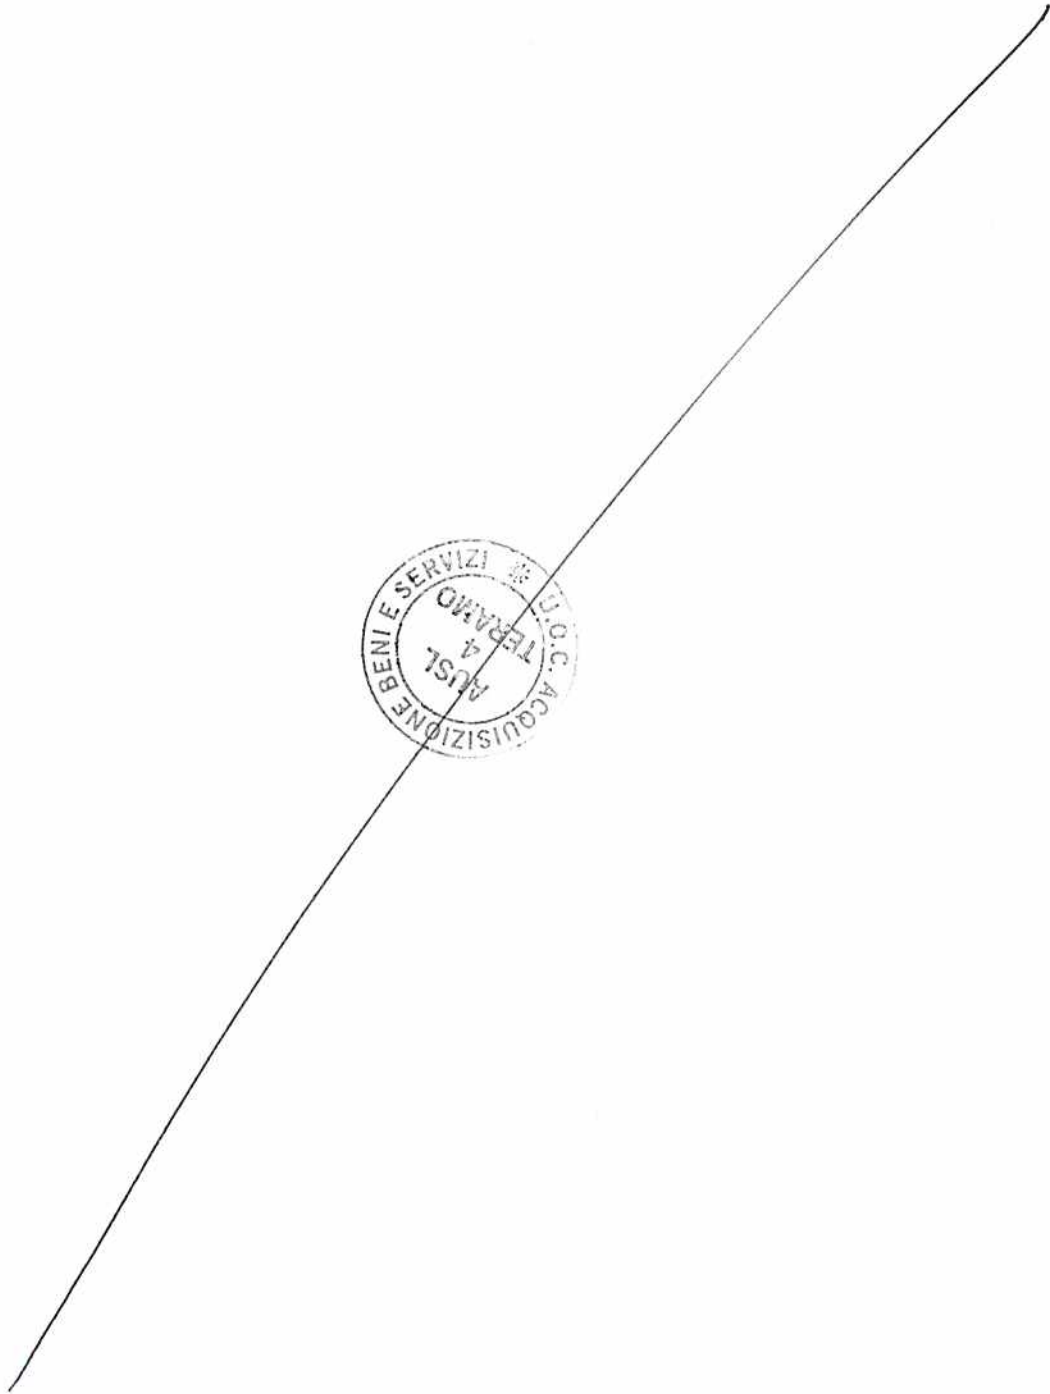


Deby

SONY

ACQUISITION

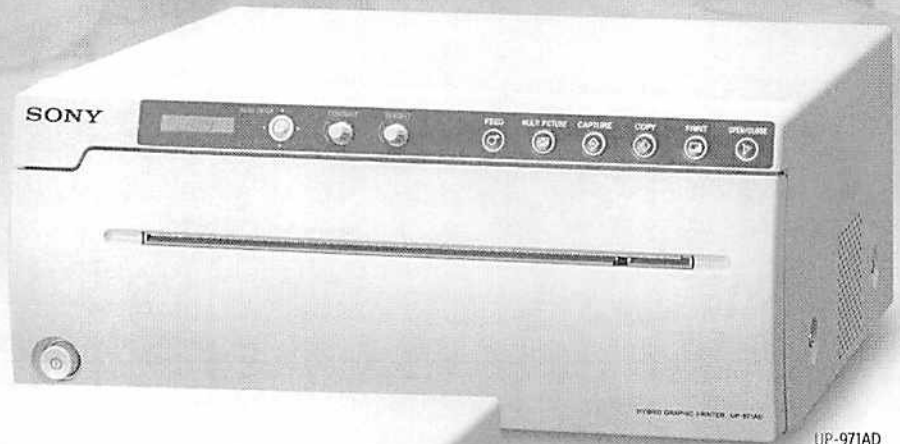

UP-971AD

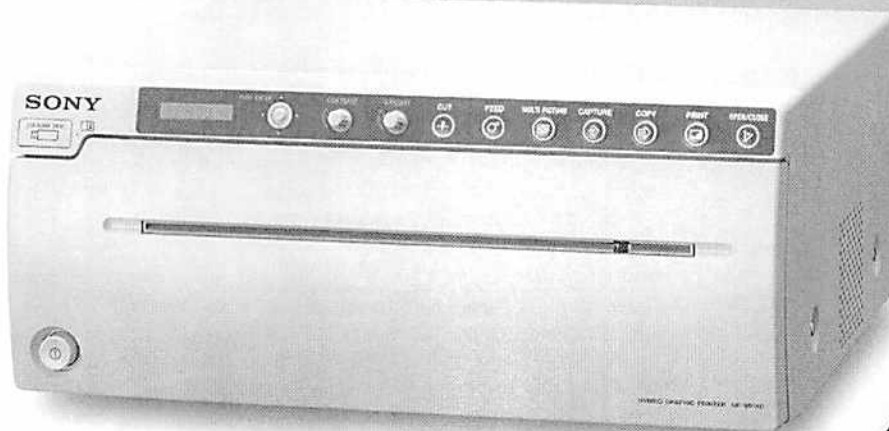

UP-991AD



UP-991AD/UP-971AD

Hybrid Graphic Printers

F. Beuy



The UP-991AD and UP-971AD are compact black and white printers designed for use with both analog and digital radiology imaging systems such as mobile C-arm, ultrasound, cardiac catheterization laboratory and other compatible medical imaging systems.

These printers are successors to the popular Sony UP-990AD and UP-970AD of medical printers. Redesigned and upgraded, it offers several operational and ergonomic enhancements in addition to the smaller design from its predecessors. Usability is further enhanced by an enlarged LCD display panel and joystick for intuitive menu navigation.

They provide high-quality hard copies of still images captured by the imaging system that can then be used as reference prints for patient record purposes or referrals.*

Both the UP-991AD and UP-971AD provide a Multi-picture print mode and panoramic print capability. Additionally, the UP-991AD can store images on a connected USB flash drive and print on transparent blue film media, in addition to paper media. Other conveniences offered by the UP-991AD include automatic detection of media type and an integrated media cutter.

* The images printed from the UP-991AD and UP-971AD are not to be used for diagnosis.

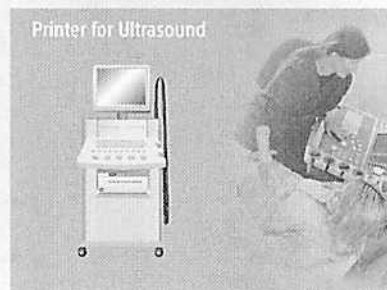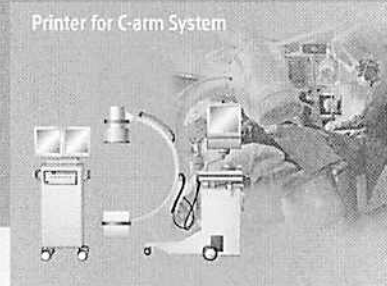

Products Overview

	UP-991AD	UP-971AD
Roll Paper Width	210 mm (8 1/4 inches)	
Blue Transparent Film Print	●	
USB Flash Drive Storage	●	
Automatic Media Cutter	●	
Analog Video Input	●	●
USB Connector (For medical device)	●	●

Key Features

High quality printing

Using Sony's direct thermal printing technology, these printers deliver photo-quality black & white prints with a high resolution of approximately 325 dpi.

High speed printing

In standard mode, these printers can deliver a print in approximately 8 seconds.

USB flash drive storage*1

The UP-991AD can store either the printed image or captured video frame on a USB flash drive inserted into the USB port on the front of the printer. Stored images can be in color, provided that the input signal is in color and Color mode (for better B&W printing of color images) is chosen.

Blue transparent film and black border mode*1

Images can be printed on blue transparent film with an optional black border if desired.



Black Border



White Border

Automatic media cutter*1

The printer automatically cuts paper or film media to size when printing is completed.

Accepts both digital and analog video input signals

These printers can receive digital as well as analog signals, allowing the printer to support both types of C-arm system. It also can receive signals from two different integrated systems - i.e. analog from a C-arm and digital from an ultrasound system.

More compact, more visible

These printers have a compact design with dimensions of approximately 316 (W) x 132.5 (H) x 265 (D) mm (12 1/2 x 5 1/4 x 10 1/2 inches) - 40mm smaller in depth than its predecessor. At the same time, the size of the LCD display panel is increased, and the control panel features a white LED backlight.

Enhanced operability

All function keys of printers are located on the front panel, allowing easy setup and operation when the printer is installed in a medical cart. In addition, separate knobs on the front panel allow easy adjustment of both contrast and brightness and an auto lock function that prevents inadvertent alteration of settings.

Panoramic printing

When connected to a digital signal, the printers can produce panoramic prints up to a maximum of 600mm long.


*1 This feature is only available on the UP-991AD.

Day 7



Multi-picture modes

As well as printing a single picture, these printers also offer a choice of two-, four- and six-way split printing of images on a single sheet when connected to an analog video signal. The 'Multi' button on the front panel allows quick switching between 'Single-picture' and 'Multi-picture' modes. With digital input signals, the printer can provide two or four split pictures on one sheet (NB: Multi button does not function with digital input).

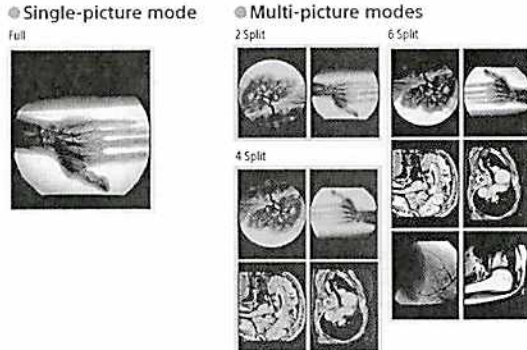


Wireless Printing Capability*1

By using the optional UPA-WU10*2 Wireless Print System, you can achieve cable-free connection between the UP-991AD/UP-971AD, mobile C-arm, and other hospital imaging modalities with a compatible wireless capability.

This is ideal for busy clinical environments, where modalities are constantly being moved between different ORs and examination rooms.

This all-in-one wireless printing solution also resolves the problem of limited space on medical carts, allowing connection between a medical imaging modality and an 'off-cart' printer without requiring a lengthy USB cable.

Use Case (Examination Room)

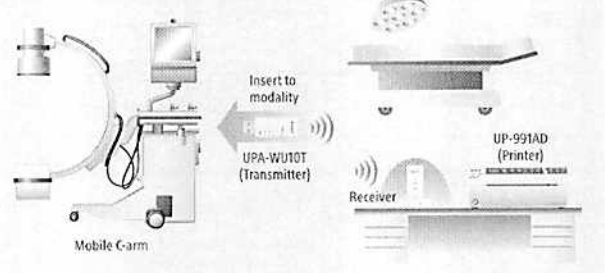

Visual print quality control

Optimum print settings can be compared and chosen from a 'collage' print of nine pictures with different sharpness, contrast, tone or brightness.



Example ("BRIGHT"=0)

Quick guide print

Quick instruction guides for different print operations can be selected via the front control panel. They can be printed out for easy reference without needing to refer to the user manual.*3

Automatic detection of media type*4

The printer automatically detects whether film or paper media has been loaded, eliminating the need to manually adjust settings when changing print media.

*1 This function is available only on models with a USB 5V output port, manufactured in March 2017 or later. To check compatibility for wireless use, please contact your nearest Sony office or an authorized dealer.

*2 Product availability of the UPA-WU10 may vary depending on the sales area.


*3 English only.

For more details, please contact your nearest Sony office or an authorized dealer.


*4 This feature is only available on the UP-991AD.

Front and Rear Panels


UP-991AD Front Panel

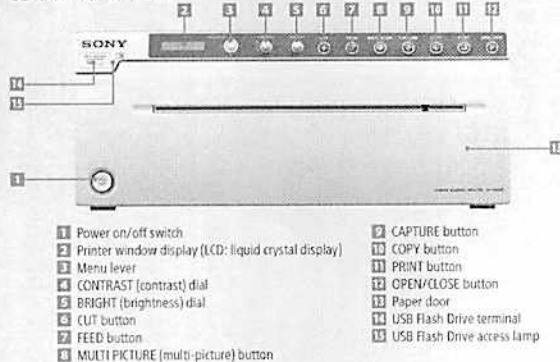


UP-991AD Rear Panel

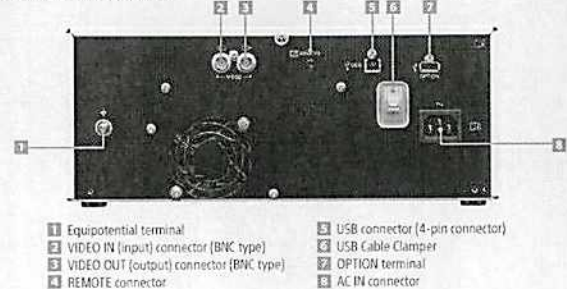

UP-971AD Front Panel

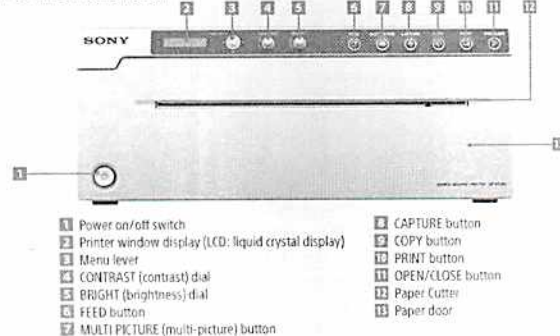

UP-971AD Rear Panel

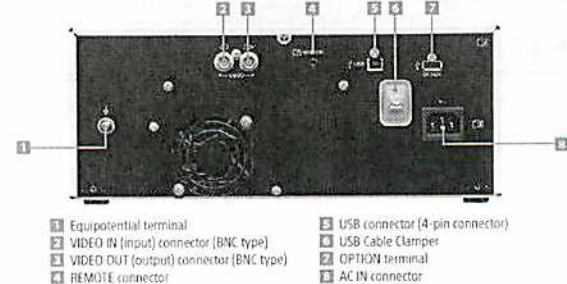

Day

8

Specifications

	UP-991AD	UP-971AD
Printing Method	Direct thermal printing	
Resolution	325 dpi	
Gradations	8 bits (256 levels) processing	
Picture Elements	Digital: 7680 x 2560 dots Video NTSC: 720 x 504 dots Video PAL: 720 x 604 dots	
Picture Area	DIGITAL: 600 x 200 mm (23 5/8 x 7 7/8 inch) (Max) VIDEO: STD NTSC: 182 x 144 mm PAL: 188 x 140 mm SIDE NTSC: 244 x 184 mm PAL: 244 x 183 mm	
Paper Size	Paper width of 210 mm (8 1/4 inches)	
Printing Time	Approx. 8 seconds/image (in standard mode)	
Picture Memory	Digital: 2816 x 7680 x 8 bits Video: 6 frames (720 x 608 x 8 bits for one frame)	
Interface	USB terminal (type A) for USB flash drive (x1) - Hi-Speed USB (USB 2.0) (x1) VIDEO INPUT: BNC type (x1) NTSC or PAL composite video signals 1.0Vp-p, 75ohm (NTSC/PAL automatically discriminated) VIDEO OUTPUT: BNC type (x1) Loop-through REMOTE: Stereo mini jack (x1)	
Printer Driver Software	Microsoft Windows XP 32/64, Vista 32/64, 7 32/64, 8 32/64	
Power Requirements	AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz	
Input Current	2.9 A to 1.2 A	
Operating Temperature	5°C to 35°C (41°F to 95°F)	
Operating Humidity	20% to 80% (no condensation allowed)	
Storage and Transport Temperature	-20°C to +60°C (-4°F to +140°F)	
Storage and Transport Humidity	20% to 80%	
Dimensions (W x H x D) *	316 x 132.5 x 265 mm (12 1/2 x 5 1/4 x 10 1/2 inch)	
Mass	7 kg (15lb 7oz)	
Supplied Accessories	Print Media (1), Thermal head cleaning sheet (1), CD-ROM (1), Before Using this Printer (1), Service Contact List (1)	

*The values for dimensions are approximate.

This product is distributed to the US (FDA) and EU (MDD) as a medical device and satisfies product safety standards (e.g. IEC 60601-1)**.

**For more details, please contact your nearest Sony sales office or an authorized dealer.

Optional Accessories



FS-24
Foot Switch

RM-91
Remote Commander

UPA-WU10
Consists of the
UPA-WU10T (Transmitter) and
UPA-WU10R (Receiver)

Printing Paper




UPP-210HD
Thermal Print Media (High Density)
Paper size: 210 mm (W) x 25 m

UPP-210SE
Thermal Print Media (Normal)
Paper size: 210 mm (W) x 25 m

UPT-210BL
Blue Thermal Transparent Film
Film size: 210 mm (W) x 12.5 m

Dimensions

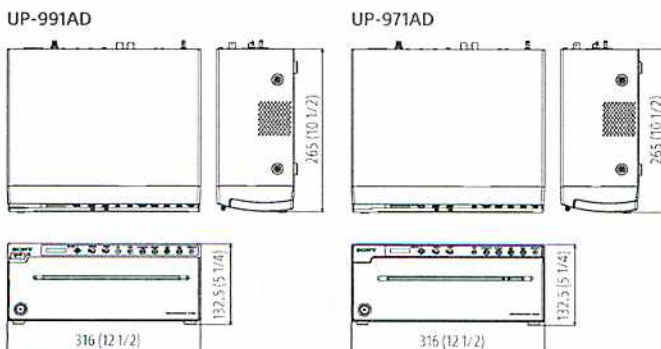

Unit: mm (inches)

Distributed by

©2017 Sony Corporation. All rights reserved.

Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.

Features and specifications are subject to change without notice.

All non-metric weights and measurements are approximate.

Sony is a registered trademark of Sony Corporation.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Please visit Sony's professional website or contact your Sony representative for specific models available in your region.

MK11133V20HB17MAR

Devy 9

IN SERVIZIO

U.O. Proponente	U.O. Gestione Econ.Fin.
<p>Spesa anno 2020 € 669,78 Sottoconto 01 01 02 090300</p> <p>CIG Z152E49228</p> <p>Fonte di Finanziamento: F.S.N.</p> <p>Referente UO proponente: Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio</p> <p>Li <u>29.9.2020</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Vittorio D'Ambrosio</p>	<p>Prenotazione N. <u>2189</u> /2020</p> <p>Settore: E09</p> <p>Delibera di Max =====</p> <p>Li <u>2-10-2020</u></p> <p>Il Contabile Il Dirigente ASL 4 TERAMO U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestro</p>

D'Aug

ORIGINALE


Il Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Maria Teresa D'Eugenio



Il Responsabile dell'U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Vittorio D'Ambrosio

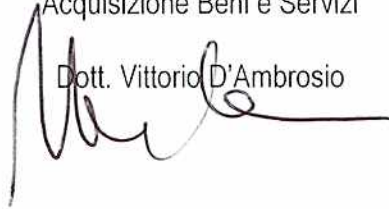

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data 06 OTT 2020 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data