

ORIGINALE

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - TERAMO**

Dipartimento Amministrativo  
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il giorno **24 FEB. 2020**, nella sede della ASL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n.28 del 09/01/2019 e nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011 così come successivamente modificata dalla Deliberazione nr. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. **0425**

**OGGETTO:** Affidamento tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di BABYMETEER, PLICOMETRI DI HARPENDEN e BILANCE MECCANICHE LATTANTI per l'U.O.C. di Pediatria e Neonatologia - P.O. TERAMO - della AUSL di Teramo - R.d.O. n. 2390430 - CIG: Lotto 1: Z4F29CB882; Lotto 2: Z5429CBEC2; Lotto 3: Z4629CBEE8-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

PREMESSO che il Direttore della U.O.C. di Pediatria e Neonatologia della ASL di Teramo ha chiesto l'acquisto di nr 6 BABYMETEER, nr. 2 PLICOMETRI DI HARPENDEN E nr. 3 BILANCE MECCANICHE LATTANTI per le esigenze della U.O.C. Pediatria e Neonatologia della ASL di Teramo così come da nota allegata al presente atto (all.01):

DATO ATTO che l'ammontare complessivo dell'intervento è pari ad € 4.000,00 secondo il seguente quadro economico determinato ai sensi dell'art. 113 Codice Appalti;

QUADRO ECONOMICO		
VALORE DELLA PROCEDURA		
A1	Importo soggetto a ribasso	4.000,00 €
A2	Importo proroga tecnica semestrale	- €
A3	Importo quinto d'obbligo	
A4	Importo rinnovo	- €
A5	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza	- €
A6	Importo di aggiudicazione/affidamento	2.014,00 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2+A3+A4+A5	4.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016	29,59 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016	16,00 €
B3	Spese pubblicità	
B4	Contributo Anac	
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A6 443,08 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3 - €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6	488,67 €
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	2.502,67 €

VISTI gli artt.:

- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

- 15 comma 13 lett d) del D. L. n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: “gli enti del servizio sanitario nazionale...(omissis) ..., utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: “...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA”;
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...”;

**ATTESO** che

- 1) la presente ordinanza vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 24.12.2015 pubblicato sulla G.U.R.I. del 9.2.2016 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- 3) da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato tuttavia che il materiale oggetto di acquisizione è comunque inserito nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messi a disposizione da Consip;

**DATO ATTO** che per la fornitura in argomento, è stata attivata Richiesta di offerta n. 2390430 del 18.09.2019 espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con invito aperto a tutti gli operatori economici abilitati al bando di competenza, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso (All. n. 2);

**VISTA** la suddivisione della gara in nr. 3 Lotti e, specificatamente:

- **LOTTO N. 1** (Valore complessivo a base d'asta € 1.500,00) FORNITURA DI N.6 BABYMETEER PER L'UOC DI PEDIATRIA DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. TERAMO - CIG: Z4F29CB882;
- **LOTTO N. 2** (Valore complessivo a base d'asta € 1.500,00) FORNITURA DI N.2 PLICOMETRI DI HARPENDEN PER L'UOC DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. TERAMO - CIG: Z5429CBEC2;
- **LOTTO N. 3** (Valore complessivo a base d'asta € 1.000,00) FORNITURA DI N.3 BILANCE MECCANICHE PER LATTANTI PER L'UOC DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. TERAMO - CIG: ZC1273C89C;

**CONSIDERATO** che:

- entro il termine di scadenza delle offerte fissato per il giorno 03.10.2019 sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici (All. n. 3):
  - SADEL MEDICA SRLS (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3);
  - L.P. PHARM SRL (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3)
  - DS MEDICA SRL (Lotto 1 e Lotto 2);
  - IDS SRL (Lotto 2 e Lotto 3);
  - MEGAPHARMA OSPEDALIERA (Lotto 2);
  - EMERGO SRL (Lotto 3)

**VISTO** che la documentazione amministrativa prodotta da parte degli operatori economici offerenti è risultata conforme rispetto a quanto previsto nella Rdo e che, pertanto, le stesse sono state ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte tecniche;

**PRESO ATTO** del giudizio di conformità/non conformità espresso dal Direttore della U.O.C. di Pediatria e Neonatologia della ASL di Teramo, in merito alla documentazione tecnica presentata dalle sopracitate ditte partecipanti, nonché delle risultanze relative alla apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse (all. 04):

**LOTTO 1:**



DITTA	CONF./NON CONF.	OFFERTA ECONOMICA
SADEL MEDICA SRLS	CONFORME	€ 612,00 + IVA
L.P. PHARM SRL STUDIO PACINOTTI	NON CONFORME Intervallo mm.5 anziché mm.1	
DS MEDICA SRL	CONFORME	€ 1.170,00 + IVA

**LOTTO 2:**

DITTA	CONF./NON CONF.	OFFERTA ECONOMICA
SADEL MEDICA SRLS	CONFORME	€ 640,00 + IVA
IDS SRL	CONFORME	€ 730,34 + IVA
L.P. PHARM SRL	CONFORME	€ 671,78 + IVA
DS MEDICA SRL	NON CONFORME Non plicometro di Harpenden	

**LOTTO 3:**

DITTA	CONF./NON CONF.	OFFERTA ECONOMICA
SADEL MEDICA SRLS	CONFORME	€ 837,00 + IVA
IDS SRL	CONFORME	€ 804,51 + IVA
EMERGO SRL	CONFORME	€ 762,00 + IVA
L.P. PHARM SRL	CONFORME	€ 930,00 + IVA

RITENUTO doversi procedere all'aggiudicazione del Lotto 1 della RDO N° 2390430 – n. 6 BABYMETER PER UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. DI TERAMO - in favore della ditta SADEL MEDICA SRLS UNIPERSONALE per aver presentato la miglior offerta economica, importo complessivo € 612,00 + iva;

RITENUTO doversi procedere all'aggiudicazione del Lotto 2 della RDO N° 2390430 – n. 2 PLICOMETRI DI HARPENDEN R PER UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. DI TERAMO - in favore della ditta SADEL MEDICA SRLS UNIPERSONALE per aver presentato la miglior offerta economica, importo complessivo € 640,00 + iva;

RITENUTO doversi procedere all'aggiudicazione del Lotto 3 della RDO N° 2390430 – n. 3 BILANCE MECCANICHE LATTANTI PER UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. DI TERAMO - in favore della ditta EMERGO SRL per aver presentato la miglior offerta economica, importo complessivo € 762,00 + iva;

RITENUTO di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi della vigente normativa, il Direttore F.F. dell'UOC di Pediatria e Neonatologia del P.O. di Teramo, Dott. Franco Di Lollo;

RITENUTO, infine, doversi rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

**DISPONE**

*per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,*

RECEPIRE le risultanze di gara come descritte in narrativa.

PRECISARE che ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al presente provvedimento è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, nessuno escluso.

AGGIUDICARE all'operatore economico SADEL MEDICA SRLS UNIPERSONALE - Via Monte Bove, 24 – 65100 PESCARA - P.I.: 02060030687, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, quanto appresso:

-n. 6 BABYMETER per un importo complessivo di € 612,00 + IVA, - offerta relativa al Lotto 1 della RDO 2390430;

-n. 2 PLICOMETRI DI HARPENDEN per un importo complessivo di € 640,00 + iva - offerta relativa al Lotto 2 - della RDO 2390430;

AGGIUDICARE all'operatore economico EMERGO SRL – Viale della Repubblica, 209 – 31100 TREVISO (TV) - P.I.: 04467060267, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, n. 3 BILANCE MECCANICHE per un importo complessivo di Euro 762,00 + IVA, - offerta relativa al Lotto 3 della RDO 2390430;

DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

DARE ATTO, altresì, che alla spesa complessiva di € 2.014,00 + IVA si farà fronte mediante la prenotazione assunta con delibera 0344 del 25.02.2019 relativa al Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 proroga 2019. Attuazione PROGRAMMA 4: "OPERATORI SANITARI PROMOTORI DI SALUTE".

PRENOTARE la somma pari ad € 2.457,08 come da prospetto finanziario allegato.

**NOMINARE** quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi della vigente normativa, l 25.02.2019 il Direttore F.F.dell'UOC Pediatria e Neonatologia del P.O. di Teramo, Dott. Franco Di Lollo al quale si invia copia del presente atto per il seguito di competenza;

**RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Di Lollo".

Regione Abruzzo

Azienda Unità Sanitaria Locale 4

Teramo

Dipartimento Amministrativo-UOC Acquisizione Beni e Servizi

## ALLEGATI ALL'ORDINANZA

---

Allegato 1) - richiesta;

Allegato 2) - dati generali della procedura;


Allegato 3) - giudizio di conformità/non conformità;

Allegato 4) - offerte tecniche ed economiche:

- LOTTO 1: SADEL MEDICA SRLS;


- LOTTO 2: SADEL MEDICA SRLS;

- LOTTO 3: EMERGO SRL.



Allegati n. fog. 26

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. M." or similar.









*Costopol*


ASL n.4 TERAMO	<b>SCHEDA PER RICHIESTA ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI</b>	ALLEGATO n. 4
Trasmessa a:	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	Data richiesta 21 giugno 2019

U.O. richiedente PEDIATRIA E NEONATOLOGIA Centro di Costo 8050 Direttore DR. MARIO DI PIETRO

PRESENZA DELL'ACQUISTO NEL PIANO DEI FABBISOGNI  SI  NO CLASSE DI PRIORITÀ ASSEGNATA NEL PIANO DEI FABBISOGNI:

N.B. : RICHIESTE DI ACQUISTO NON PRESENTI NEL PIANO DEI FABBISOGNI O CON PRIORITÀ SUPERIORE A 20 SONO IMPROCEDIBILI

Richiesta beni strumentali (apparecchiature, software, arredi, ecc.)		da destinare a: (Utente, Ubicazione e rif. telefonico)	Num. Inventario vecchie apparecchiature (solo se sostituzione)	costo presunto (EURO)	eventuali annotazioni
Quantità	Descrizione materiale richiesto				
1	ABR	Neonatologia Teramo	integrazione	12.000,00	Fondi finalizzati
1	ECO SREEN	Neonatologia Teramo	integrazione	5.500,00	Fondi finalizzati
2	OFTALMOSCOPI	Pediatria Teramo	integrazione	400,00	Fondi finalizzati
4	OTOSCOPI	Pediatria Teramo	integrazione	960,00	Fondi finalizzati
3	BILANCE MECCANICHE LATTANTI	Neonatologia/Pediatria Teramo	integrazione	1.000,00	Fondi finalizzati

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO  
Posta Interna.  
  
Prof. nr. 0063789/19 del 24/06/2019

Breve descrizione del motivo dell'acquisto, delle attività da automatizzare e dell'eventuale software che si intende utilizzare:

Riferimento fonte di finanziamento (FSN, fondi finalizzati, entrate proprie, ecc.) PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE


(AZIONI 3-4-5 DEL PROGRAMMA PRP)

Nome e Firma del Richiedente *[Signature]* **A.U.S.L. TERAMO OSPEDALE "GIUSEPPE MAZZINI" U.O.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DIRETTORE Mario Di Pietro**

Firma del Dirigente Responsabile dell'U.O. *[Signature]* **Azienda Unità Sanitaria Locale TERAMO 67-37-1141 (Dott. ssa Anna Marozzi)**

Annotazioni dell'Alta Direzione o firma per approvazione/parere tecnico

2

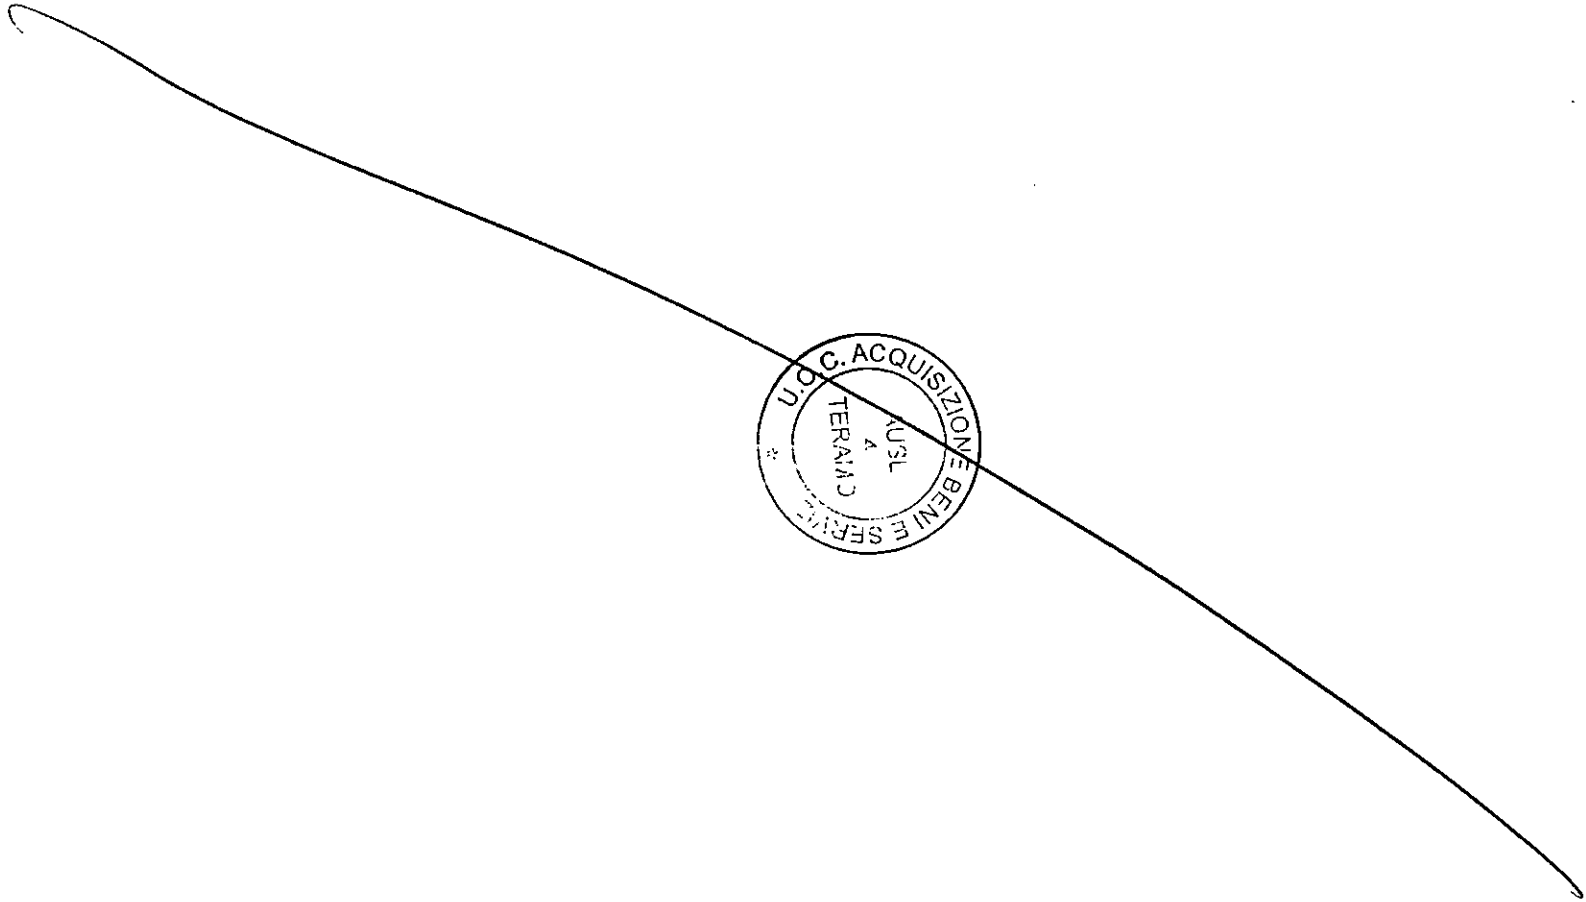

U.O.C. ACQUISIZIONE  
BENEF. SERVIZI  
AUSL  
A  
TERAMO

U.O.C. ACQUISIZIONE  
BENEF. SERVIZI  
AUSL  
A  
TERAMO


in pa

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2390430
<b>Descrizione RDO:</b>	FORNITURA DI BENI PER UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL PO DI TERAMO - MDP
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	3
<b>Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)</b>	si
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	ASL 4 Teramo 00115590671 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO TE
<b>Punto Ordinante</b>	MARCO RODOMONTI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: MARCO RODOMONTI Amministrazione: ASL 4 Teramo
<b>Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	UFPLOH ET
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	18/09/2019 11:53
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	03/10/2019 13:00
<b>Termine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	28/09/2019 13:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	30/06/2020 13:00
<b>Giorni dopo la stipula per</b>	20

Data Creazione Documento: 18/09/2019 11:53

Pagina 1 di 7

<b>Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	BABYMETER PER UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL PO DI TERAMO
<b>CIG</b>	Z4F29CB882
<b>EUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	AUSL TERAMO - UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. DI TERAMO - DOTT. MARIO DI PIETRO - P.ZA ITALIA - OSPEDALE CIVILE - TERAMO - 64100 (TE)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	1500,00000000



Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	BABYMETER
<b>Quantita'</b>	6

4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Fornitura oggetto prevalente della RdO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Acquisto</li> <li>o</li> </ul>
3	* Prezzo complessivo della fornitura	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	PLICOMETRO DI HARPENDEN
<b>CIG</b>	Z5429CBEC2
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	AUSL TERAMO - UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. DI TERAMO - 1° LOTTO - 1° PIANO - OSPEDALE CIVILE - P.ZA ITALIA - TERAMO - 64100 (TE)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H. Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	1500,00000000

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	PLICOMETRO DI HARPENDEN
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Fornitura oggetto prevalente della RdO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Acquisto</li> <li>◦</li> </ul>
3	* Prezzo complessivo della fornitura	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	BILANCE MECCANICHE
<b>CIG</b>	Z4629CBEE8
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	AUSL TERAMO - UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. DI TERAMO - OSPEDALE CIVILE - P.ZA ITALIA - TERAMO - 64100 (TE)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H. Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	1000,00000000



Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	BILANCE MECCANICHE
<b>Quantita'</b>	3

*[Handwritten signatures and the number 6]*

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Fornitura oggetto prevalente della RdO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Acquisto</li> <li>e</li> </ul>
3	* Prezzo complessivo della fornitura	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO


Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	BABYMETE PER UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL PO DI TERAMO	Babymeter.pdf (202KB)	
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	PLICOMETRO DI HARPENDEN	Plicometro Di Harpendem.pdf (179KB)	
PATTO INTEGRITA' AZIENDA USL DI TERAMO	Gara	Patto Integrita Azienda Usi Di Teramo.pdf (420KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
ALL. A - DUVRI	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si




Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
DEPIANTS ILLUSTRATIVI	BABYMETE PER UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL PO DI TERAMO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO	BABYMETE PER UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL PO DI TERAMO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
OFFERTA ECONOMICA CON PREZZO	BABYMETE PER UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL PO DI TERAMO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	BABYMETE PER UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL PO DI TERAMO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
DEPIANTS ILLUSTRATIVI	PLICOMETRO DI HARPENDEN	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
MODELLO OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO	PLICOMETRO DI HARPENDEN	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
MODELLO OFFERTA ECONOMICA	PLICOMETRO DI HARPENDEN	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	PLICOMETRO DI HARPENDEN	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
DEPIANTS ILLUSTRATIVI	BILANCE MECCANICHE	Tecnica	Invio telematico con firma	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si




OK 8



OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO	BILANCE MECCANICHE	Tecnica	digitale Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
OFFERTA ECONOMICA CON PREZZO	BILANCE MECCANICHE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	BILANCE MECCANICHE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

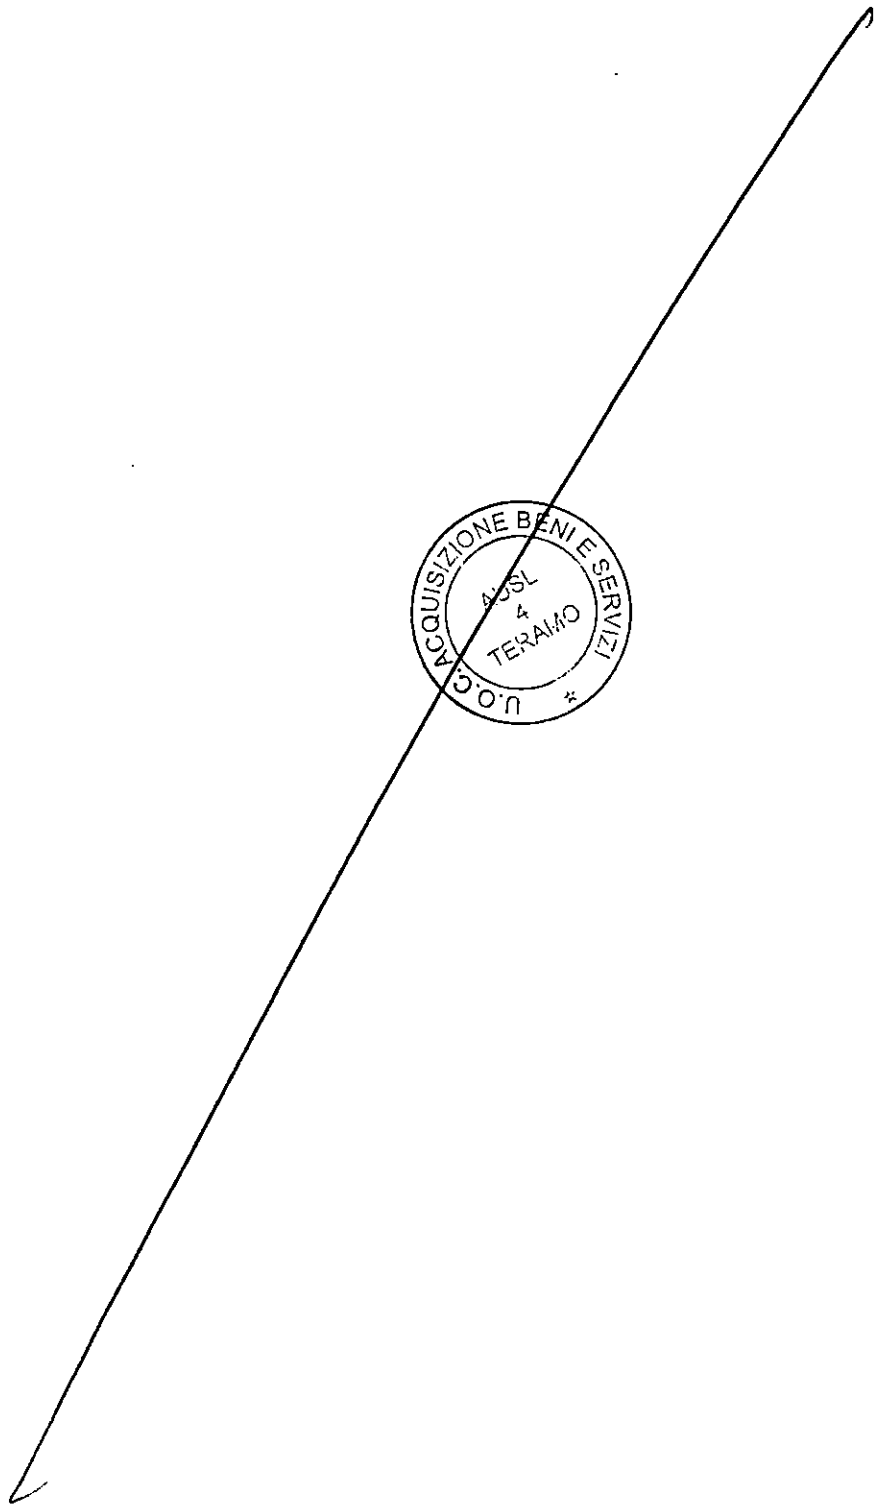

A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE: (Ragione Sociale) SADEL MEDICA S.R.L.S. UNIPERSONALE				
Riga	DESTINAZIONE	Metaprodotto MEPA	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Note
1	Pediatria e Neonatologia Teramo - 1° Lotto - 1° Piano - tel. 0861.429382	BABYMASTER (asta graduata per la misurazione della lunghezza dei bambini da 0 a 2 anni)	Pezzo	6	SECA	ALTIMETRO SECA 207	
<b>TOTALE</b>							

Si precisa che l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso previa verifica di conformità tecnica a quanto richiesto



N.B. RIEMPIRE LA ZONA IN ALTO A DESTRA RELATIVA ALLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA CONCORRENTE

27.11.2019

Conferma della richiesta.


OSPEDALE "S. LUCA" - TERAMO  
 P.O. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA  
 DIRETTORE  
 Dott. Mario Di Pietro

ST 20

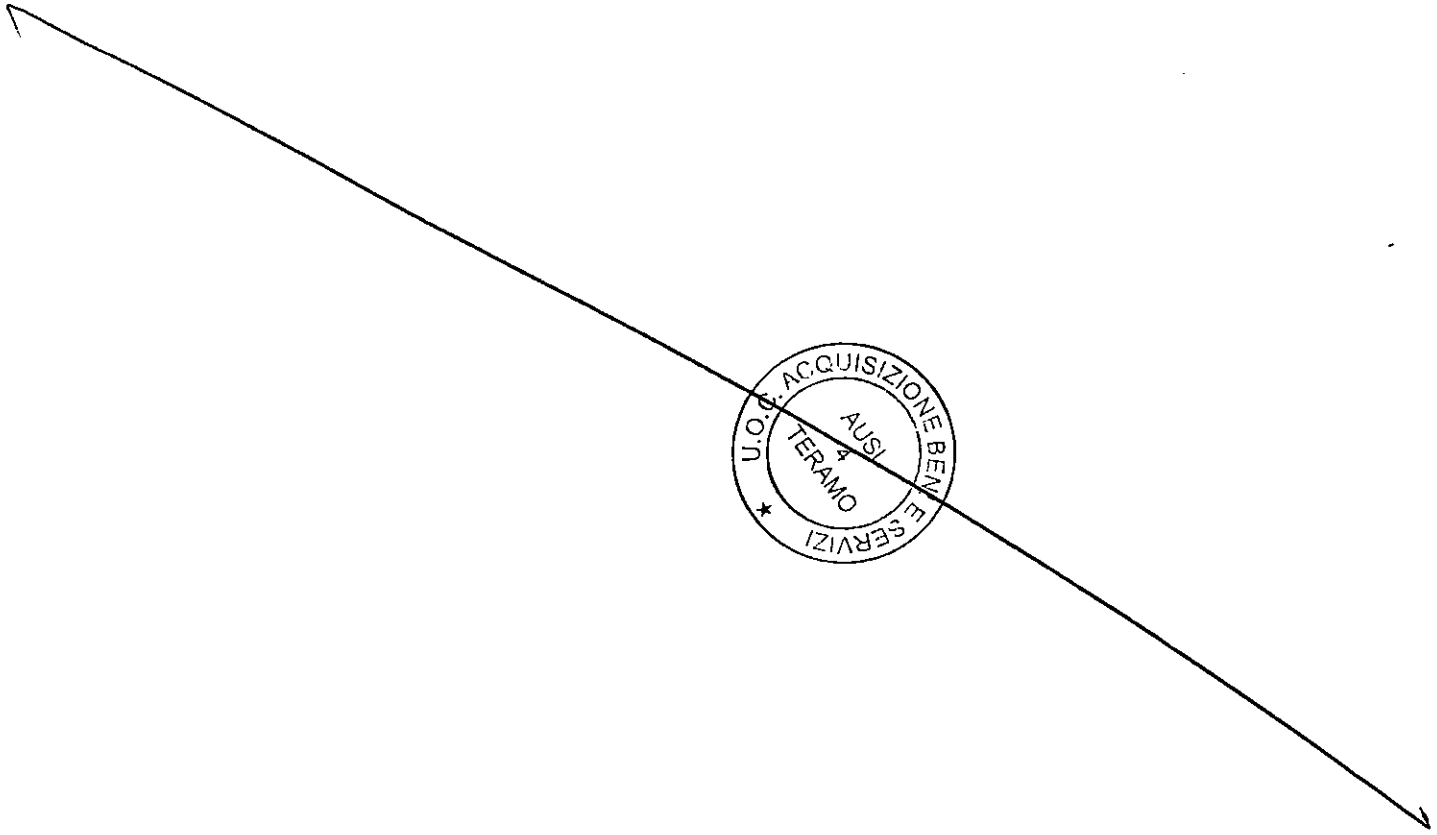

# LOTTO 1 - BABYMETEER

## Altimetro per neonati cod. 207



Misuratore ad asta per rilevare l'altezza dei neonati.

Realizzato in solido e leggero alluminio anodizzato, con ampi cursori per una precisa misurazione quando il bambino è disteso.

Può essere comodamente fissato al tavolo del cambio o alla parete, oppure usato come dispositivo mobile.

Gli ampi cursori, per posizionare testa e piedi, rendono semplice determinare la lunghezza e possono essere ripiegati quando lo strumento non è in uso.


La scala graduata è stampata con una tecnica antiusura che consente le letture dell'altezza anche dopo molti anni di utilizzo.

range di misura 0 - 99 cm

divisione 1 mm


O.C. ACQUISIZIONI



U.O.C. \*  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
TERAMO 4  
ASL

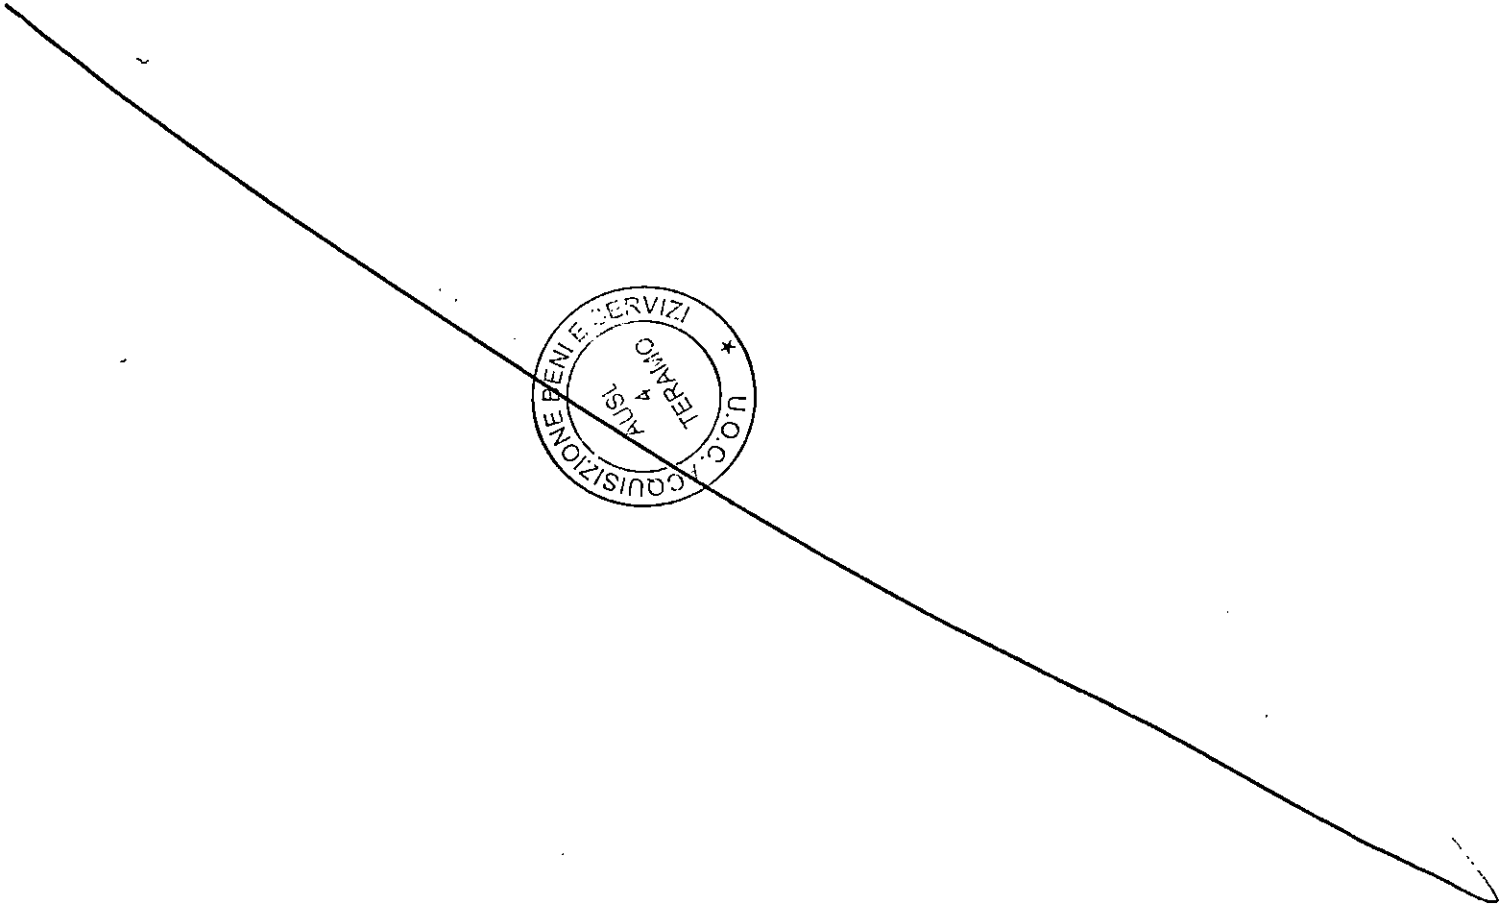

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
Codice CND	V0399	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	93330/R	
Conformità alla Direttiva: 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE - 2014/31/UE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
Ente Certificatore	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	seca GmbH & Co. KG	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	

Range di misura	0 - 99 cm
Divisione	1 mm
Precisione	± 5 mm
Dimensioni (L x A x P)	1.047 x 120 x 286 mm
Peso	810 g
Condizioni ambientali di utilizzo Temperatura	Da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 140 °F)



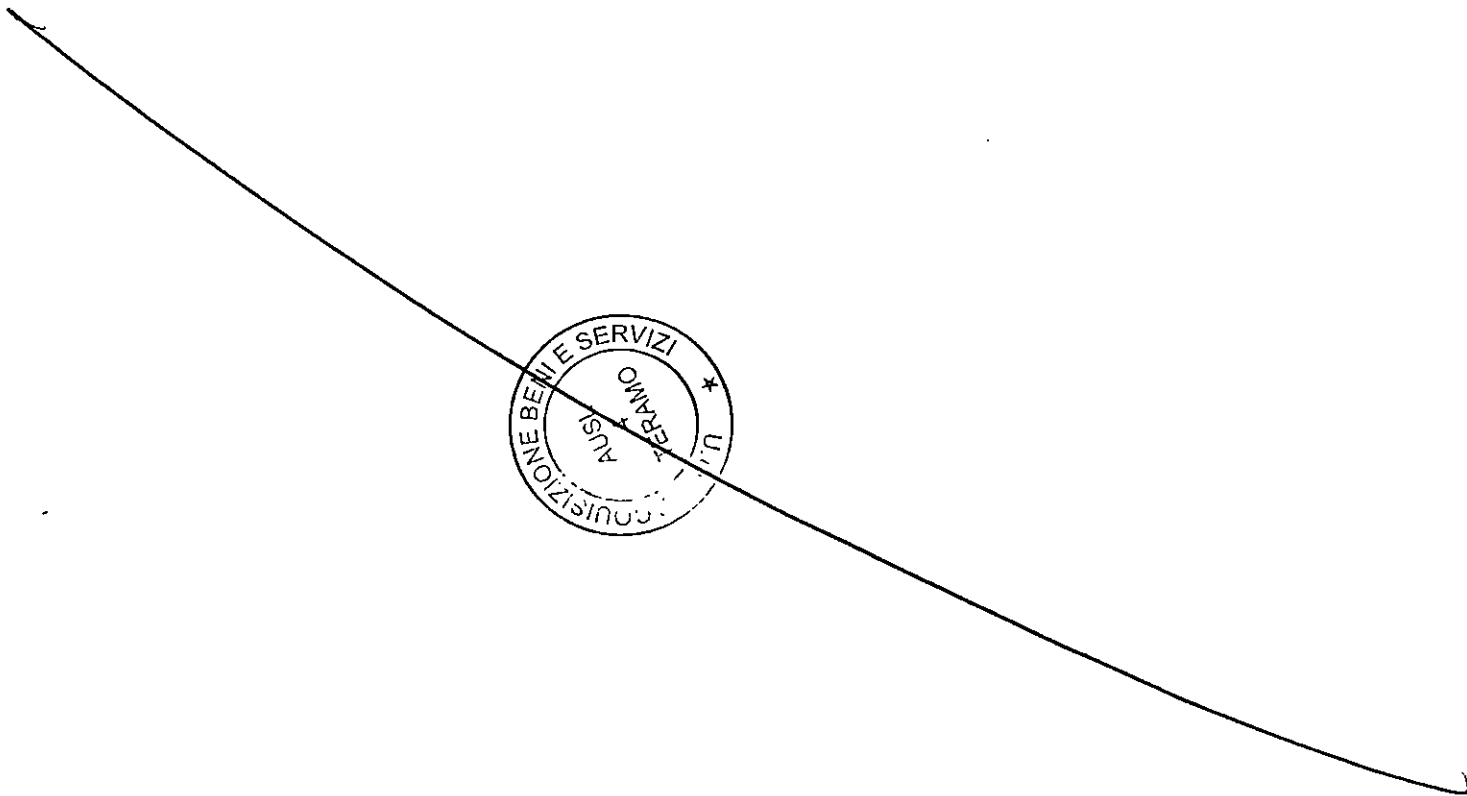

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE: (Ragione Sociale)		
Riga	DESTINAZIONE	Metaprodotto MEPA	Unità di misura	Qtà richieste	SADEL
				Marca	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo
1	Pediatria e Neonatologia Teramo - 1° Lotto - 1° Piano - tel. 0861.429382	PLICOMETRI DI HARPENDEM	Pezzo	2 BATY	PLICOMETRO DI HARPENDEM COD. 01801
<b>TOTALE</b>					

Si precisa che l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso previa verifica di conformità tecnica a quanto richiesto

N.B.: RIEMPIRE LA ZONA IN ALTO A DESTRA RELATIVA ALLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA CONCORRENTE


27.11.19

*Conferma da parte*

A.U.S.L. 4 TERAMO  
 OSPEDALE "GIUSEPPE MAZZINI"  
 P.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA  
 DIRETTORE  
 Dott. Mario D. G. P.

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*  
13

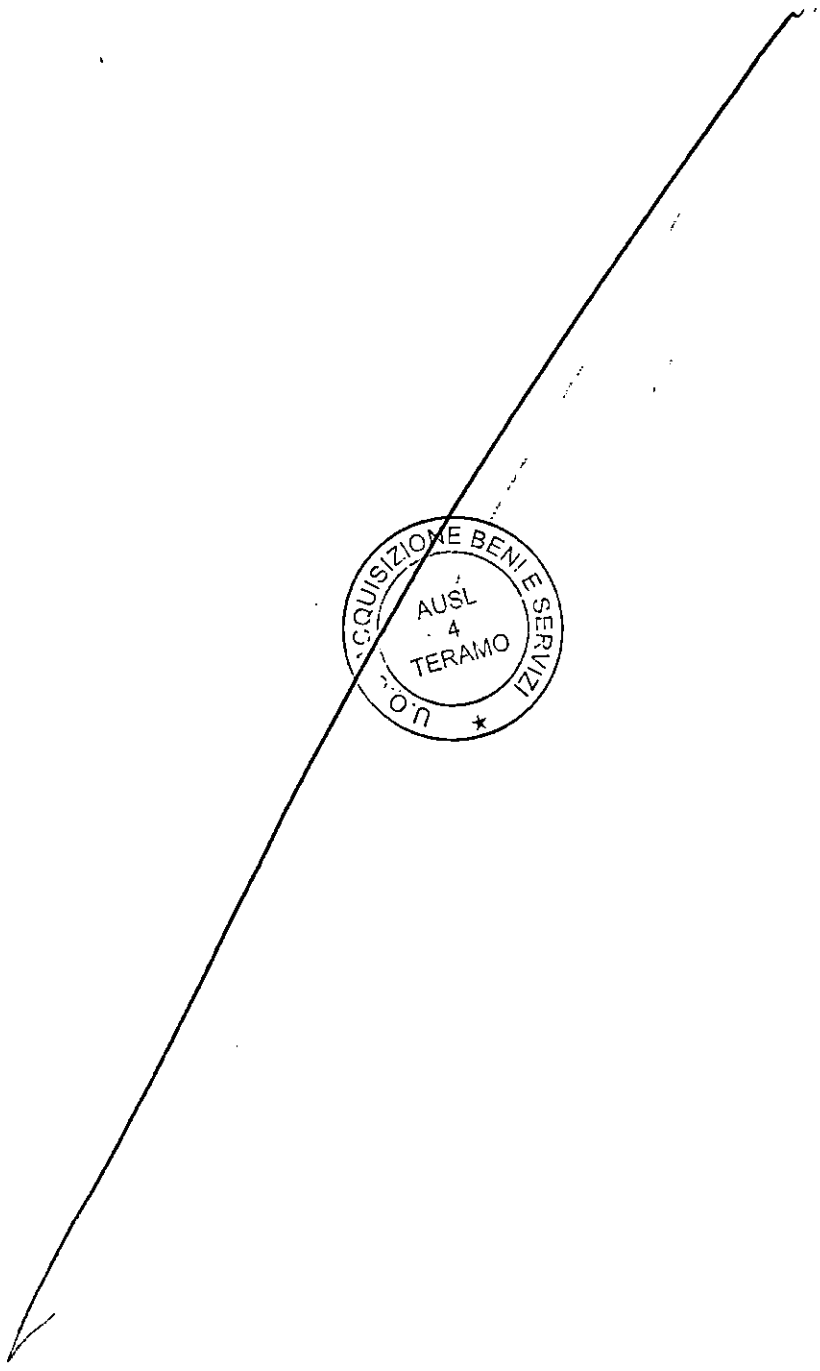

LOTTO 2

# Plicometro di Harpenden

COD. 01801

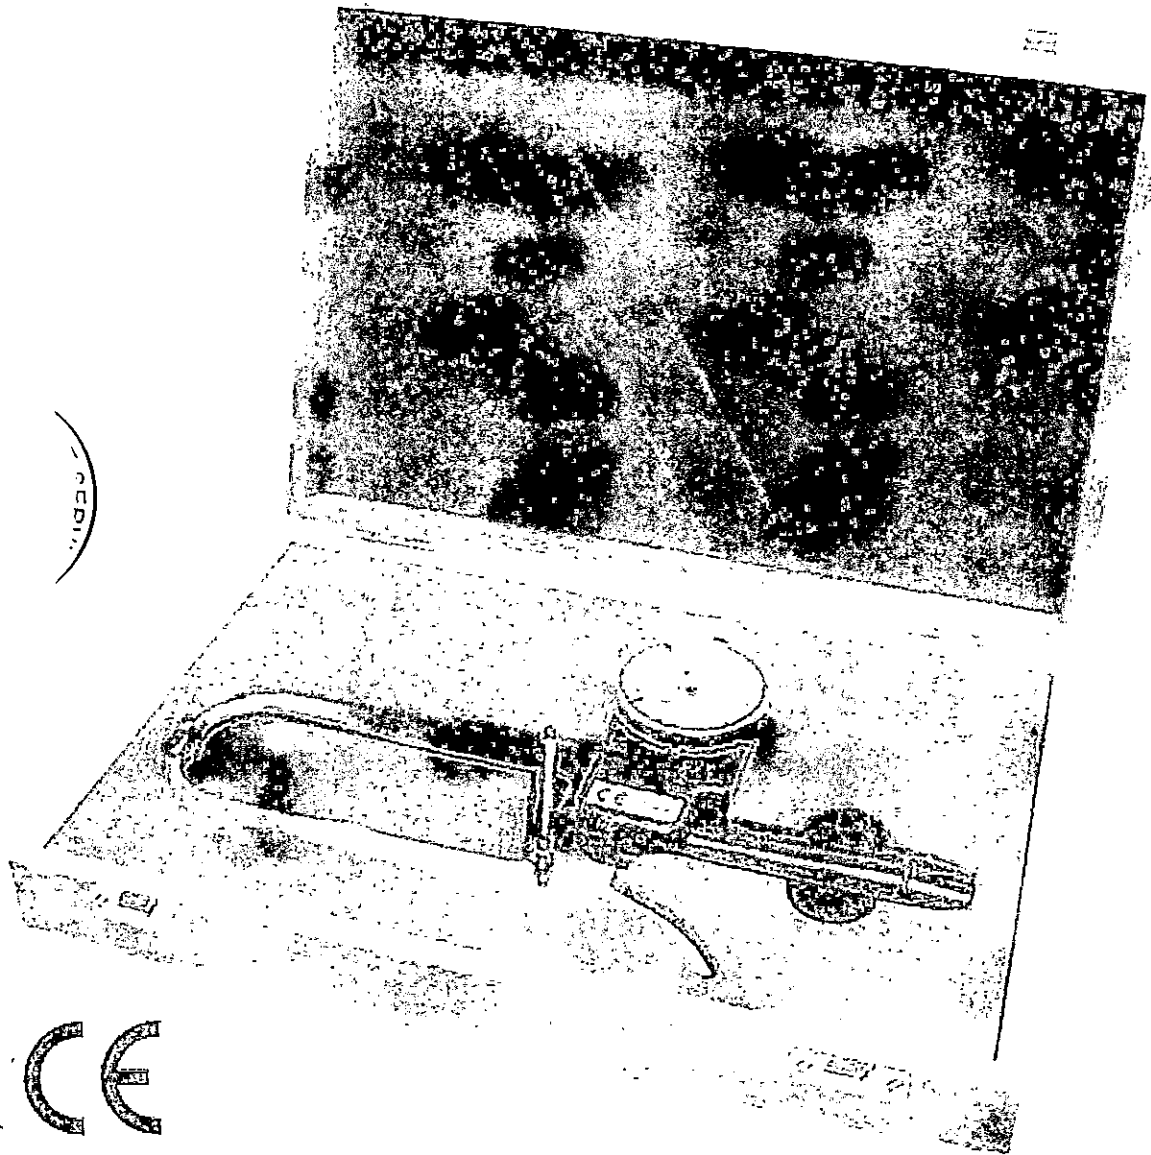

Il Plicometro di Harpenden è uno strumento di precisione progettato per la misura delle pliche cutanee (dalle quali si stima la massa grassa corporea).

L'impiego di questo strumento è stato validato dalla numerosa documentazione scientifica pubblicata negli ultimi 40 anni.

Questo strumento è leader di mercato fra i plicometri meccanici ed è stato sancito dagli specialisti quale strumento di riferimento e riconosciuto come standard industriale.



Viene utilizzato in tutto il mondo per molteplici applicazioni pratiche e per la diagnosi nei settori nutrizionali, dell'obesità, nei disordini di tipo alimentare e nei problemi di sviluppo.

La misurazione delle pliche cutanee non consente di determinare direttamente la massa grassa corporea o la percentuale di grasso, ma tramite specifiche equazioni dedicate permette di stabilirne la correlazione, unitamente ad altre misure corporee.

La percentuale della massa grassa corporea viene determinata tramite la densità corporea stimata.

Vari ricercatori hanno sviluppato equazioni utilizzabili tramite le sole misure delle pliche o in correlazione con altre misure del corpo quali la circonferenza o la lunghezza degli arti. Due dei principali gruppi di equazioni utilizzati attualmente sono quelli attribuiti a Durin & Womersley (per sole pliche) e a Jackson & Pollack (pliche e misure corporee). I risultati ottenuti dalle equazioni vengono successivamente utilizzati nell'equazione di Siri per il calcolo della massa grassa corporea.

Il Plicometro di Harpenden viene fornito completo di manuale d'uso per:

- ▶ Valutazione e significato della composizione corporea
- ▶ Uso del plicometro
- ▶ Misurazione delle pliche cutanee
- ▶ Livello massimo della massa grassa (preferiti/desiderato)
- ▶ Tabelle del % della massa grassa in rapporto allo spessore delle pliche, nell'uomo e nella donna di tutte le età basate sul sistema di Dumin & Womersley
- ▶ Equazioni della densità corporea

A richiesta esiste un software interpretativo (in lingua inglese) di facile utilizzo su qualsiasi PC.

#### Specifiche tecniche

Range di misura	Risoluzione	Ripetibilità	Precisione
80 mm.	0,20 mm	0,20 mm	99%


Nota: per risoluzione s'intende la suddivisione più piccola della scala di misura e non la precisione

Il Plicometro di Harpenden è provvisto di marcatura CE secondo le direttive europee CE 93/42 previste per i dispositivi medici di Classe 1 con funzioni di misura e calibrato tramite strumenti campione certificati



U.O.C. ACQUISIZIONE  
M TE

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
AUSL  
TERMO

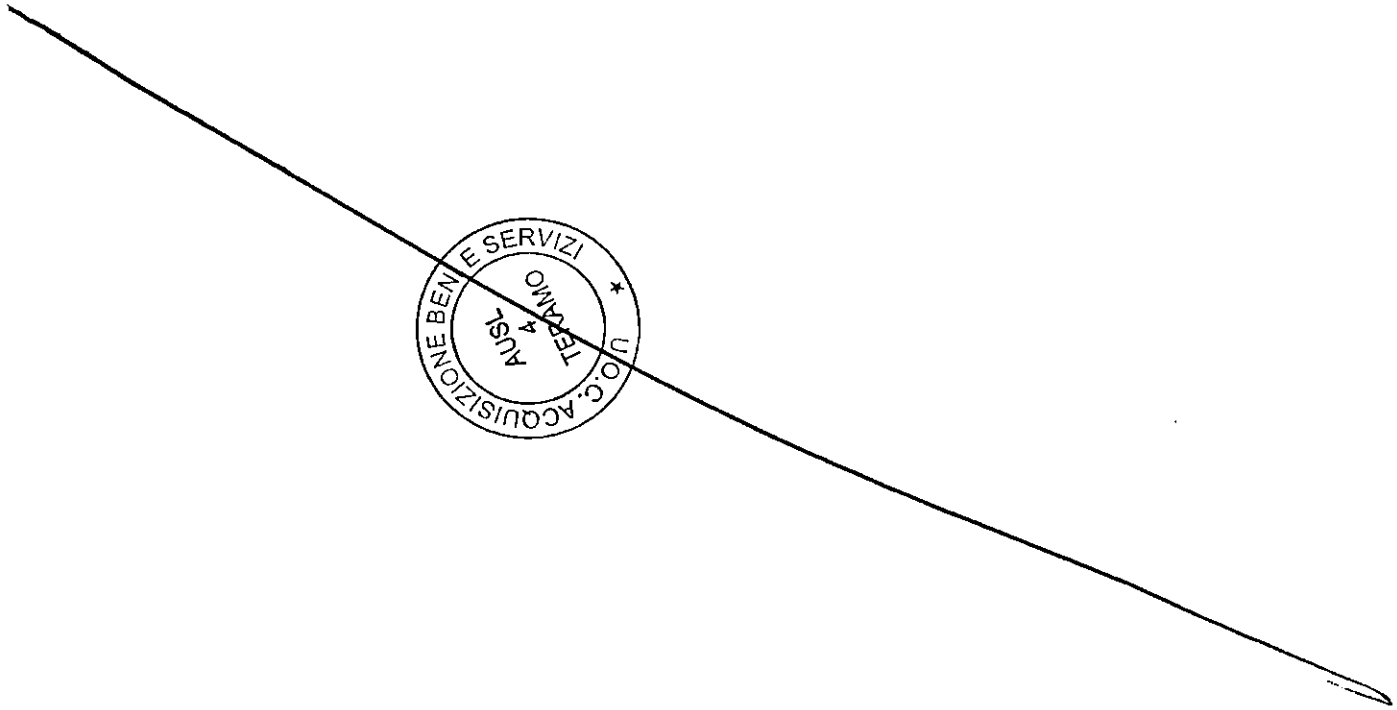

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Unità di misura	Qtà richieste	Area compilata dal FORNITORE EMERGO S.R.L.		
Riga	DESTINAZIONE	Metaprodotto MEPA			Marca	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Note
1	Pediatria e Neonatologia Teramo - 1° Lotto - 1° Piano - tel. 0861.429382	Bilance meccaniche lattanti	Pezzo	3	SECA	BILANCIA MECCANICA PESANEONATI MOD. 745 CLASSE III	
<b>TOTALE</b>							

Si precisa che l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso previa verifica di conformità tecnica a quanto richiesto

*[Handwritten signature]*  
 N.B.: RIEMPIRE LA ZONA IN ALTO A DESTRA RELATIVA ALLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA CONCORRENTE


27.11.19

CONFRONTO ALLA ALORISTIA


*[Handwritten signature]*  
 A.U.S.L. 4 - TERAMO  
 OSPEDALE "GIUSEPPE MAZZINI"  
 U.O.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA  
 DIRETTORE  
 Dott. Mario Di Pietro

*[Handwritten signature]*  
 16

# seca 745

Mechanical baby scales  
with sliding weights 

product sheet [ seca 745

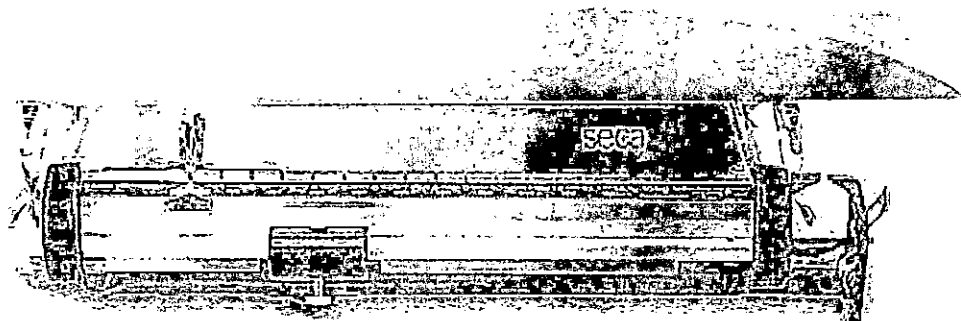

- Classic design and high-quality precision mechanics.
- Precise ascertainment of weight\* due to zero adjustment.
- Softly curved weighing tray for maximum safety.
- Easy-care and mobile.

17

**seca**  
Precision in your hands



# seca 745:

## The sturdy classic.

A baby gains weight quickly – its weight has almost doubled after four to six months. As soon as the baby begins to crawl and run, the one or other gram of baby fat will quickly disappear. In order that the baby's development can be monitored safely from the very beginning, instruments are required in pediatrics on which one can rely long-term. A baby scale that will work in all surroundings: The mechanical baby scale seca 745 has been around for over 50 years and is still there being used by health professionals all over the world.

### Classic design and high-quality precision mechanics.



The seca 745 combines the classic flat construction with high-quality precision mechanics. With its smooth running weights it is easy to use and provides precise results. The baby lies safe and secure in the softly curved weighing tray. The robust steel construction and cast levers ensure years of durability and accuracy. All this has made this mechanical baby scale a favorite for many decades.

### Precise weight ascertainment due to zero adjustment.


The zero adjustment ensures the reliable determination of the net weight – a soft mat can simply be tared away, showing the actual weight of the baby. The baby scale has lbs and kg measurements on the balance beam and the weight graduations are very small, 10 g. The weight capacity is 16 kg respectively. These graduations are hard to beat on any mechanical baby scale you can find and because this unit is mechanical, there is very little that can go wrong with it.

### Easy-care and mobile.

The weighing tray is easy to remove from the base for cleaning. The hard-wearing, scratch-proof finish and the smooth, seamless surface makes the seca 745 extremely easy to clean. The scale can be safely stored and is easy to transport in the optional carrying case seca 425.

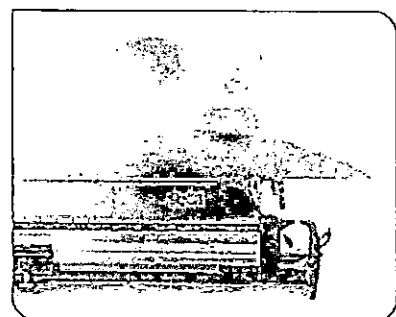


To simplify cleaning, weighing tray can be removed.

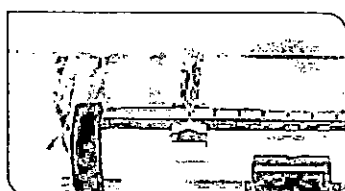

The reset-to-zero function guarantees reliable determination of net weight by simply deducting the extra weight of padding or diaper.

With plastic wheels and retractable handle.

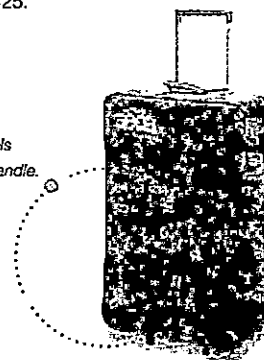

## seca 745

### Technical Data

- Capacity: 16 kg
- Graduation: 10 g
- Dimensions (WxHxD): 550 x 180 x 290 mm
- Weight: 6.4 kg
- Optional: Carrying case seca 425
- Approval class:

## BILANCIA PESA NEONATI MECCANICA

seca 745

Ref. 745



### Descrizione

Bilancia pesa neonati a cursore. In questo modello si fondono il classico design del piatto e l'eccellente precisione meccanica. I precisi e scorrevoli cursori semplificano la determinazione del peso esatto di un neonato. La regolazione dello zero garantisce la determinazione del peso netto, deducendo il peso supplementare del tappetino antifreddo o del pannolino. Le curve delicate ed avvolgenti del piatto garantiscono sicurezza durante la pesata. Con la verniciatura antigraffio e resistente agli urti, seca 745 è facile da pulire e durevole nel tempo.

### Destinazione d'uso

La bilancia seca 745 è indicata per uso medico per la determinazione del peso nei neonati. E' impiegata principalmente negli ospedali e ambulatori per rilevare il peso alla nascita e per verificare l'aumento di peso durante la crescita.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20137 • Milano (MI) • Cod. Fisc./P. IVA 11703230158  
Telefono: +39 02.98248016 • Fax: +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione  
qualità aziendale certificato:  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

**Identificazione prodotto**

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Z12080402	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	76846/R	
Classe di precisione	III	
Conformità alla Direttiva: - 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE - 2014/31/UE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> IIc	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	seca GmbH & Co. KG	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc./P. IVA 11703230158  
 Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
 Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione  
 qualità aziendale certificato  
 UNI CEI EN ISO 13485:2016

B.



20

**Caratteristiche Tecniche**

Portata	16 kg
Divisione	10 g
Dimensioni (L x A x P)	550 x 180 x 290 mm
Dimensioni piatto di pesata	595 x 110 x 270 mm
Peso	6.4 kg
Funzioni	Regolazione dello zero
Condizioni ambientali di utilizzo - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 140 °F) 700 hPa - 1060 hPa 30 % - 80 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di stoccaggio - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da -10 °C a +65 °C (da 14 °F a 149 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di trasporto - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da -10 °C a +65 °C (da 14 °F a 149 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % senza formazione di condensa

U.O.C. ACQUISTI

**Immagini prodotto**

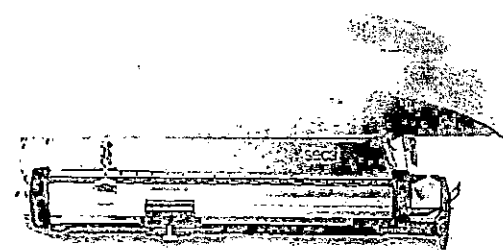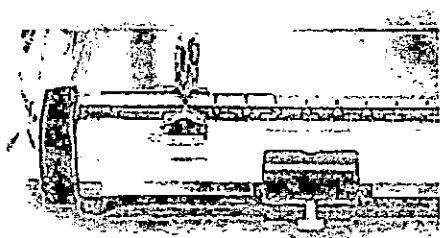

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc./P. IVA 11703230158  
Telefono +39 02 98248016 • Fax +39 02 98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Capitale Sociale 51.640 € v • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione  
qualità aziendale certificato  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

**Informazioni utili\***

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	L'utilizzo di detergenti e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio.
CONSERVAZIONE	Conservare l'unità in un ambiente asciutto e fresco.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

**Contenuto della confezione**

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
745	Bilancia pesa neonati meccanica	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

**Cronologia delle revisioni**

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.



0102  
0123

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20147 • Milano (MI) • Cod. Fisc./P. IVA 11703230158  
Telefono +39 02 98248016 • Fax +39 02 98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. MI 12745/1990 • P. C. A. A. MI 1494147

Organizzazione con sistema di gestione  
qualità aziendale certificato.  
UNICEI EN ISO 13485:2016

Wir, der Hersteller, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die unten aufgeführten Produkte den einschlägigen Bestimmungen der nachstehenden Richtlinien entsprechen.

<b>Kategorie</b>	Nichtselbsttätige mechanische Säuglingswaagen
<b>Produkt</b>	745
<b>Genauigkeitsklasse</b>	III
<b>Konformitätsbewertungsverfahren für nichtselbsttätige Waagen</b>	Die notifizierte Stelle Physikalisch-Technische Bundesanstalt (0102) hat die Konformität nach Modul D1 der Richtlinie 2014/31/EU überprüft und folgendes Zertifikat ausgestellt: DE-M-AQ-PTB123
<b>Klassifizierung als Medizinprodukt</b>	Klasse I mit Messfunktion
<b>Konformitätsbewertungsverfahren für Medizinprodukte</b>	Nach Anhang VI der Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG

**Richtlinien:**


- 2014/31/EU Richtlinie betreffend die Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem Markt
- 93/42/EWG Richtlinie über Medizinprodukte

**Hersteller:** seca gmbh & co. kg  
 Hammer Steindamm 3-25  
 22089 Hamburg, Deutschland

Made in China  
 Designed in Germany

**Notifizierte Stelle / Benannte Stelle:** 2014/31/EU:  
 Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)  
 Bundesallee 100  
 38116 Braunschweig, Deutschland  
 Kennnummer: 0102

93/42/EWG:  
 TÜV SÜD Product Service GmbH  
 Ridlerstrasse 65  
 80339 München, Deutschland  
 Kennnummer: 0123



Diese Konformitätserklärung ist gültig ab dem Datum der Unterzeichnung bis zur Ausstellung einer revidierten Konformitätserklärung aufgrund von Änderung der oben genannten Produkte.

Hamburg, 20 / 04 / 2016



Frederik Vogel  
 CEO Development & Manufacturing

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE			Area compilata dal FORNITORE: EMERGO S.R.L.						
Riga	DESTINAZIONE	Metaprodotto MEPA	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Note
1	Pediatria e Neonatologia Teramo - 1° Lotto - 1° Piano - tel. 0861.429392	Bilance meccaniche lattanti	Pezzo	3	SECA	BILANCIA MECCANICA PESANEONATI MOD. 745 CLASSE III	.254,00	762,00	
<b>TOTALE</b>								762,00	

Si precisa che l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso previa verifica di conformità tecnica a quanto richiesto

N.B. RIEMPIRE LA ZONA IN ALTO A DESTRA RELATIVA ALLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA CONCORRENTE

191  
AI  
10

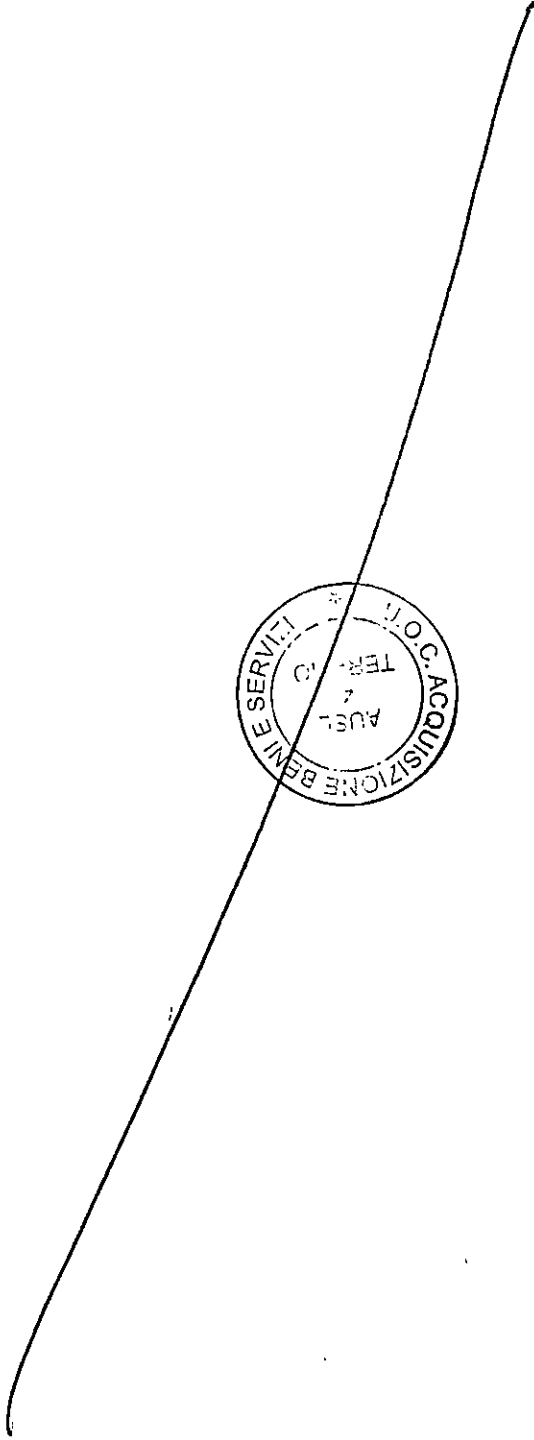





Riga	DESTINAZIONE	Metaprodotto MEPA	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Note
1	Pediatria e Neonatologia Teramo - 1° Lotto - 1° Piano - tel. 0861.429382	PLICOMETRI DI HARPENDEN	Pezzo		VERBENI E SERVIZI S.L. MONTEBATE	PLICOMETRO DI HARPENDEN COD. 01801	320,00	640,00	
<b>TOTALE</b>								640,00	

Si precisa che l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso previa verifica di conformità tecnica a quanto richiesto

N.B.: RIEMPIRE LA ZONA IN ALTO A DESTRA RELATIVA ALLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA CONCORRENTE



Riga	DESTINAZIONE	Metaprodotto MEPA	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale	Note
1	Pediatria e Neonatologia - Torómo - 1° Lotto - 1° Piano - tel. 0861.429392	BABYMASTER (asta graduata per la misurazione della lunghezza dei bambini da 0 a 2 anni)	Pezzo			ALTIMETRO SECA 207	102,00	612,00	
<b>TOTALE</b>								<b>612,00</b>	

Si precisa che l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso previa verifica di conformità tecnica a quanto richiesto

N.B. RIEMPIRE LA ZONA IN ALTO A DESTRA RELATIVA ALLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA CONCORRENTE





U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

U.O.C. Programmazione e Gestione  
Attività Economiche e Finanziarie

Spesa 2020: € 29,59 Sottoconto: 07.08.02.01.03.02

Incentivo art. 113 del D.Lgs n. 50/2016

Prenotazione n. 378/1

Spesa 2020: € 16,00 Sottoconto: 01.01.02.09.04.01

Innovazione tecnologica art. 113 del D.Lgs n. 50/2016

Prenotazione n. 379/2

LOTTO 1 sottoconto ~~01.01.02.09.05.00~~ 01.02.09.05.00

DITTA: SADEL MEDICA SRLS UNIPERSONALE

CIG: Z4F29CB882

Spesa anno 2020: € 746,64

Prenotazione n. 380/1

LOTTO 2 sottoconto ~~01.01.02.09.05.00~~ 01.02.09.05.00

DITTA: SADEL MEDICA SRLS UNIPERSONALE

CIG: Z5429CBEC2

Spesa anno 2020: € 780,80.

Prenotazione 380/2

Prenotazione 380/3

Del MAX 90/2016

LOTTO 3 sottoconto ~~01.01.02.09.05.00~~ 01.02.09.05.00

DITTA: EMERGO SRL

CIG: ZC1273C89C;

Spesa anno 2020: € 929,64

Fonte di Finanziamento: delibera 0344 del 25.02.2019 relativa al Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018

proroga 2019. Attuazione PROGRAMMA 4: "OPERATORI SANITARI PROMOTORI DI SALUTE".

Referente U.O.C. proponente: Dott. Vittorio D'Ambrosio

Data 12/12/2019

Utilizzo prenotazione: O S

Data: 11.2.2020

Il Direttore  
del U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)


Il Contabile  
Il Dirigente  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

ORIGINALE


Il Responsabile dell'Istruttoria  
(Dott.ssa Marisa Di Pietro)



Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Emanuela Tedori)



Il Direttore dell'U.O.C.  
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)

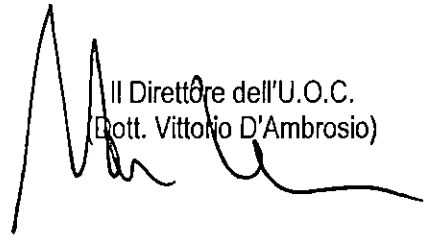


---

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data..... e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

**24 FEB. 2020**

L'Addetto alla pubblicazione informatica

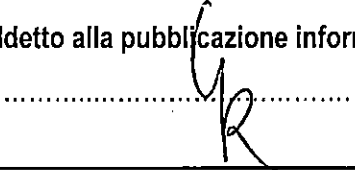

---

Inviata al Collegio Sindacale in data .....